

Декларація про відповідність №DoC002UKR-HEL
Declaration of conformity №DoC002UKR-HEL

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Медичні вироби:

Канюля внутрішньовенна BD Venflon™, Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro, Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety

Medical devices:

BD Venflon™ I.V. Cannula, BD Venflon™ Pro I.V. Cannula, BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula

Перелік медичних виробів:

*Div. Додаток 1 до цієї Декларації про відповідність
See in Annex 1 to this Declaration of conformity*

List of medical devices:

Виробник:

Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі АБ, Флоретгатан 29С, ПО Бокс 631, СЕ-251 06 Гельсінгборг, Швеція
Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Manufacturer:

Виробнича площадка (субпідрядник):

Div. Додаток 1 для детальної інформації
1. Бектон Дікінсон Медікал (С) Пте. Лтд., 30 Туас авеню 2, Сінгапур 639461, Сінгапур
2. Бектон Дікінсон Індія Пвт. Лтд., Плот №1, Сектор 3, ІМТ Бавал, Дістрікт Реварі - 123501, Хар'яна, Індія
Refer to Annex 1 for detailed information
1. Becton Dickinson Medical (S) Pte. Ltd., 30 Tuas Avenue 2, Singapore 639461, Singapore
2. Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot №1, Sector 3, IMT Bawal, District Rewari, Haryana - 123501, India

Manufacturing site (subcontractor):

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТІА МЕДТЕХНІКА»,
Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21
Limited Liability Company "CRATIA MEDTEKHNIKA", 04107, Kyiv, Baggovutiv's'ka Str., build. 17-21, Ukraine

Authorized representative in Ukraine:

Класифікація згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013р.
Classification according to Annex 2 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

IIa (пункт 15 Додатку 2)

IIa (item 15 of Annex 2)

Процедура оцінки відповідності:

Додаток 3 (без положень п. 8-11) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р. (шляхом визнання результатів оцінки відповідності)
Annex 3 (Excluding items 8-11) of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013 (through recognition of results of conformity assessment)

Conformity Assessment Route:

PR.603-18

Номер сертифіката відповідності:

Certificate number:

Строк дії сертифіката відповідності

Validity period of Certificate of conformity:

Термін дії декларації

Term of validity of the Declaration

По 31.12.2028

Till 31.12.2028

Дійсна до 31.12.2028

Valid till 31.12.2028

Призначений орган з оцінки

відповідності та його

ідентифікаційний код

Conformity assessment body with its identification number:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації»
Limited Liability Company "Ukrainian Scientific Institute of Certification"
UA.TR.116



| | | | |
|--|---|---|--|
| Дата: 05.01.2024 <i>Date: 05.01.2024</i> | Номер: №DoC002UKR-HEL <i>Number: №DoC002UKR-HEL</i> | Редакція: 7 <i>Version: 7</i> | Сторінка 1 із 4 <i>Page 1 of 4</i> |
|--|---|---|--|

Бектон Дікінсон Інфузион Терапі АБ в особі **Катаріни Рієтз**, менеджера з забезпечення якості/регуляторної політики, під свою юридичну відповідальність декларує виконання основних вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013р.

Becton Dickinson Infusion Therapy AB duly represented by **QA/RA Manager Katarina Rietz**, declares under our safe responsibility the fulfillment of basic requirements for medical devices, according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.

Місце видачі: Гельсінгборг, Швеція
Place of issue: Helsingborg, Sweden

Дата підпису | Підпис уповноваженої особи
Date of signing | Signature of Authorized person

05.01.2024



ПІБ уповноваженої особи | Назва посади
Full Name of Authorized person | Position

Катаріна Рієтз
Katarina Rietz

Менеджер з забезпечення якості/регуляторної політики
QA/RA Manager

Becton Dickinson Infusion Therapy AB
Flörettgatan 29 C
PO Box 631
SE-251 06 Helsingborg
Sweden



| | | | |
|--|---|---|--|
| Дата: 05.01.2024 <i>Date: 05.01.2024</i> | Номер: №DoC002UKR-HEL <i>Number: №DoC002UKR-HEL</i> | Редакція: 7 <i>Version: 7</i> | Сторінка 2 із 4 <i>Page 2 of 4</i> |
|--|---|---|--|

Декларація про відповідність №DoC002UKR-HEL
 Declaration of conformity №DoC002UKR-HEL

Додаток 1
 Annex 1

Перелік медичних виробів
 List of medical devices

| Каталожний номер Catalogue number | Назва медичного виробу на англійській мові Name of medical device in English | Назва медичного виробу на українській мові Name of medical device in Ukrainian | Характеристики виробів Devices characteristics | Виробнича площадка Manufacturing site |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | | |
| 393202 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 22G (Г) 0.9 x 25 mm (мм) 42 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393204 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 20G (Г) 1.1 x 32 mm (мм) 67 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393206 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 18G (Г) 1.3 x 32 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393207 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 18G (Г) 1.3 x 45 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393208 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 17G (Г) 1.5 x 45 mm (мм) 133 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393209 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 16G (Г) 1.8 x 45 mm (мм) 236 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393210 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 14G (Г) 2.0 x 45 mm (мм) 270 ml/min (мл/хв) | 2 |
| | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | | |
| 393222 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 22G (Г) 0.9 x 25 mm (мм) 42 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393224 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 20G (Г) 1.1 x 32 mm (мм) 67 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393226 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 18G (Г) 1.3 x 32 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393227 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 18G (Г) 1.3 x 45 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393228 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 17G (Г) 1.5 x 45 mm (мм) 133 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393229 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 16G (Г) 1.8 x 45 mm (мм) 236 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393230 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety | 14G (Г) 2.0 x 45 mm (мм) 270 ml/min (мл/хв) | 1 |
| | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | | |

Дата: 05.01.2024
 Date: 05.01.2024

Номер: №DoC002UKR-HEL
 Number: №DoC002UKR-HEL


Редакція: 7
 Version: 7



| Каталожний номер Catalogue number | Назва медичного виробу на англійській мові Name of medical device in English | Назва медичного виробу на українській мові Name of medical device in Ukrainian | Характеристики виробів Devices characteristics | Виробнича площадка Manufacturing site |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| 391451 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 22G (Г) 0.8 x 25mm (мм) 31 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391452 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 20G (Г) 1.0 x 32mm (мм) 54 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391457 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 18G (Г) 1.2 x 32mm (мм) 80 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391453 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 18G (Г) 1.2 x 45mm (мм) 80 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391455 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 16G (Г) 1.7 x 45mm (мм) 180 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391456 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 14G (Г) 2.0 x 45mm (мм) 270 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391454 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 17G (Г) 1,4x45мм (мм) 125 ml/min (мл/хв) | 2 |

Дата підпису | Підпис уповноваженої особи
 Date of signing | Signature of Authorized person

05.01.2024

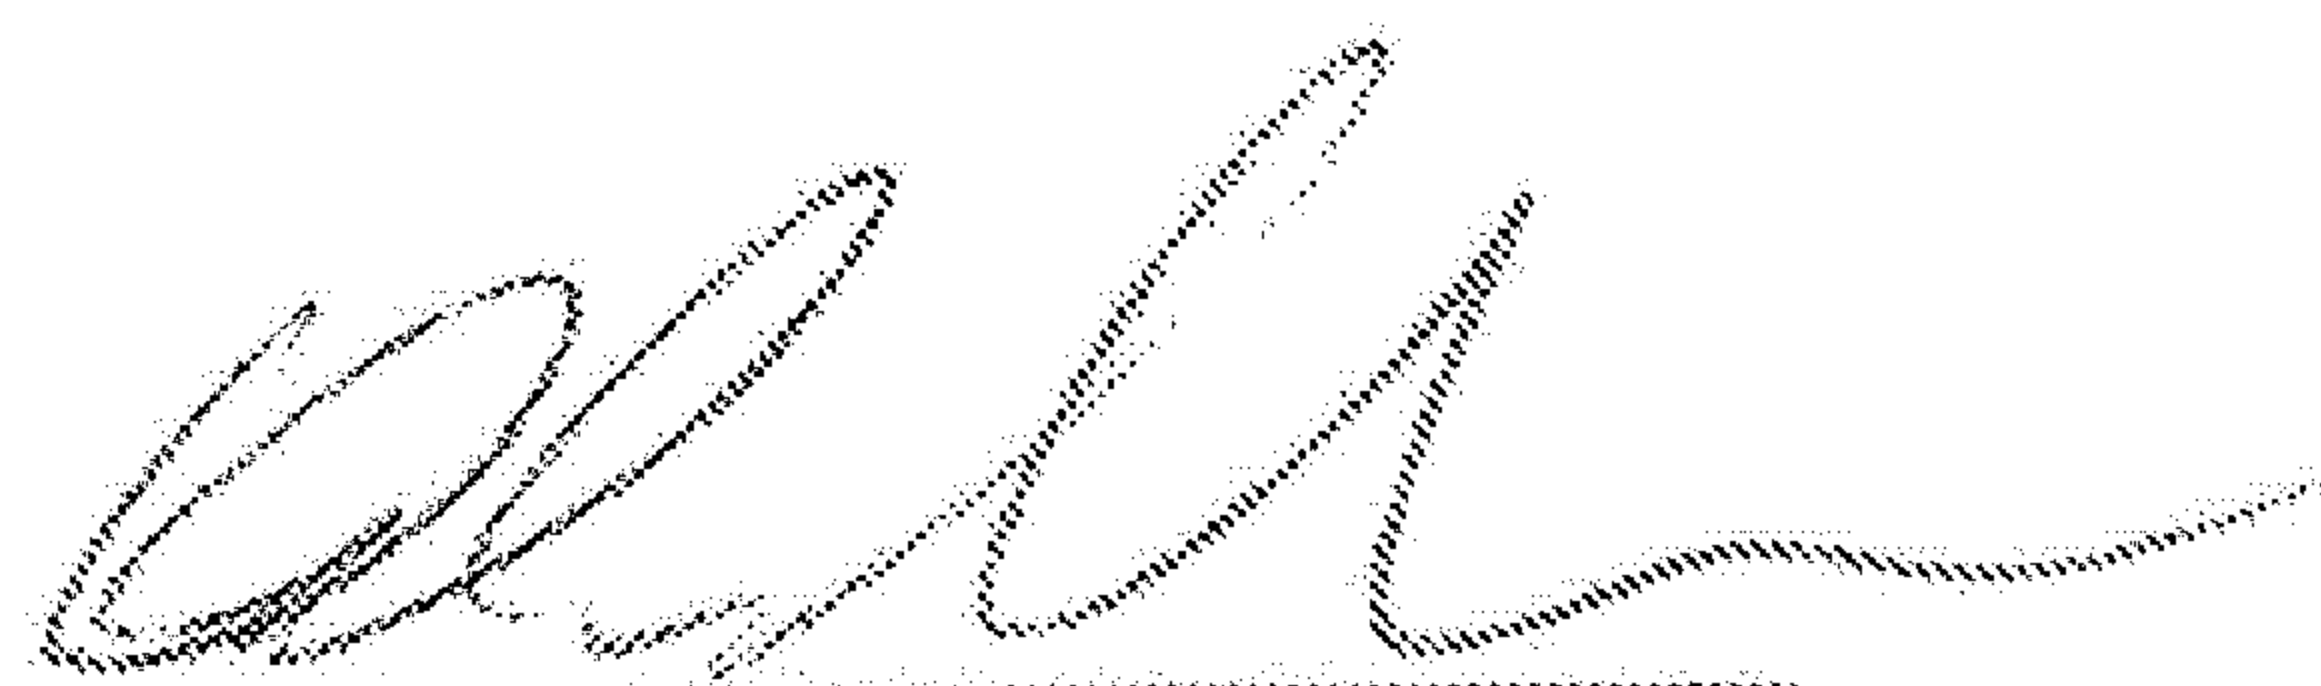

ПІБ уповноваженої особи | Назва посади
 Full Name of Authorized person | Position

Катаріна Рієтц
 Katarina Rietz

Менеджер з забезпечення якості/регуляторної політики
 QA/RA Manager



| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| Дата: 05.01.2024 Date: 05.01.2024 | Номер: №DoC002UKR-HEL Number: №DoC002UKR-HEL | Редакція: 7 Version: 7 | Сторінка 4 із 4 Page 4 of 4 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: Becton Dickinson Infusion Therapy AB /
Бектон Дікінсон Інфюжи Терапі АБ

Юридична адреса: Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden /
Флореттгатап 29С, ПО Бокс 631, СЕ-251 06 Гельсінгборг, Швеція

Виробничі площадки: Becton Dickinson Infusion Therapy AB /
Бектон Дікінсон Інфюжи Терапі АБ
Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden /
Флореттгатап 29С, ПО Бокс 631, СЕ-251 06 Гельсінгборг, Швеція

Уповноважений представник: ТОВ «Кратія Медтехніка»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Код ЄДРПОУ 38670845

Вироби: Sterile Intravenous Catheters and Fluid Administration Devices /
Стерильні внутрішньовенні катетери та пристрої для введення рідин
(конкретизована сфера наведена на сторінці 2 цього сертифіката)


Клас: Іа


Призначений орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що вказаний виробник впровадив систему управління якістю на етапах розроблення, виробництва та остаточної перевірки стосовно зазначених виробів у відповідності до пунктів 3-7 Додатка 3 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 12-15 Додатка 3 ТР. Для реалізації продукції ІІІ класу додатково має бути наявний сертифікат перевірки проєкта за пунктами 8-11 Додатка 3 ТР.

Підстава для видачі:

Акт експертизи документації № PR.603/RC2/3-24 від 03.01.2024;
Рішення про видачу сертифіката № PR.603/RC2/4-24 від 05.01.2024.

Сертифікат № PR.603-18
Дійсний до «31» грудня 2028 р.
Видання № 4 від «05» січня 2024 р.
Вперше видано 10.10.2018.

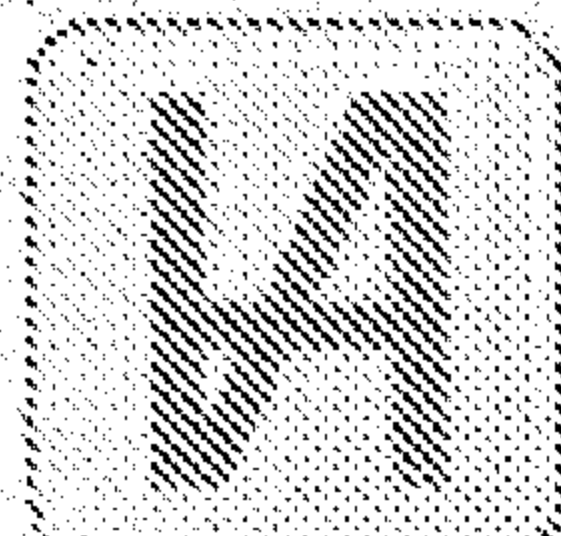

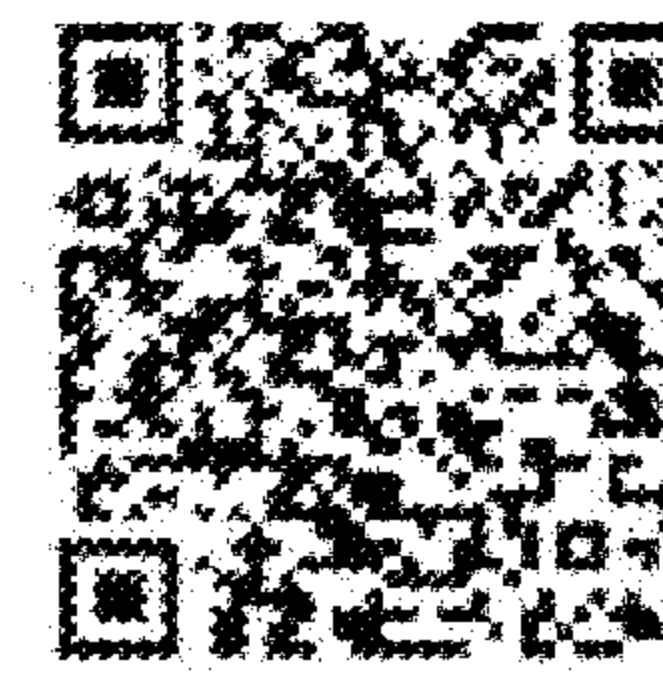


Конкретизована сфера:


| № з/п | Назви виробів англійською мовою | Назви виробів українською мовою |
|-------|--|--|
| 1. | BD Venflon™ I I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ I |
| 2. | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro |
| 3. | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro Safety |
| 4. | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ |
| 5. | BD Connecta™ Stopcock with BD Q-Syte™ Luer Access Split-Septum | Кран BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer |
| 6. | BD Connecta™ Stopcock without Extension Tube | Кран BD Connecta™ без подовжувальної трубки |
| 7. | BD Connecta™ Stopcock with Extension Tube | Кран BD Connecta™ з подовжувальною трубкою |
| 8. | BD Connecta™ Stopcock with Low Volume Extension Tube | Кран BD Connecta™ з подовжувачем з низького об'єму |
| 9. | BD Plug Luer-Lok™ | Ковпачок BD зі з'єднанням Luer-Lok™ |
| 10. | BD Neoflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Neoflon™ Pro |
| 11. | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula with Instaflash™ Needle Technology | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety з технологією голки Інстафлеш (Instaflash) |



Керівник органу з оцінки відповідності
Роман МИХАЛКО

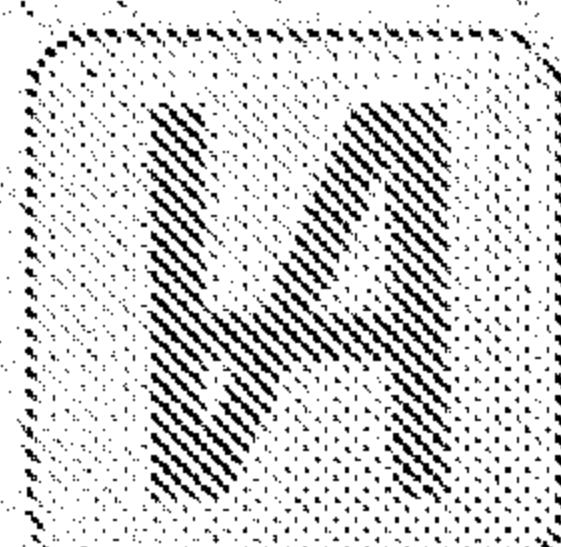

ГО 382
 Сертифікація
 продукції

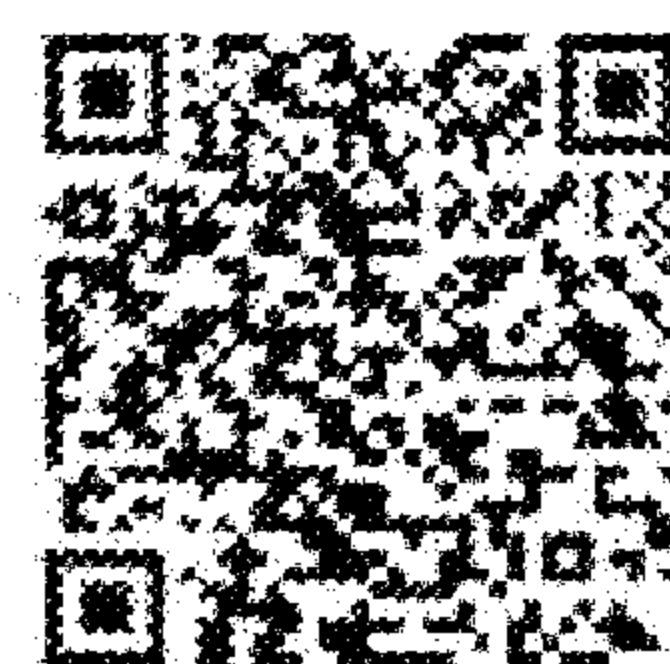


ІСТОРІЯ СЕРТИФІКАТА

| № з/п видання | Дата | Опис |
|---------------|-------------------|---|
| 1 | 10 жовтня 2018 р. | Вперше видано. |
| 2 | 08 січня 2019 р. | Повторно сертифіковано. |
| 3 | 02 квітня 2020 р. | Сферу сертифікату викладено в новому формулюванні. |
| 4 | 05 січня 2024 р. | Повторно сертифіковано. Додано транслітерацію назви та транскрипцію адреси виробника та виробничої площадки. Додано конкретизовану сферу сертифіката. |

Сертифікат № **PR.603-18**
Дійсний до «31» грудня 2028 р.
Видання № 4 від «05» січня 2024 р.
Вперше видано 10.10.2018.



Керівник органу з оцінки відповідності
Роман МИХАЛКО

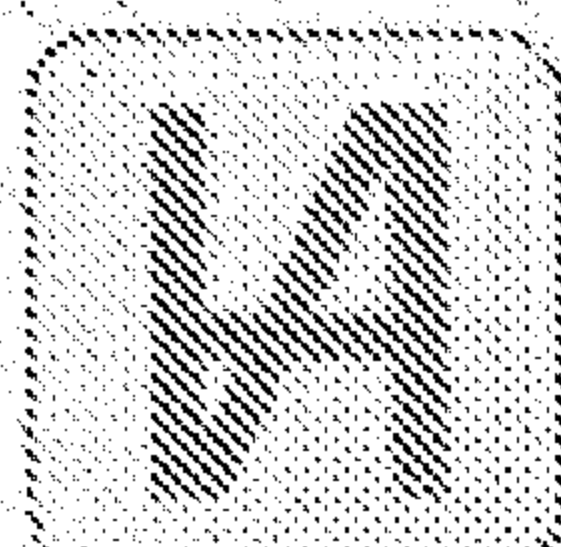

PR.603
Сертифікат
проекти



№ 003240

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР) *иляхом визнання результатів оцінки відповідності*)

Виробник: Becton Dickinson Infusion Therapy AB

Юридична адреса: Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Виробничі площадки: Becton Dickinson Infusion Therapy AB
Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Уповноважений представник: ТОВ «Кратія Медтехніка»
вул. Багговутівська, буд. 17-21, 6-й поверх, 04107, Україна

Вироби: Стерильні внутрішньовенні катетери та пристрої для введення рідин


Призначений орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що вказаний виробник впровадив систему управління якістю на етапах розроблення, виробництва та остаточної перевірки стосовно зазначених виробів у відповідності до пунктів 3-7 Додатка 3 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 12-15 Додатка 3 ТР. Для реалізації продукції III класу ризику додатково має бути наявний сертифікат перевірки проєкта за пунктами 8-11 Додатка 3 ТР.



Підстава для видачі:

Акт експертизи документації № PR.603/S1-EX1/3-20 від 01.04.2020;
Рішення про видачу сертифіката № PR.603/S1-EX1/4-20 від 02.04.2020.

Сертифікат № PR.603-18
Дійсний до «08» січня 2024 р.
Видання № 3 від «02» квітня 2020 р.
Вперше видано 10.10.2018.




Керівник органу з оцінки відповідності
Р.О. Михалко

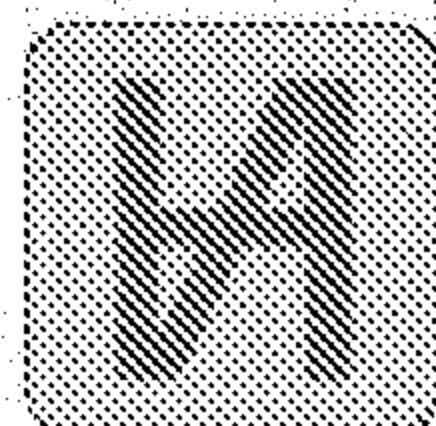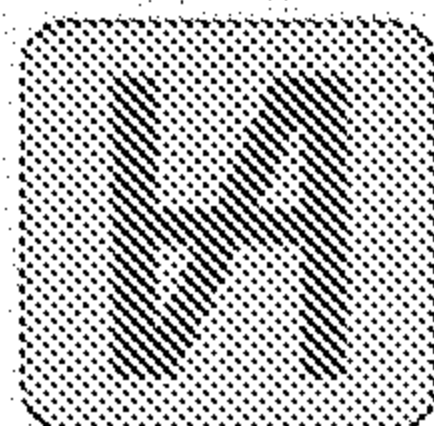

80103
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

10302
ДСТУ EN ISO/IEC 17065


ІСТОРІЯ СЕРТИФІКАТА

| № з/п видання | Дата | Опис |
|------------------|-------------------|--|
| 1 | 10 жовтня 2018 р. | Вперше видано. |
| 2 | 08 січня 2019 р. | Повторно сертифіковано. |
| 3 | 02 квітня 2020 р. | Сферу сертифікату викладено в новому формулюванні. |


Сертифікат № PR.603-18
Дійсний до «08» січня 2024 р.
Видання № 3 від «02» квітня 2020 р.
Вперше видано 10.10.2018.



Керівник органу з
оцінки відповідності
Р.О. Михалко

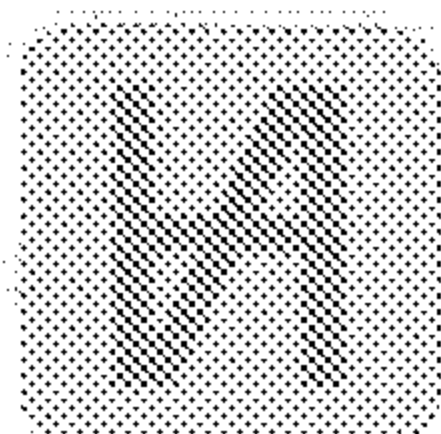


1003
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

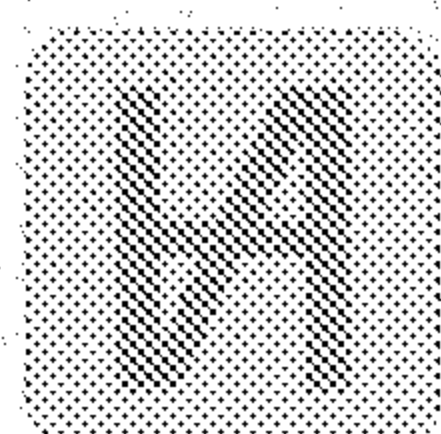

10302
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Becton Dickinson
Infusion Therapy AB
Medication and Procedural Solution
Katanna.Rietz@bd.com

PO Box 631
S - 251 06 Helsingborg
Sweden
bd.com

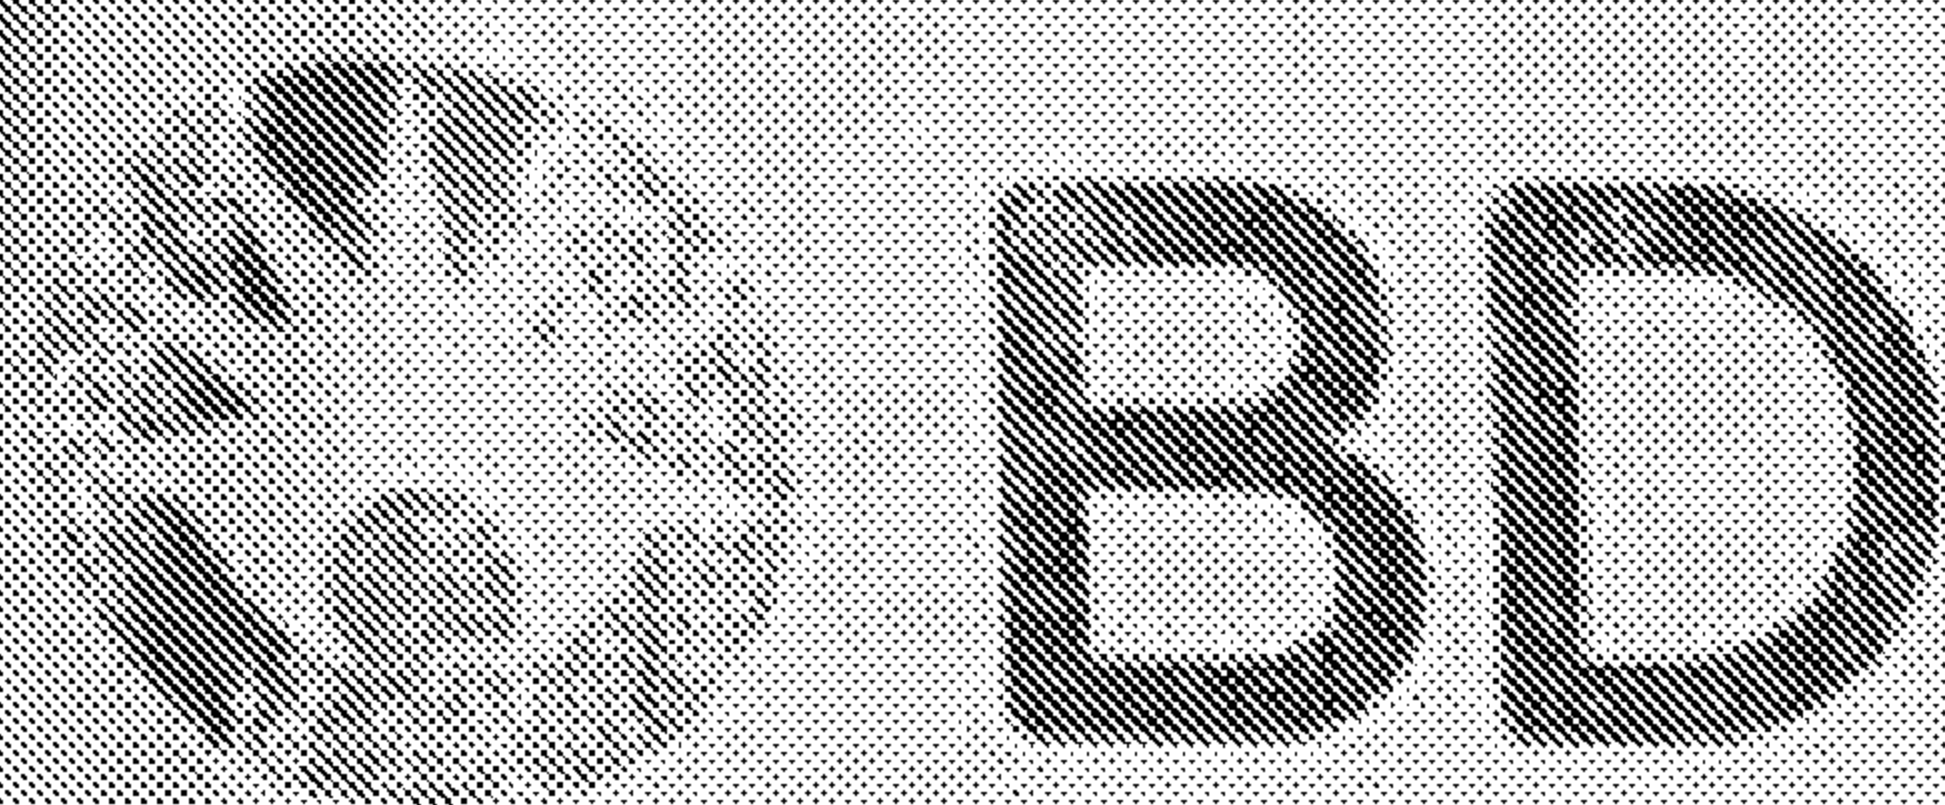

Декларація про відповідність №DoC002UKR-HEL

Declaration of conformity №DoC002UKR-HEL

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Групи виробів:

Groups of devices:

Перелік медичних виробів:

List of medical devices:

Виробник:

Manufacturer:

Виробнича площадка:

Manufacturing site:

Уповноважений представник в Україні:


Authorized representative in Ukraine:

Класифікація згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013р.

Classification according to Annex 2 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Процедура оцінки відповідності:

Conformity assessment route:

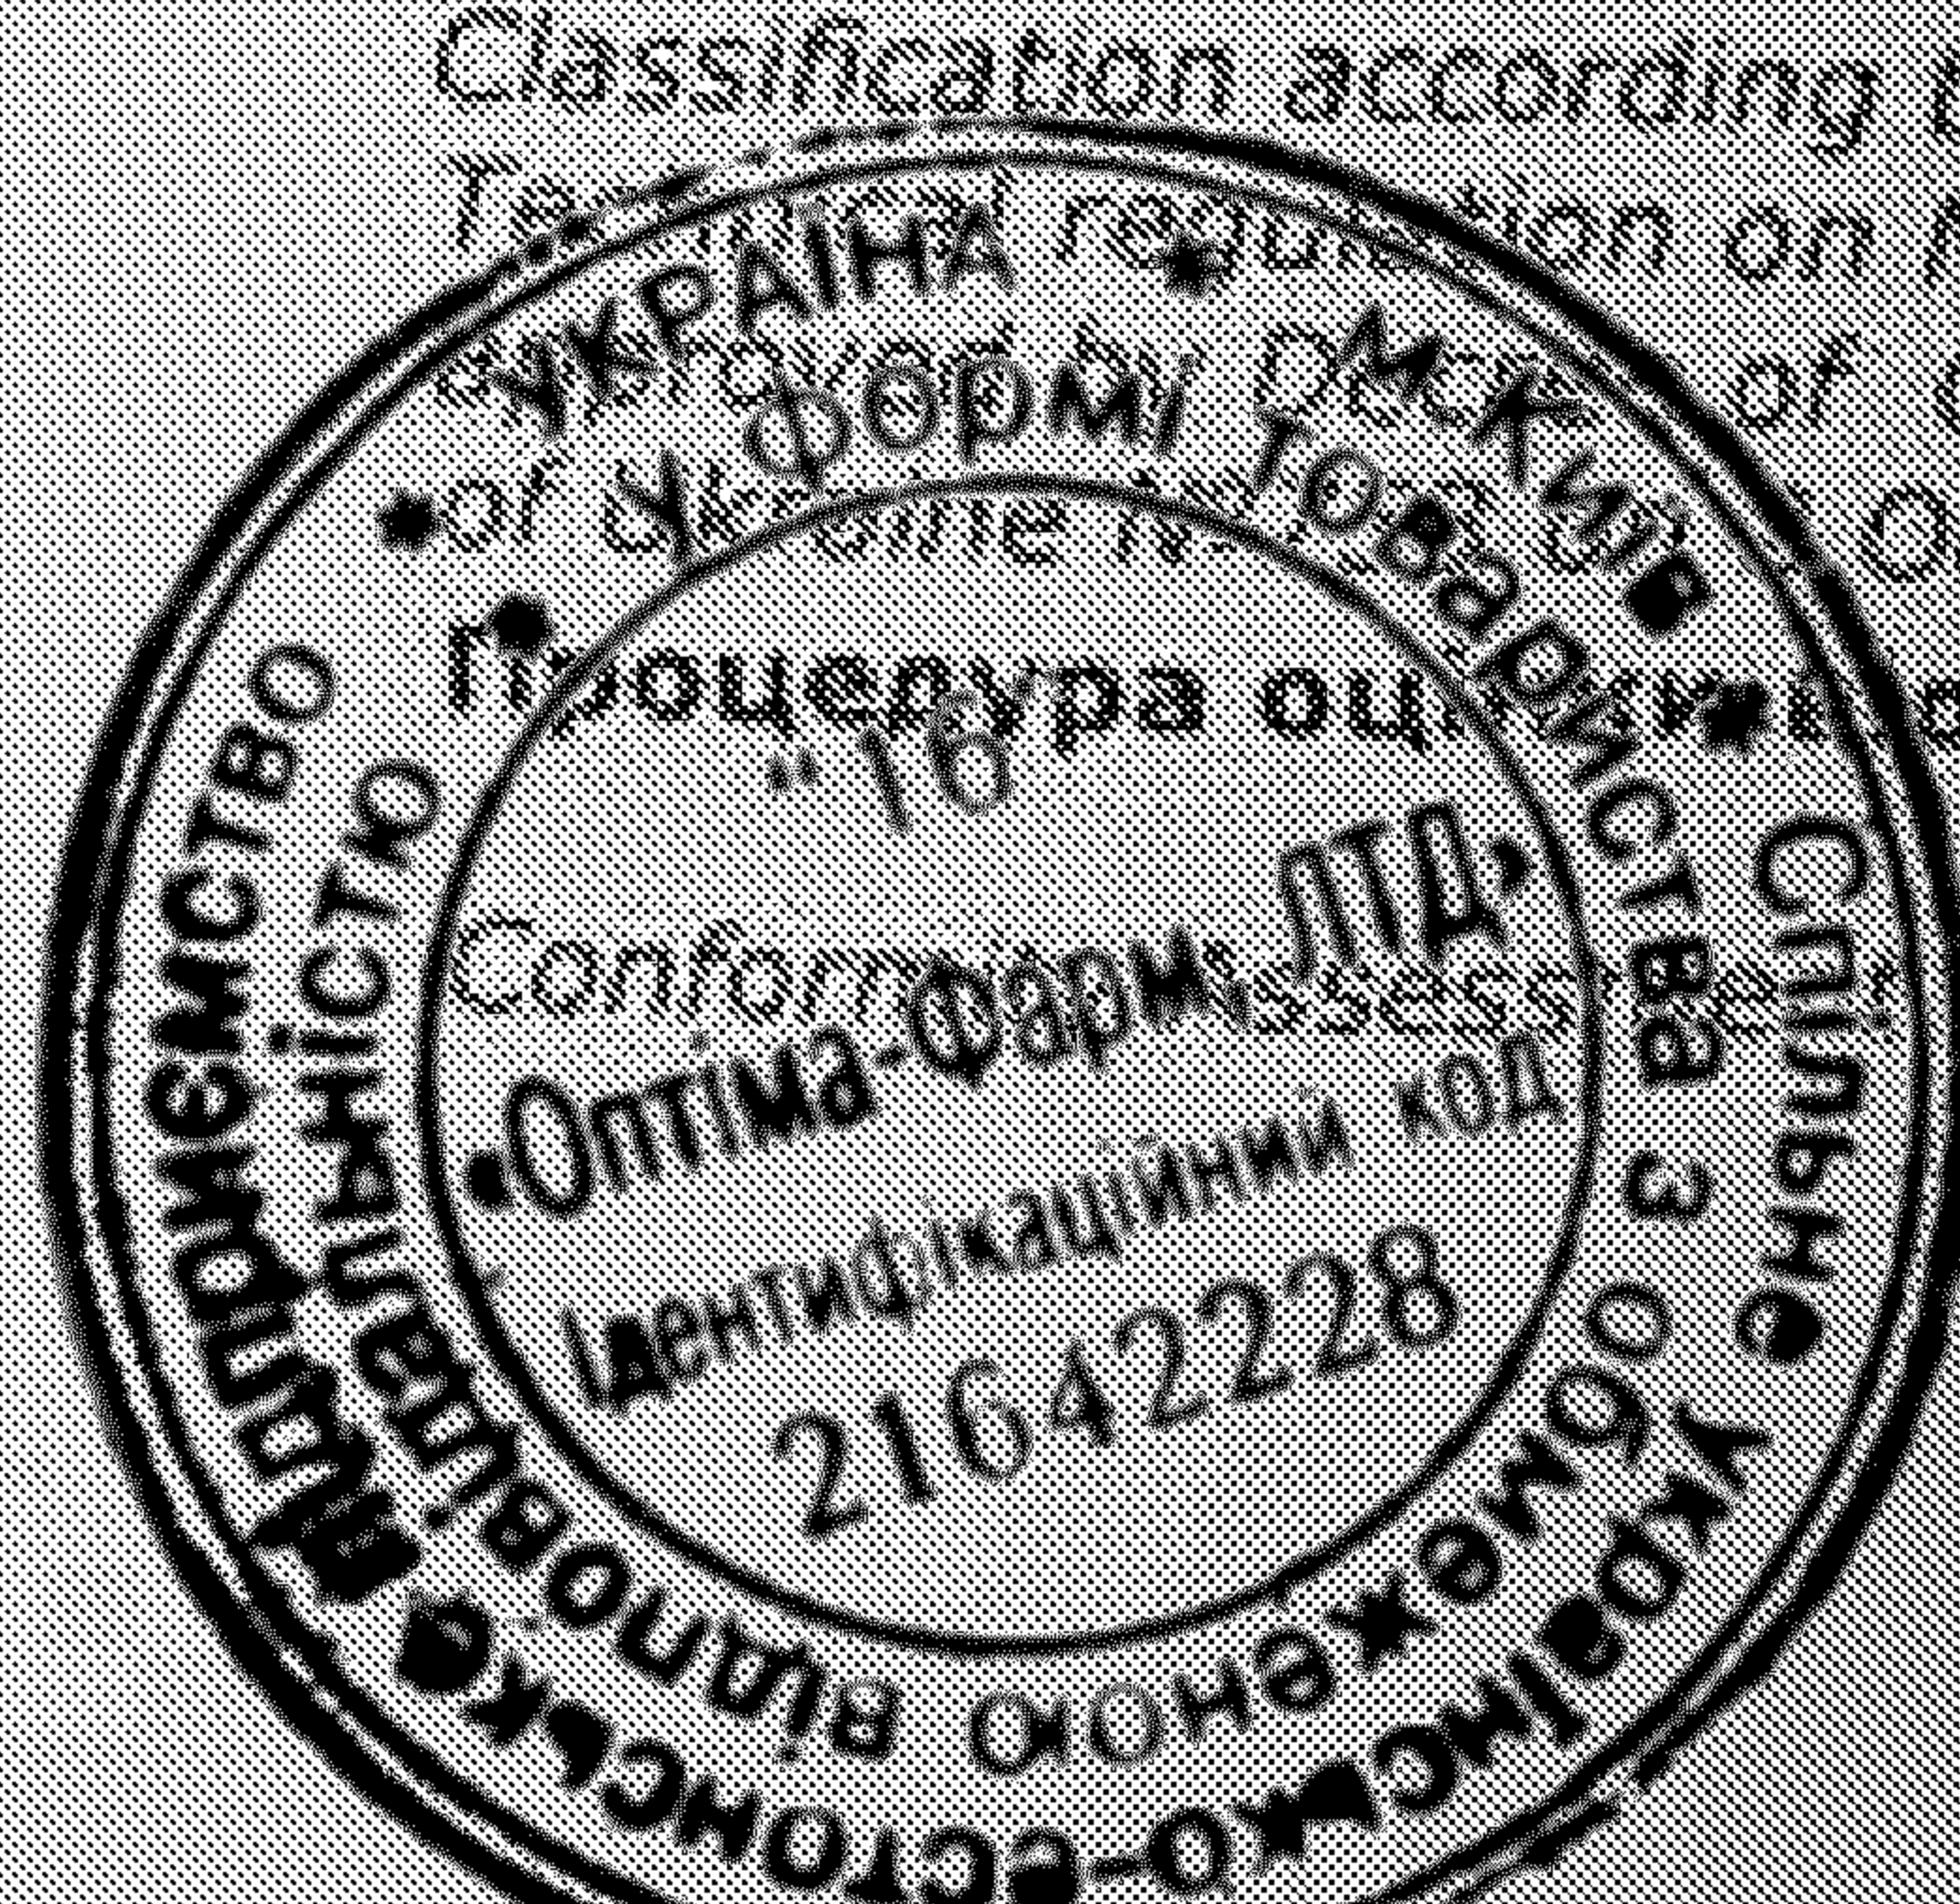

Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™, Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™, Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro, Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety
BD Neoflon™ I.V. Cannulas, BD Venflon™ I.V. Cannulas, BD Venflon™ Pro I.V. Cannulas, BD Venflon™ Pro Safety Needle Protected I.V. Cannula

Див. Додаток 1 до цієї Декларації про відповідність
See in Annex 1 to this Declaration of conformity

Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі АБ, Флоретгатан 29С, ПО Бокс 631, СЕ-251 06 Гельсінгборг, Швеція
Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Див. Додаток 1 для детальної інформації

- 1 Бектон Дікінсон Медікал (С) Пте. Лтд., 30 Туас авеню 2, Сінгапур 639461, Сінгапур
- 2 Бектон Дікінсон Індія Пвт. Лтд., Плот №1, Сектор 3, ІМТ Бавал, Дістрікт Реварі - 123501, Хар'яна, Індія

Refer to Annex 1 for detailed information

1. Becton Dickinson Medical (S) Pte. Ltd., 30 Tuas Avenue 2, Singapore 639461, Singapore
2. Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot No.1, Sector 3, IMT Bawal, District Rewari, Haryana - 123501, India

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА», Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, 6-й поверх

Limited Liability Company "CRATIA MEDTEKHNIKA", 17-21, Baggovutiv'ska Str., 6th floor, Kyiv

IIa (пункт 15 Додатку 2)

IIa (item 15 of Appendix 2)

Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р. (шляхом визнання результатів оцінки відповідності)

Annex 3 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013 (through recognition of results of conformity assessment)

Дата: 12-08-2020
Date:

Номер: DoC002UKR-HEL
Number: DoC002UKR-HEL

Редакція:5
Version:5

Сторінка 1 із 3
Page 1 of 3

Becton Dickinson
 Infusion Therapy AB
 Medication and Procedural Solution
 Katarina.Rietz@bd.com

PO Box 631
 S - 251 06 Helsingborg
 Sweden
 bd.com

Номер сертифіката відповідності:
 Certificate number:

PR.603-18

Строк дії сертифіката відповідності
 Validity period of Certificate of conformity:

по 08.01.2024
 till 08.01.2024

Призначений орган з оцінки
 відповідності та його ідентифікаційний
 код
 Conformity assessment body with its
 identification number:

Товариство з обмеженою відповідальністю
 «Український науковий інститут сертифікації»
 Limited Liability Company "Ukrainian Research Institute of Certification"
 UA.TR.116

Бектон Дікінсон Інфюжи Терапі АБ в особі *Катаріни Рієтз*, менеджера з забезпечення якості/регуляторної політики, під свою юридичну відповідальність декларує виконання основних вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013р.

Becton Dickinson Infusion Therapy AB duly represented by QA/RA Manager *Katarina Rietz*, declares under our sole responsibility the fulfillment of basic requirements for medical devices, according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.

Місце видачі: Гельсінгборг, Швеція
 Place of issue: Helsingborg, Sweden

Дата підпису | Підпис уповноваженої особи
 Date of signing | Signature of Authorized person

DocuSigned by:

Katarina.RIETZ

ПІБ уповноваженої особи | Назва посади
 Full Name of Authorized person | Position

Katarina Rietz

Менеджер з забезпечення якості/регуляторної політики
 QA/RA Manager

[Handwritten Signature]
 KATARINA RIETZ
 12-08-2020


Декларація про відповідність №DoC002UKR-HEL
 Declaration of conformity №DoC002UKR-HEL
Додаток 1
 Annex 1

Перелік медичних виробів
 List of medical devices

| Каталожний номер Catalogue number | Назва медичного виробу на англійській мові Name of medical device in English | Назва медичного виробу на українській мові Name of medical device in Ukrainian | Опис виробу Product description | Виробнича площадка Manufacturing site |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro | | |
| 393202 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 22 G (Г) 0.9 x 25 mm (мм) 42 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393204 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 20 G (Г) 1.1 x 25 mm (мм) 67 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393206 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 18 G (Г) 1.1 x 25 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393207 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 18 G (Г) 1.1 x 25 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 2 |




| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| Дата: 12-08-2020 Date: | Номер: DoC002UKR-HEL Number: DoC002UKR-HEL | Редакція: 5 Version: 5 | Сторінка 2 із 3 Page 2 of 3 |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|

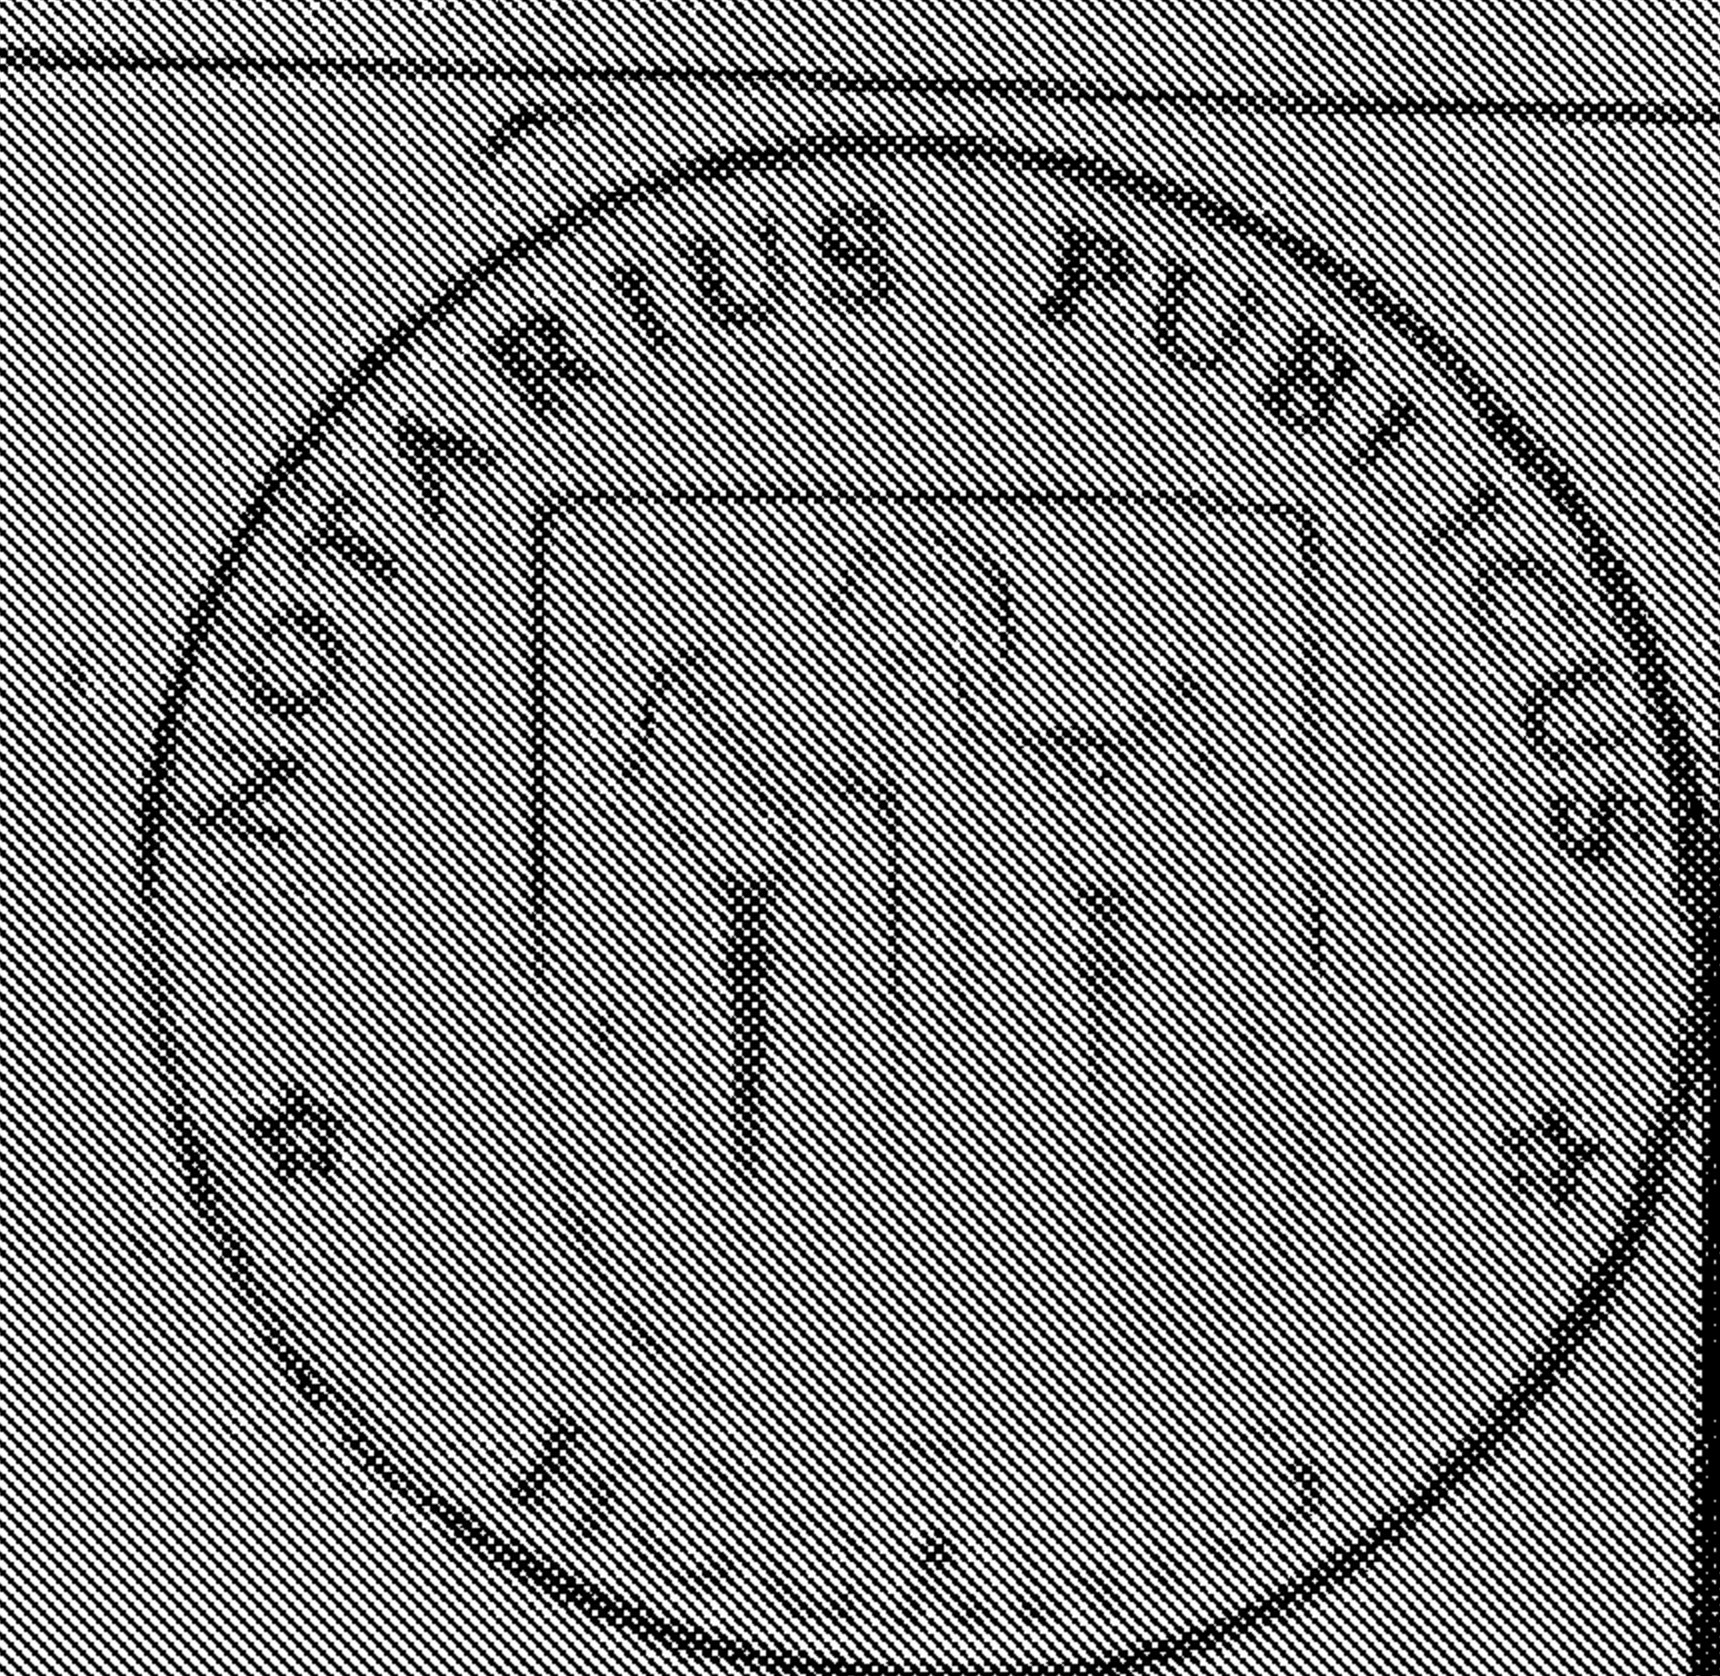

Härmed intygas att
This is to certify that
Katarina Rietz
personligen har undertecknat detta dokument.
has/have personally signed this document.
 Höganäs the 14th December 2020
 Mufida Dizdar
 Notarius Publicus i Hög...

| | | | | |
|--------|--|--|---|---|
| 393208 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 17 G (Г) 1.5 x 45 mm (мм) 133 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393209 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 16 G (Г) 1.8 x 45 mm (мм) 236 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 393210 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 14 G (Г) 2.0 x 45 mm (мм) 270 ml/min (мл/хв) | 2 |
| | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | | |
| 393222 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 22 G (Г) 0.9 x 25 mm (мм) 42 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393224 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 20 G (Г) 1.1 x 32 mm (мм) 67 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393226 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 18 G (Г) 1.3 x 32 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393227 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 18 G (Г) 1.3 x 45 mm (мм) 103 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393228 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 17 G (Г) 1.5 x 45 mm (мм) 133 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393229 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 16 G (Г) 1.8 x 45 mm (мм) 236 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 393230 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 14 G (Г) 2.0 x 45 mm (мм) 270 ml/min (мл/хв) | 1 |
| | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ | | |
| 391451 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 22 G (Г) 0.8 x 25 mm (мм) 31 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391452 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 20 G (Г) 1.0 x 32 mm (мм) 54 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391457 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 18 G (Г) 1.2 x 32 mm (мм) 80 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391453 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 18 G (Г) 1.2 x 32 mm (мм) 80 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391455 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 16 G (Г) 1.8 x 45 mm (мм) 180 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391456 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 14 G (Г) 2.0 x 45 mm (мм) 270 ml/min (мл/хв) | 2 |
| 391454 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 17 G (Г) 1.4 x 45 mm (мм) 125 ml/min (мл/хв) | 2 |
| | BD Neoflon™ I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™ | | |

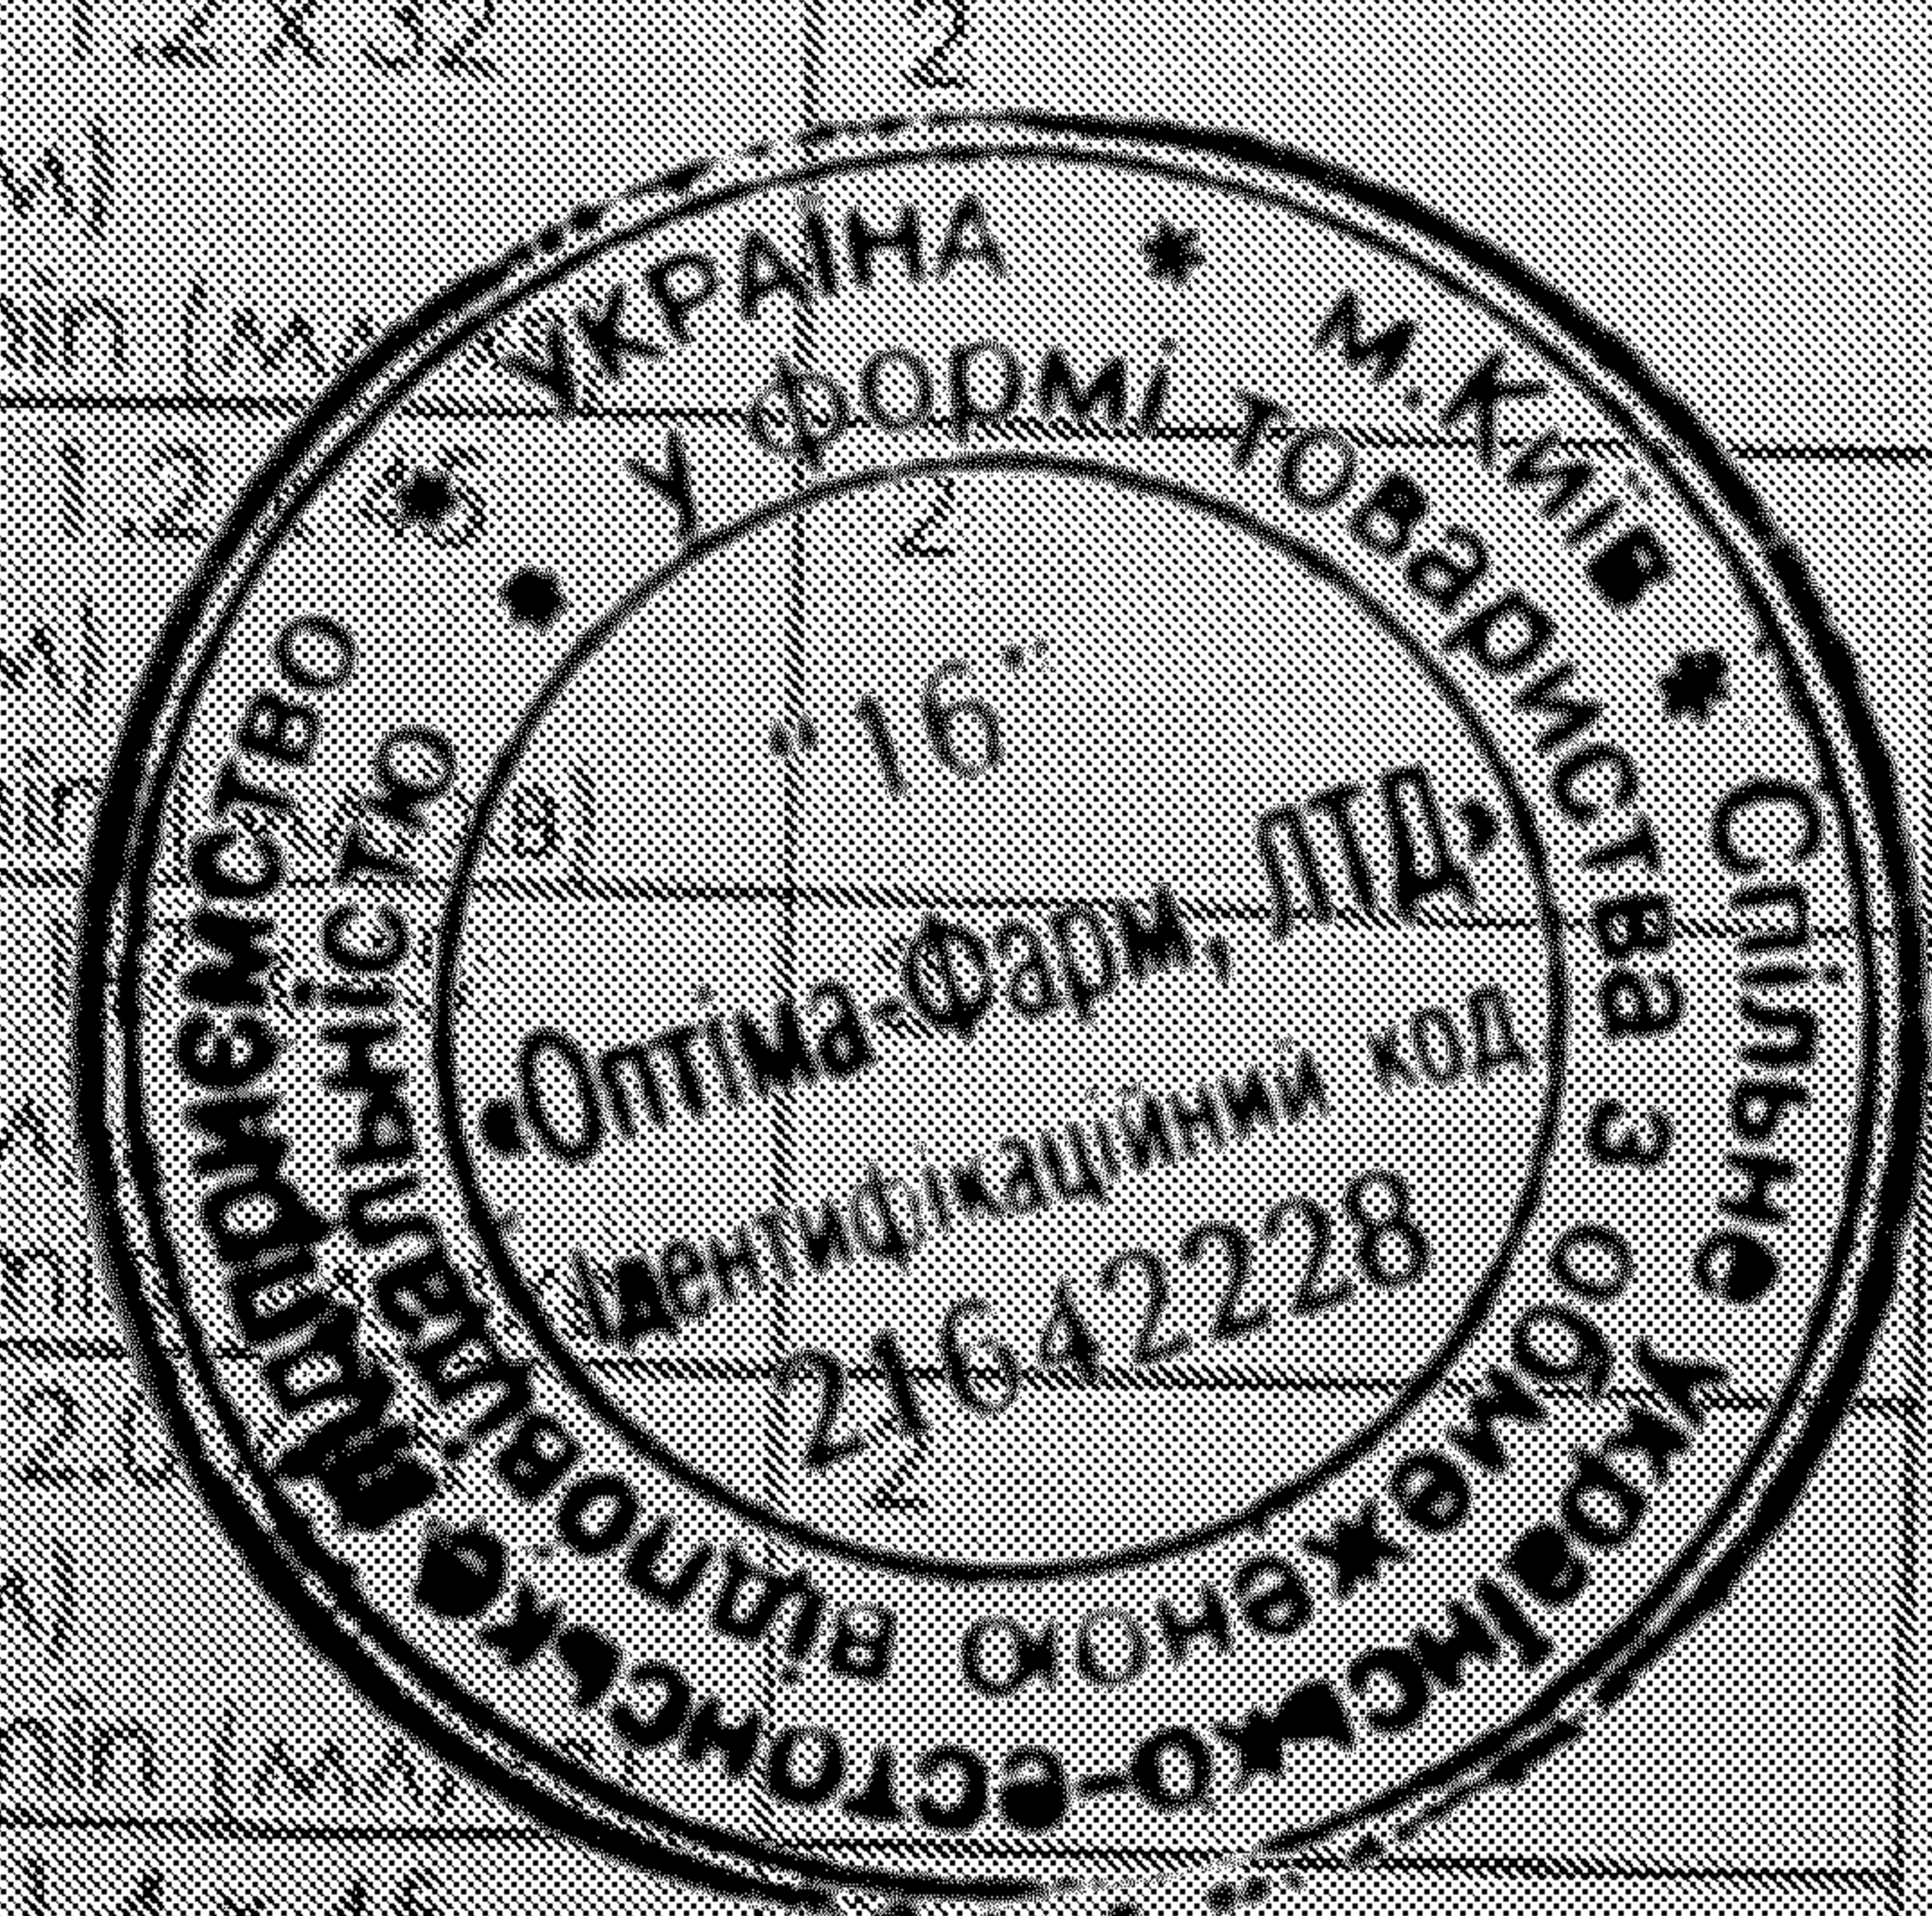

| | | | | | |
|--------|------------------------|------|---------------------------------------|---|---|
| 391349 | BD Neoflon™ Cannula | I.V. | Канюля внутрішньовенна BD Neoflon™ | 26 G (Г) 0.6 x 19 mm (мм) 13 ml/min (мл/хв) | 1 |
| 391350 | BD Neoflon™ Cannula | I.V. | Канюля внутрішньовенна BD Neoflon™ | 24 G (Г) 0.7 x 19 mm (мм) 13 ml/min (мл/хв) | 1 |

Примітка! GA та G (скорочено від шкала Гейдж) є тотожними, рівнозначними та повністю взаємозамінними поняттями. Не існує жодних відмінностей у значенні GA та G.
 Note: GA and G (a short form of Gauge scale) are identical, equivalent and completely interchangeable concepts. There are no differences in meaning GA and G.


Дата підпису | Підпис уповноваженої особи | 12-08-2020
 Date of signing | Signature of Authorized person
 Ім'я уповноваженої особи | Назва | Катарина Рієтц
 Full Name of Authorized person | Position | Katarina Rietz

DocuSigned by:
Katarina.RIETZ
 ECAFF64D10E6MFA
 Менеджер з забезпечення якості/регуляторної політики
 QA/RA Manager


[Handwritten Signature]
 KATARINA RIETZ
 12-08-2020

Історія змін
History of changes

Härmed intygas att
 This is to certify that
 Katarina Rietz
 personligen har undertecknat detta dokument.
 has/have personally signed this document.
 Höganäs the 14th December 2020
 Mufida Dizdar
 Notarius Publicus i Höganäs, Sverige
 Notary Public of Höganäs, Sweden

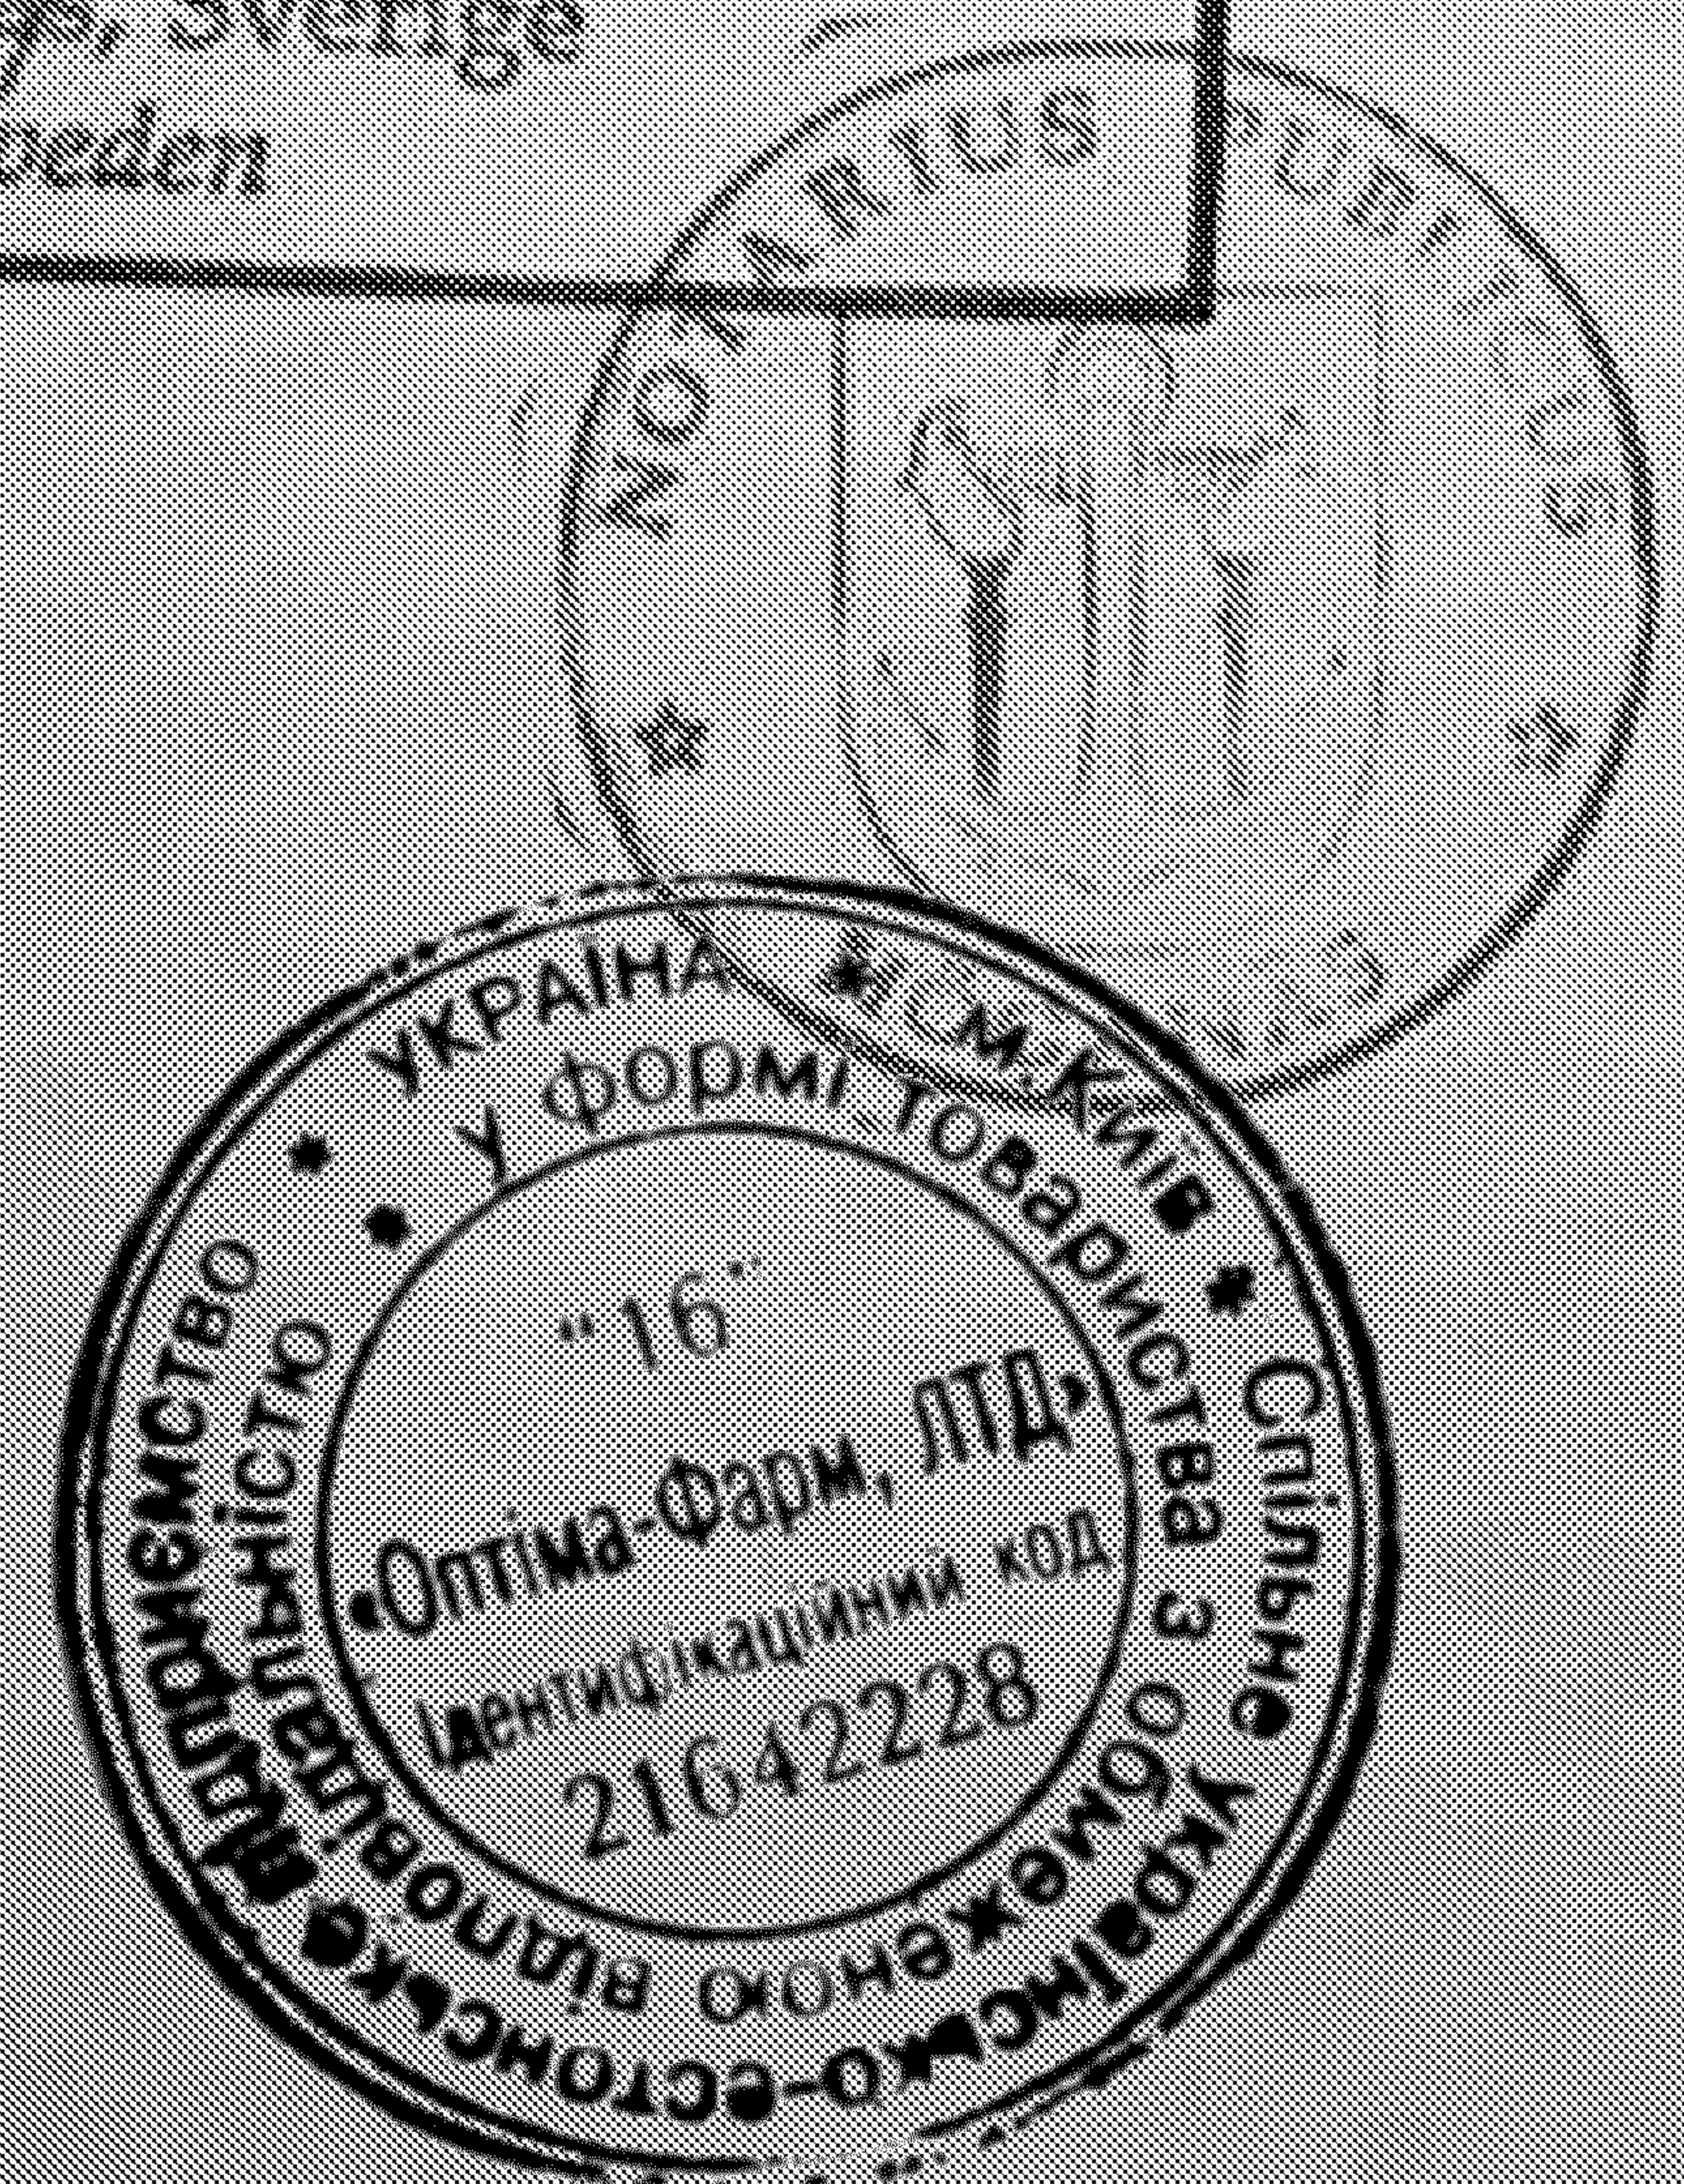

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| Дата: 12-08-2020 Date: | Номер: DoC002UKR-HEL Number: DoC002UKR-HEL | Редакція: 5 Version: 5 | Сторінка 4 із 3 Page 4 of 3 |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|

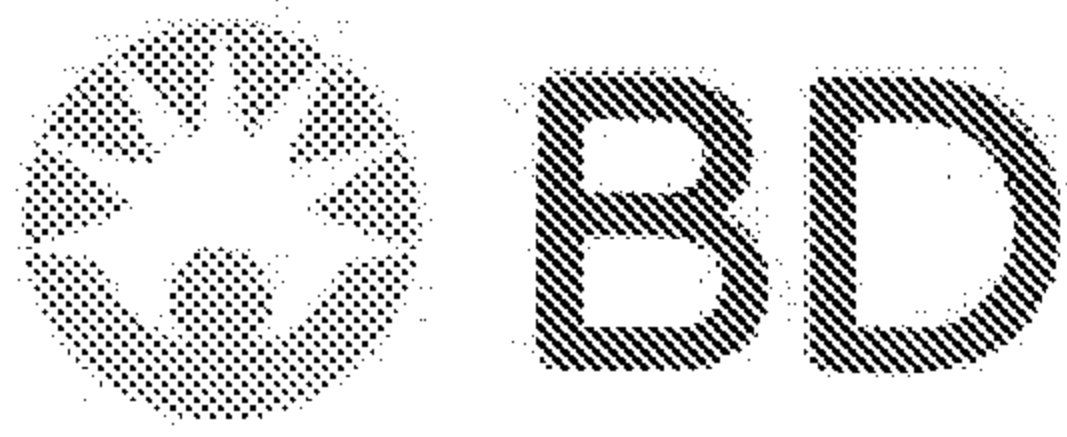

February 10th, 2020

Ukraine DoC statement

BD has performed label changes pertaining to abbreviation of the term gauge. GA has been converted to G which is equivalent to the same terminology. There is no discrepancy between "GA to G." This implementation was performed due to space constraints on the label.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Katarina Rietz", written over a horizontal dotted line.

Katarina Rietz
Manager QA/RA
Becton Dickinson Infusion Therapy AB

Becton Dickinson Infusion Therapy AB
Florettgatan 29 C
PO Box 631
SE-251 06 Helsingborg
Sweden



Advancing the world of health.

Бектон Дікінсон
Інфюжн Терапі АБ
Медичні та процедурні рішення
Katarina.riets@bd.com

ПО Бокс 631
SE-251 06 Гельсінгборг
Швеція
bd.com

Логотип БД

10 лютого 2020 року


Лист щодо декларації про відповідність для України

Компанія БД здійснила на маркуванні, котра стосується аббревіатури шкали Гейдж, GA було замінено на G, котра є еквівалентом в тій же термінології. Не існує жодних відмінностей між GA та G. Ця зміна була виконана відповідно до обмеження простору на маркуванні виробу.

З повагою,
[Підпис]
Катаріна Рієтс
Менеджер з забезпечення якості/регуляторної політики
Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі АБ

[Печатка]

Переклад виконано вірно,
Директор ТОВ «Кратія Медтехніка»
І.Ю. Бурцева

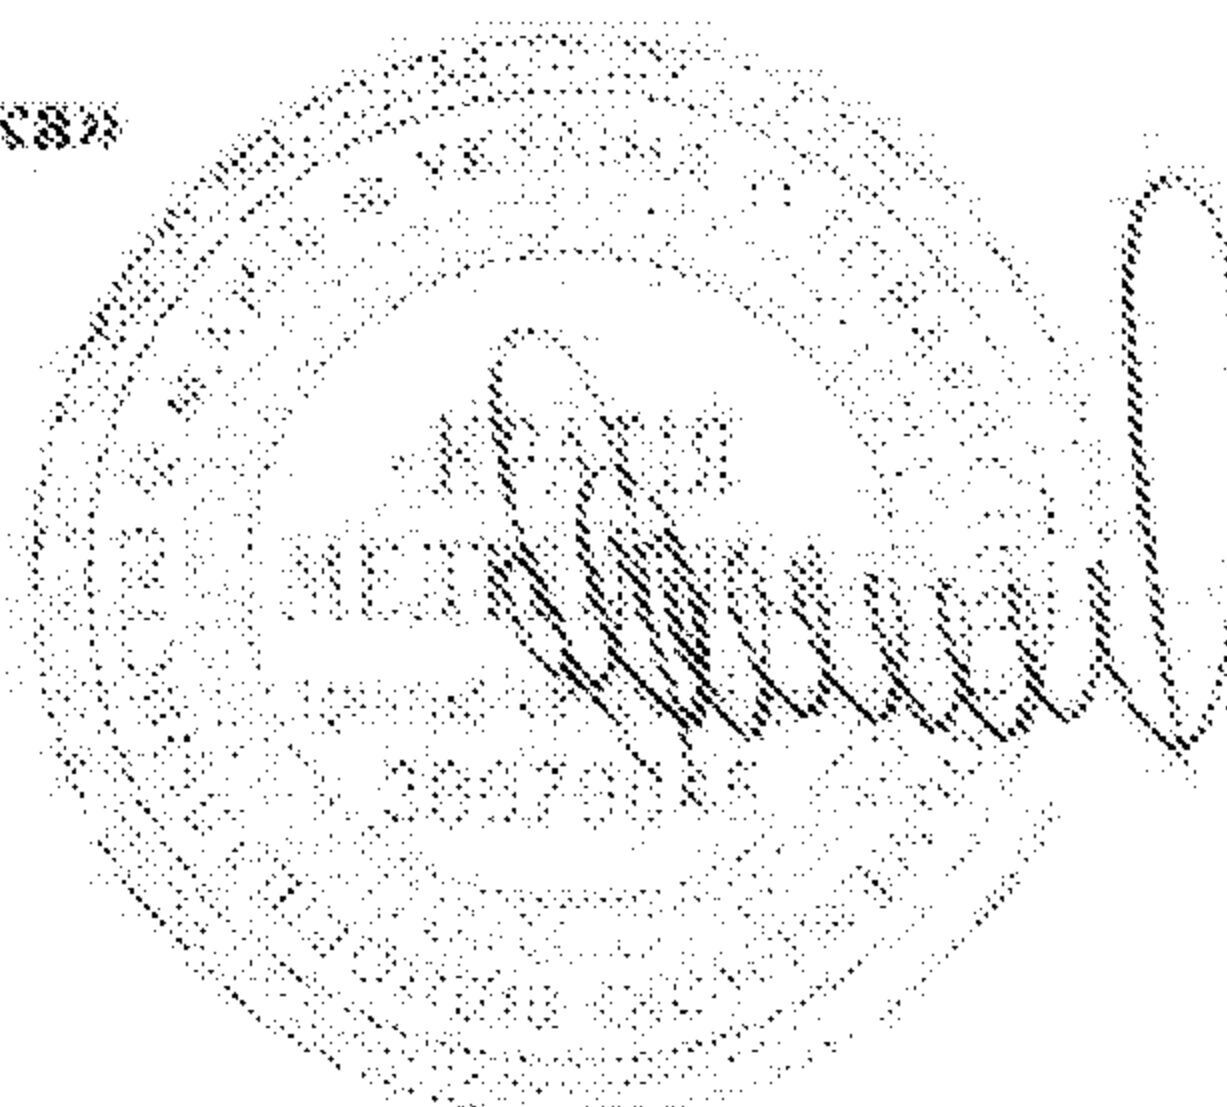

Вих. № AS
06.02.2020 року

Всім, кого це може стосуватись

Щодо позначення шкали Гейдж на маркуванні медичних виробів Becton Dickinson Infusion Therapy AB

Даним листом компанія Бектон Дікінсон Інфюзи Терапі АБ, Флореттгатан 29С, ПО Бокс 631, SE-251 06 Гельсінгборг, Швеція (*Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden*), яка є легальним виробником медичних виробів:

- Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™,
- Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™,
- Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro,
- Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety

я собі уповноваженого виробника – компанії ТОВ «Кратія Медтехніка» відповідно до довіреності від 31 жовтня 2016 року повідомляє щодо зазначення шкали Гейдж на маркуванні медичних виробів.

Медичні вироби (Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™, Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™, Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro, Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety) розроблені, виготовлені та упаковані таким чином, щоб під час транспортування та зберігання в умовах, передбачених виробником, їх характеристики та експлуатаційні показники не погіршувалися з урахуванням інструкцій та інформації, що надається на упаковках медичних виробів та додаткових вкладках до кожної одиниці виробу.

Маркування медичних виробів розроблено відповідно до вимог Технічного регламенту з урахуванням рівня підготовки та обізнаності споживача. Оскільки, вироби Бектон Дікінсон Інфюзи Терапі АБ призначені для постачання на ринки різних країн, дані нанесені на упаковку можуть містити посилання на інформацію, яка є опційною для інших. Так, маркування виробів містить два варіанти скороченого відображення шкали Гейдж: G та GA (аббревіатури від «Gauge scale»).

Приймаючи до уваги той факт, що суб'єкти ринку можуть розцінювати відображення шкали Гейдж (G та GA) як різні форми, що співвідносяться до інших понять, виробником прийнято рішення внести інформацію в декларацію про відповідність щодо тотожності таких понять:

Примітка! GA та G (скорочено від шкала Гейдж) є тотожними, рівнозначними та повністю взаємозамінними поняттями. Не існує жодних відмінностей у значенні GA та G.

Note! GA and G (a short form of Gauge scale) are identical, equivalent and completely interchangeable concepts. There are no discrepancies between meaning GA and G.

Декларація про відповідність №DoC002UKR-HEL у редакції 5 з зазначеною вище правкою перебуває на підписі виробника.

З повагою,

Директор ТОВ «Кратія Медтехніка»



І.Ю. Бурцева





СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: Becton Dickinson Infusion Therapy AB
Юридична адреса: Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Виробничі площадки: Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden; Becton Dickinson Medical (S) Pte. Ltd., 30 Tuas Avenue 2, Singapore 639461, Singapore; Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot No.1, Sector 3, IMT Bawal, District Rewari, Haryana – 123501, India; Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. S.A. de C.V., Periferico Luis Donaldo Colosio #579, Nogales, Sonora C.P. 84048, Mexico

Уповноважений представник: ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна

Вироби: Крани BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer; Крани BD Connecta™; Ковпачки BD; Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro; Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety; Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™; Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™; Пов'язки для фіксації канюлі BD Vecafix™; Пов'язки для фіксації канюлі BD Vesa-C™

Призначений орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що зазначений виробник впровадив систему управління якістю щодо процесів розроблення, виробництва та остаточного контролю стосовно зазначених виробів у відповідності до пунктів 3-7 Додатку 3 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 12-15 Додатку 3 ТР. Для реалізації продукції III класу ризику додатково має бути наявний сертифікат перевірки проекту за пунктами 8-11 Додатку 3 ТР.

Підстава для видачі:

Звіт № PR.231/6-17 від 16.06.2017;


Рішення про видачу сертифікату № PR.231/7-17 від 21.06.2017.

Сертифікат № PR.251-17


Дійсний до «20» червня 2022 р.

Видання № 1. Сертифіковано з 21.06.2017.

Дата реєстрації «21» червня 2017 р.



10302
ISO/IEC 17065




80103
ISO/IEC 17021-1



Керівник органу
з оцінки відповідності
Р. О. Михалко



№ 000373

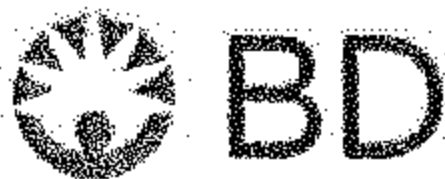

Becton Dickinson
Infusion Therapy AB

Florettgatan 29C
PO Box 631
SE - 251 06 Helsingborg
Sweden



Декларація про відповідність № DoC001UKR-HEL

Declaration of conformity № DoC001UKR-HEL

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Групи виробів:

Groups of devices:

Перелік медичних виробів:

List of medical devices:

Виробник:

Manufacturer:

Виробнича площадка:

Manufacturing site:

Уповноважений представник в Україні:

Authorized representative in Ukraine:

Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™, Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™, Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro, Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety, Пов'язки для фіксації канюлі BD Vecafix™, Пов'язки для фіксації канюлі BD Veca-C™, Ковпачки BD, Крани BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer, Крани BD Connecta™

BD Neoflon™ I.V. Cannulas, BD Venflon™ I.V. Cannulas, BD Venflon™ Pro I.V. Cannulas, BD Venflon™ Pro Safety Needle Protected I.V. Cannula, BD Vecafix™ I.V. Dressing, BD Veca-C™ I.V. Dressing, Plug BD, BD Connecta with BD Q-Syte™, BD Connecta™

Див. Додаток 1 до цієї Декларації про відповідність
See in Annex 1 to this Declaration of conformity

Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі АБ, Флореттгтан 29С, ПО Бокс 631, SE-251 06 Гельсінгборг, Швеція
Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Див. Додаток 1 для детальної інформації

- 1 Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі Системс Інк. С.А. де С.В., Паріферіко Луїс Доналдо Колосіо #579, Ногалес, Сонора С.П. 84048, Мексика
- 2 Бектон Дікінсон Медікал (С) Пте. Лтд., 30 Туас авеню 2, Сінгапур 639461, Сінгапур
- 3 Бектон Дікінсон Індія Пвт. Лтд., Плот №1, Сектор 3, ІМТ Бавал, Дістрікт Реварі - 123501, Хар'яна, Індія
- 4 Аттендс Хеаскеар АБ, Ярнвагсгтан, SE-578 33 Анебі, Швеція


Refer to Annex 1 for detailed information

1. Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. S.A. de C.V., Periferico Luis Donaldó Colosio #579, Nogales, Sonora C.P. 84048, Mexico
2. Becton Dickinson Medical (S) Pte. Ltd., 30 Tuas Avenue 2, Singapore 639461, Singapore
3. Becton Dickinson India Pvt. Ltd., Plot No.1, Sector 3, IMT Bawal, District Rewari, Haryana - 123501, India
4. Attends Healthcare AB, Järnvägsgatan 4, SE-578 33 Aneby, Sweden

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА», Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, 6-й поверх

Limited Liability Company "CRATIA MEDTEKHNIKA", 17-21, Baggovutiv'ska Str., 6th floor, Kyiv



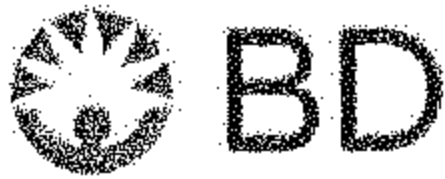

Класифікація згідно Додатку 2
Технічного регламенту щодо медичних
виробів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України №753 від 2
жовтня 2013р.

Classification according to Annex 2 of
Technical regulation on Medical devices
approved by Decree of Cabinet of
Ministers of Ukraine №753 on 2 October
2013

Процедура оцінки відповідності:

Conformity Assessment Route:

Номер сертифіката відповідності:

Certificate number:

Строк дії сертифіката відповідності

Validity period of Certificate of conformity:

Призначений орган з оцінки
відповідності та його

ідентифікаційний код

Conformity assessment body with its
identification number:

Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі АБ в особі Катаріни Рієтз, менеджера з забезпечення
якості/регуляторної політики, під свою юридичну відповідальність декларує виконання основних
вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013р.

Becton Dickinson Infusion Therapy AB duly represented by QA/RA Manager Katarina Rietz,
declares under our sole responsibility the fulfillment of basic requirements for medical devices,
according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of
Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.

Місце видачі: Гельсінгборг, Швеція

Place of issue: Helsingborg, Sweden

IIa (пункт 15 Додатку 2) для груп виробів:

- Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™,
- Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™,
- Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro;
- Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety,
- Крани BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer

IIa (пункт 10 Додатку 2) для груп виробів:

- Ковпачки BD,
- Крани BD Connecta™

I, стерильні (пункт 9 Додатку 2) для груп виробів:

- Пов'язки для фіксації канюлі BD VecaFix™,
- Пов'язки для фіксації канюлі BD Veca-C™

IIa (item 15 of Appendix 2) for device groups:

BD Neoflon™ I.V. Cannulas, BD Venflon™ I.V. Cannulas, BD Venflon™ Pro I.V. Cannulas, BD Venflon™ Pro Safety Needle Protected I.V. Cannula, BD Connecta with BD Q-Syte™

IIa (item 10 of Appendix 2) for device groups:

Plug BD, BD Connecta™

I, sterile (item 9 of Appendix 2) for device groups:

BD VecaFix™ I.V. Dressing, BD Veca-C™ I.V. Dressing,

Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Annex 3 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

PR.251 -17

з 21.06.2017 по 20.05.2022

since 21.06.2017 until 20.05.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Український науковий інститут сертифікації»

Limited Liability Company "Ukrainian Research Institute of Certification"

UA.TR.116

Date of signing | Signature of Authorized person

Katarina Rietz


QA/RA Manager



I, the undersigned, Notary Public, in and for the city of Helsingborg, Sweden, legalize the signature of person KATARINA RIETZ, EVA KATARINA who has identified himself/herself through the annexed document. It has to be notified that the undersigned, Notary Public, only legalize the signature.

Helsingborg, the 15th day of AUGUST, 2017

Christer Lewold

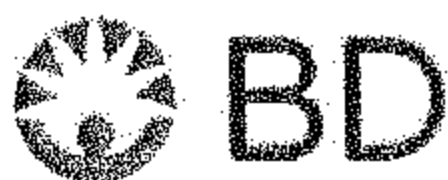


Додаток 1
Annex 1

Перелік медичних виробів
List of medical devices

| Каталожний номер Catalogue number | Назва медичного виробу на англійській мові Name of medical device in English | Назва медичного виробу на українській мові Name of medical device in Ukrainian | Опис виробу Product description | Виробнича площадка Manufacturing site |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| | BD Connecta™ with BD Q-Syte™ | Крани BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer | | |
| 394501 | BD Connecta™ with BD Q-Syte™ | Кран BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer | | 1 |
| 394502 | BD Connecta™ with BD Q-Syte™ | Кран BD Connecta™ з перемикачем потоку з мембраною BD Q-Syte™ Luer | | 1 |
| | BD Connecta™ | Крани BD Connecta™ | | |
| 394500 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394601 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394602 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394605 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394926 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394936 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394945 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394951 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394961 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394971 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394982 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394983 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394995 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| 394997 | BD Connecta™ | Кран BD Connecta™ | | 1 |
| | BD Plug | Ковпачки BD | | |
| 394080 | BD Plug | Ковпачок BD | | 1 |
| | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ Pro | | |
| 393202 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 22GA 0.9 x 25 mm | 2 |
| 393204 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 20GA 1.1 x 32 mm | 2 |
| 393206 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 18GA 1.3 x 32 mm | 2 |
| 393207 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 18GA 1.3 x 45 mm | 2 |
| 393208 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 17GA 1.5 x 45 mm | 2 |
| 393209 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 16GA 1.8 x 45 mm | 2 |
| 393210 | BD Venflon™ Pro I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ Pro | 14GA 2.0 x 45 mm | 2 |



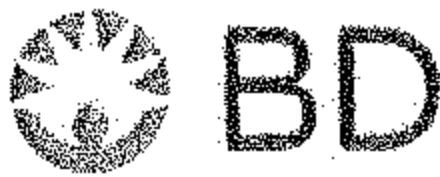

| | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | | |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| 393222 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 22GA 0.9 x 25mm | 2 |
| 393224 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 20GA 1.1 x 32mm | 2 |
| 393226 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 18GA 1.3 x 32mm | 2 |
| 393227 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 18GA 1.3 x 45mm | 2 |
| 393228 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 17GA 1.5 x 45mm | 2 |
| 393229 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 16GA 1.8 x 45mm | 2 |
| 393230 | BD Venflon™ Pro Safety I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна із захищеною голкою BD Venflon™ Pro Safety | 14GA 2.0 x 45mm | 2 |
| | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні BD Venflon™ | | |
| 391451 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 22GA 0.8 x 25mm | 3 |
| 391452 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 20GA 1.0 x 32mm | 3 |
| 391457 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 18GA 1.2 x 32mm | 3 |
| 391453 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 18GA 1.2 x 45mm | 3 |
| 391455 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 16GA 1.7 x 45mm | 3 |
| 391456 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 14GA 2.0 x 45mm | 3 |
| 391454 | BD Venflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ | 17GA (1,4x45mm) | 3 |
| | BD Neoflon™ I.V. Cannula | Канюлі внутрішньовенні BD Neoflon™ | | |
| 391349 | BD Neoflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Neoflon™ | 26GA 0.6 x 19mm | 2 |
| 391350 | BD Neoflon™ I.V. Cannula | Канюля внутрішньовенна BD Neoflon™ | 24GA 0.7 x 19mm | 2 |
| | BD Vecafix™ I.V. Dressing | Пов'язки для фіксації канюлі BD Vecafix™ | | |
| 392015 | BD Vecafix™ I.V. Dressing | Пов'язка для фіксації канюлі BD Vecafix™ | | 4 |
| | BD Vesa-C™ I.V. Dressing | Пов'язки для фіксації канюлі BD Vesa-C™ | | |
| 392020 | BD Vesa-C™ I.V. Dressing | Пов'язка для фіксації канюлі BD Vesa-C™ | | 4 |

Date of signing | Signature of Authorized person

[Handwritten Signature] 2017-08-15

Full Name of Authorized person | Position

Katarina Rietz

QA/RA Manager

I, the undersigned, Notary Public, in and for the city of Helsingborg, Sweden, legalize the signature of a person KATARINA RIETZ who has identified himself/herself through the annexed document. It has to be notified that the undersigned, Notary Public, only legalize the signature.

Helsingborg, the 15 day of AUGUST 2017
 Christer Lewold





KÖRKORT SVERIGE

- 1. RIETZ
- 2. EVA KATARINA
- 3. 1967-07-31
- 4a. 2008-07-18 4c. Vägverket
- 4b. 2018-07-18 4d. 858008271
- 5. 670731-3927
- 7.



Eva Katarina Rietz

9. B





ADVOKATBOLAGET
CITADELLET
Brunnström & Rosén

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Sweden.
This public document of August 15th, 2017,
2. has been signed by Mr. Christer Lewold,
3. acting in capacity of Notary Public of Helsingborg
4. bears the seal/stamp of the Notary Public of Helsingborg.

Certified

5. at Landskrona, Sweden, 6. the 23rd of August, 2017,
7. by Stig Brunnström Notary Public of Landskrona.

8. N° 294/17

9. Seal/stamp:

10. Signature:



Stig Brunnström

Notarius Publicus i Landskrona
Notaire de la ville Landskrona
Notary Public of the city of Landskrona
Notario Público en Landskrona

NB: An Apostille certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Notary Public who has issued the Apostille approves of the contents.

I samarbete med advokat Jörygen Rosén

Växel/Ekonomi Eva Persson

Telefax

Not Publ/Advokat Stig Brunnström

E-post: sb@citadellet.se

0418-240 00

0418-240 01

0418-240 03

Advokat AB Citadellet

Norra Långgatan 24

S-261 31 Landskrona

www.citadellet.se

Bankgiro

5370-9978

5260-1697 (klient)



...s/org nr

...556446-8535

F-skattesedel innehas

Вих. № 448
26.12 2017 року

ТОВ «Долфі-Україна»
код ЄДРПОУ: 37068787
Місцезнаходження: 49130, місто Дніпро,
вул. Березинська, будинок 24-А

Щодо строку дії сертифікату відповідності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кратія Медтехніка» є уповноваженим представником компанії Becton Dickinson Infusion Therapy AB (адреса: Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-2. Helsingborg) відповідно до довіреності від 31 жовтня 2016 року.

ТОВ «Кратія Медтехніка», як уповноважений представник, даним листом інформує, що у декларації відповідності № DoCOO1UKR-HEL від 15 листопада 2011 року у графі «строк дії сертифікату відповідності» допущено технічну помилку і було зазначено строк дії сертифікату відповідності до 20.05.2022 року замість 20.06.2022 року.

Строк дії сертифікату відповідності зазначений у сертифікаті відповідності № PR. 251-17 і становить до 20 червня 2022 року (копія сертифікату додається).

З повагою,

Директор ТОВ «Кратія Медтехніка»

Євгенія Андрущенко

