

# ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

## ПАСПОРТ

Артикул: 1620002 : Бинт марлевий медичний 7 м x 14 см "Славна®", стерильний (тип 17)

ТУ У 21.2-19117325-011:2015

Номер партії: 230511 Стерилізація радіаційна.  
Дата виготовлення: 2023 -05  
Кількість 120 шт

№	Найменування основних показників	Пункт вимог технічних умов	Результати випробувань
1	Відповідність технологічній документації	4.2	Відповідає
2	Матеріали	4.3	Відповідає
3	Комплектність, маркування, пакування	4.4	Відповідає
4	Цілісність споживчого пакування	4.5	Відповідає
5	Герметичність споживчої тари	4.16	Відповідає
6	Зовнішній вигляд	4.6	Відповідає
7	Основні розміри	4.7	Відповідає
8	Перевірка маси та маси бруто	4.8	Відповідає
9	Стерильність	4.15	Відповідає


Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

### Висновок:

1620002 Бинт марлевий медичний 7 м x 14 см "Славна®", стерильний (тип 17) відповідає вимогам ТУ У 21.2-19117325-011:2015



Начальник БТК

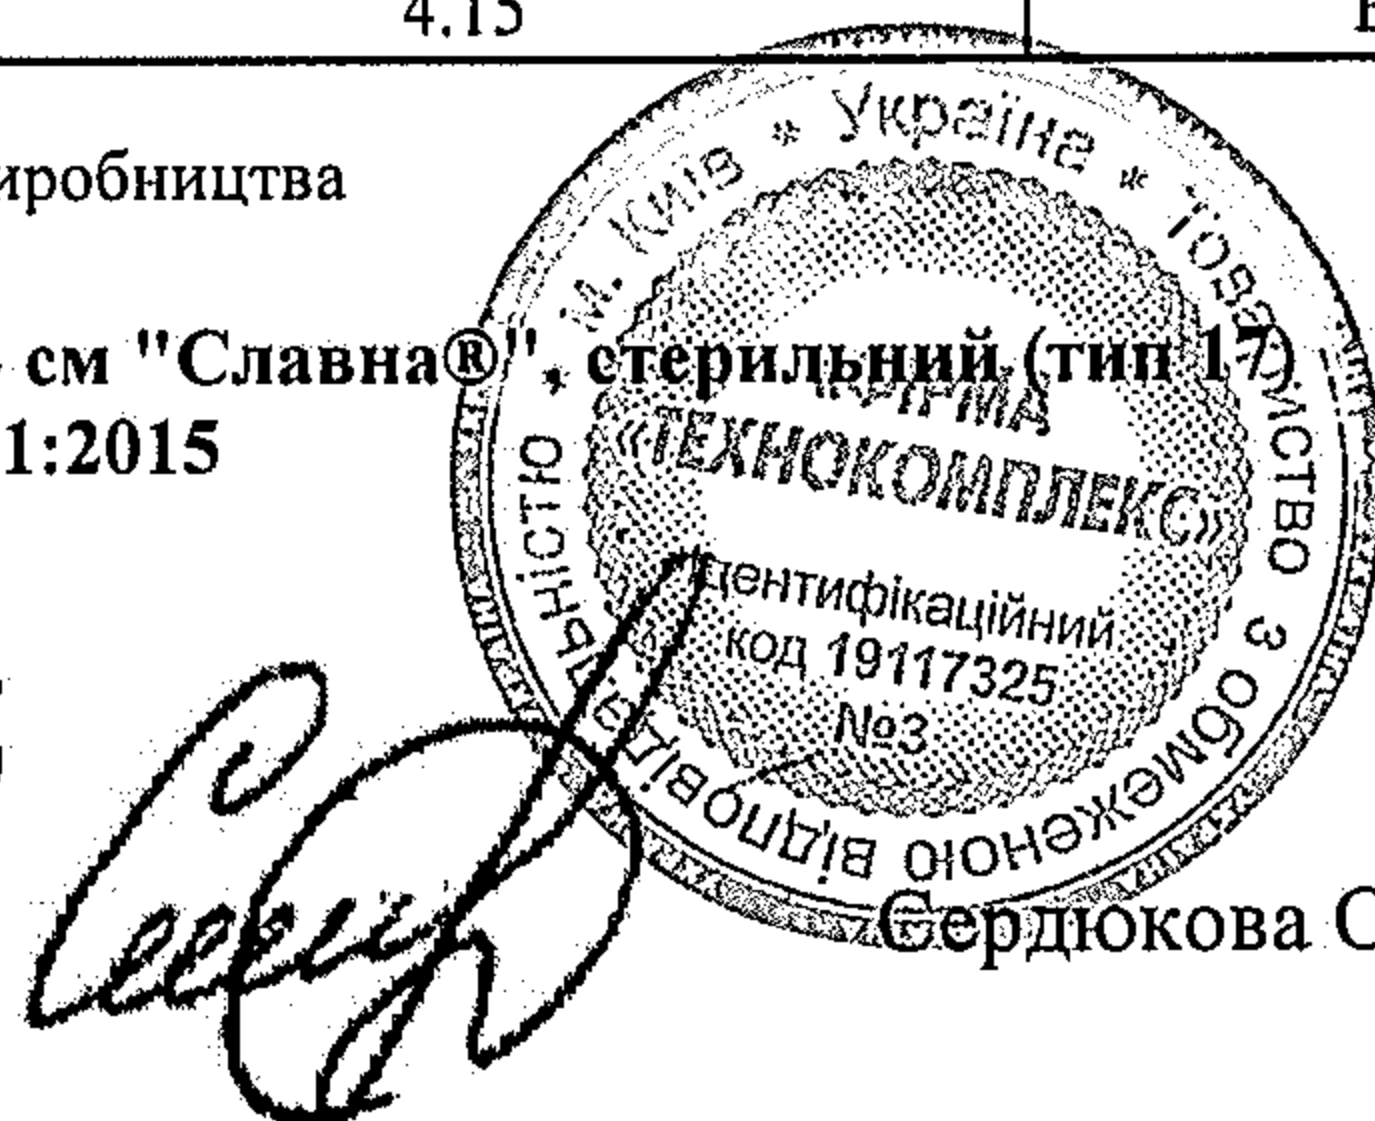

Сердюкова О.А.

# ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

## ПАСПОРТ

Артикул: 1620003 : Бинт марлевий медичний 5 м x 10 см "Славна®", нестерильний (тип 17)

ТУ У 21.2-19117325-011:2015

Номер партії: 230903  
Дата виготовлення: 2023 -09  
Кількість 600 шт

№	Найменування основних показників	Пункт вимог технічних умов	Результати випробувань
1	Відповідність технологічній документації	4.2	Відповідає
2	Матеріали	4.3	Відповідає
3	Комплектність, маркування, пакування	4.4	Відповідає
4	Цілісність споживчого пакування	4.5	Відповідає
5	Герметичність споживчої тари	4.16	Відповідає
6	Зовнішній вигляд	4.6	Відповідає
7	Основні розміри	4.7	Відповідає
8	Перевірка маси та маси бруто	4.8	Відповідає

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

### Висновок:

1620003 Бинт марлевий медичний 5 м x 10 см "Славна®", нестерильний (тип 17) відповідає вимогам ТУ У 21.2-19117325-011:2015




Начальник БТК



Сердюкова О.А.



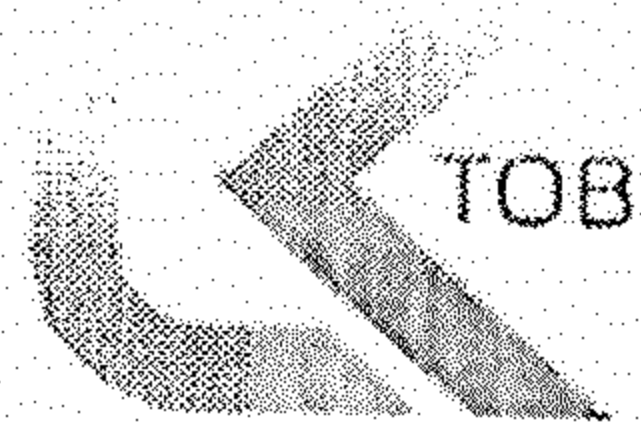

ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»

Р/р UA693209840000026001220263141  
в АТ «Прокредит Банк» м. Києва МФО 320984  
ЄДРПОУ 19117325



ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»,  
Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65,  
тел./факс: (044) 422 52 38, (044) 422 52 03,  
e-mail: info.slavna@gmail.com

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ 19117325.011-Інс-2019 від 04.11.2019 р.

з додатками № 1, 2

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»

Головний офіс: 03062, Київ, проспект Перемоги, 65, ЄДРПОУ 19117325  
Адреса виробництва: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 39

в особі директора Мазілкина Вадима Германовича

підтверджує, що медичний виріб:

«Засоби операційно-перев'язувальні медичні та їх набори», вводяться в обіг у нестерильному стані та відносяться до I класу (перелік виробів приведений у додатках),

який виготовляється за ТУ У 21.2-19117325-011:2015 (ДКПП 21.20.24-20.00)

Технічна документація на медичний виріб розроблена.

відповідає Технічному регламенту щодо медичних виробів,  
затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 р.

Оцінка відповідності проведена згідно процедур, зазначених в додатку 8  
«Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних  
виробів» Технічного регламенту щодо медичних виробів

Декларацію складено під цілковиту відповідальність  
ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»

Декларація дійсна з 04.11.2019 р. до 03.11.2024 р.



Дата: 04.11.2019

Місце складання: м. Сміла

Редакція: 1

Сторінка 1 з 1




## Додаток № 2 до Декларації про відповідність № 19117325.011-Інс-2019

№	Артикул	Найменування
<b>1. Бинти марлеві медичні</b>		
1.1	1620003	Бинт марлевий медичний 5 м x 10 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.2	1620004	Бинт марлевий медичний 7 м x 14 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.3	1620005	Бинт марлевий медичний 5 м x 10 см «Славна*» №2, нестерильний (тип 17)
1.4	1620007	Бинт марлевий медичний 7 м x 14 см «Славна*» №2, нестерильний (тип 17)
1.5	1620009	Бинт марлевий медичний 5 м x 5 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.6	1620011	Бинт марлевий медичний 5 м x 7 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.7	1620013	Бинт марлевий медичний 5 м x 14 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.8	1620015	Бинт марлевий медичний 7 м x 5 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.9	1620017	Бинт марлевий медичний 7 м x 7 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.10	1620019	Бинт марлевий медичний 7 м x 10 см «Славна*», нестерильний (тип 17)
1.11	1620021	Бинт марлевий медичний 7 м x 7 см №10 «Славна*», нестерильний (тип 17)
<b>2. Відрізи марлеві медичні</b>		
2.1	1630001	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 3 м «Славна*», нестерильний (тип 17)
2.2	1630002	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 5 м «Славна*», нестерильний (тип 17)
2.3	1630003	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 10 м «Славна*», нестерильний (тип 17)
2.4	1630004	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 100 м «Славна*», нестерильний (тип 17)
2.5	1630006	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 1 м «Славна*», нестерильний (тип 17)
2.6	1630008	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 100 м «Славна*», нестерильний (тип 20)
2.7	1630009	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 200 м «Славна*», нестерильний (тип 17)
2.8	1630010	Відріз марлевий медичний 0,9 м x 500 м «Славна*», нестерильний (тип 17)

Директор  
ТОВ "Фірма "Технокомплекс"

В.Г. Мазілін

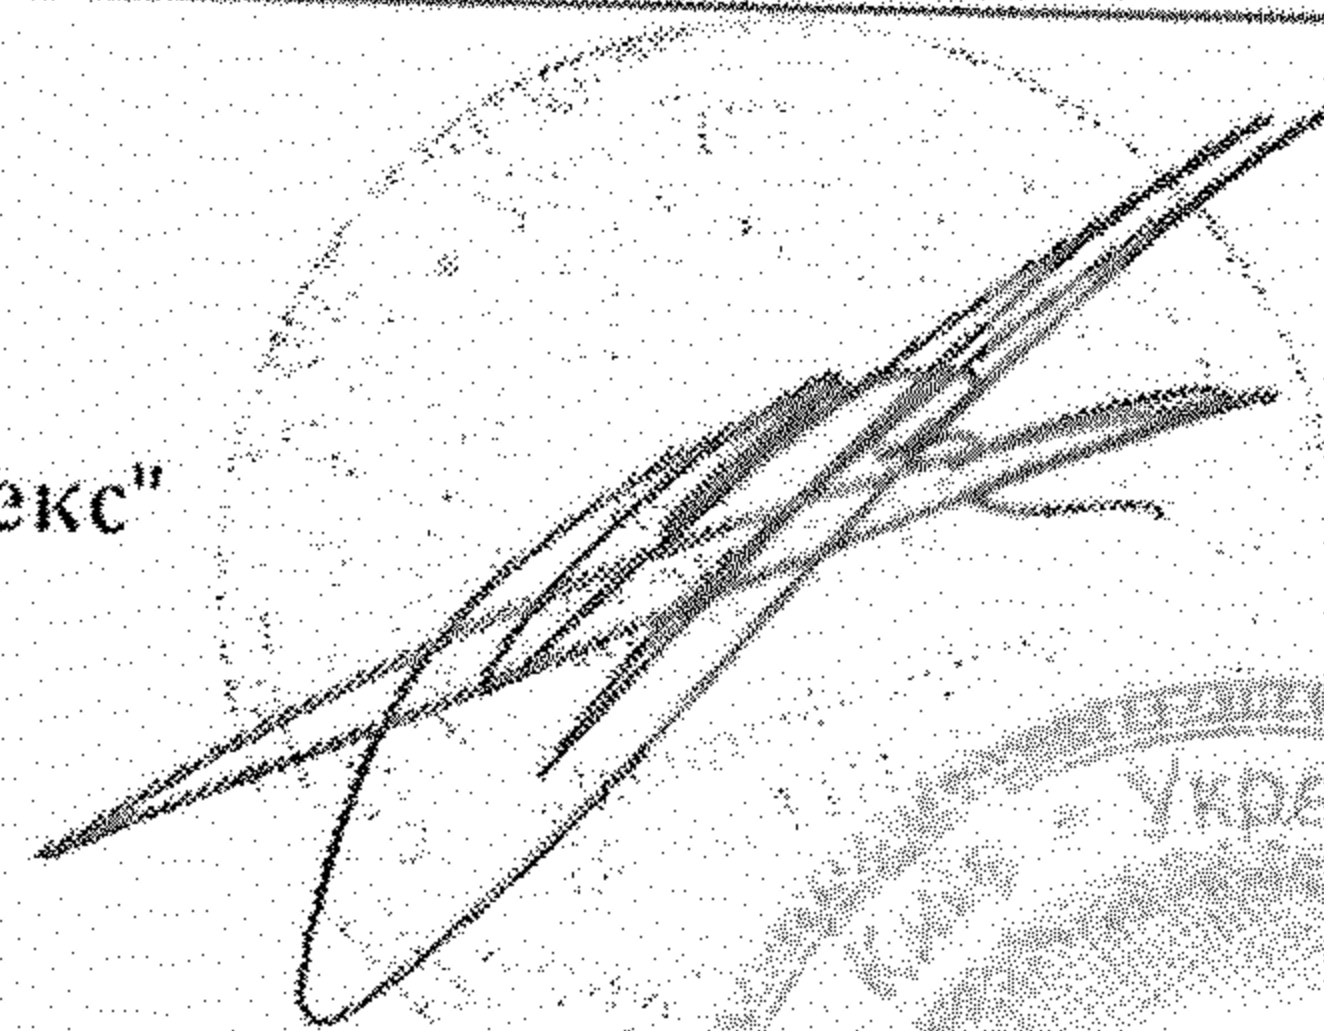




**ТЕХНОКОМПЛЕКС**

Розрахунковий рахунок 26001220263141  
в АТ «Прокредит Банк», МФО 320984,  
ЄДРПОУ 19117325



ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»  
Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65,  
тел./факс: (044) 422 52 38, (044) 422-52-03,  
e-mail: info.slavna@gmail.com

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ 19117325.011-Інс-2018 від 10.04.2018 р.

з додатками № 1, 2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Технокомплекс»,  
Головний офіс: 03062, Київ, проспект Перемоги 65, ЄДРПОУ 19117325  
Адреса виробництва: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 39

в особі директора Мазілкина Вадима Германовича

підтверджує, що медичний виріб:

«Засоби операційно-перев'язувальні медичні та їх набори «Славна®», вводяться в обіг у нестерильному стані та відносяться до I класу (перелік виробів приведений у додатках),

який виготовляється за ТУ У 21.2-19117325-011:2015 (ДКПТ 21.20.24-20.00)

Технічна документація на медичний виріб розроблена.

відповідає Технічному регламенту щодо медичних виробів,  
затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 р.

Оцінка відповідності проведена згідно процедур, зазначених в додатку 8  
«Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів» Технічного регламенту щодо медичних виробів

Декларацію складено під цілковиту відповідальність ТОВ «Фірма Технокомплекс»

Декларація дійсна з 10.04.2018 р. до 09.04.2023 р.



Директор

В.Г. Мазі



Додаток № 2 до Декларації про відповідність № 19117325.011-тис-2018

№	Артикул	Найменування
<b>1. Бинти марлеві медичні</b>		
1.1	1620003	Бинт марлевий медичний 5 м x 10 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.2	1620004	Бинт марлевий медичний 7 м x 14 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.3	1620005	Бинт марлевий медичний 5 м x 10 см "Славна*" №2, нестерильний (тип 17)
1.4	1620006	Бинт марлевий медичний 7 м x 14 см "Славна*" №2, нестерильний (тип 17)
1.5	1620008	Бинт марлевий медичний 5 м x 5 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.6	1620011	Бинт марлевий медичний 5 м x 7 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.7	1620013	Бинт марлевий медичний 5 м x 14 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.8	1620015	Бинт марлевий медичний 7 м x 5 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.9	1620017	Бинт марлевий медичний 7 м x 7 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.10	1620019	Бинт марлевий медичний 7 м x 10 см "Славна*", нестерильний (тип 17)
1.11	1620021	Бинт марлевий медичний 7 м x 7 см №10 "Славна*", нестерильний (тип 17)
<b>2. Відри марлеві медичні</b>		
2.1	1630001	Відри марлевий медичний 0,9 м x 3 м "Славна*", нестерильний (тип 17)
2.2	1630002	Відри марлевий медичний 0,9 м x 5 м "Славна*", нестерильний (тип 17)
2.3	1630003	Відри марлевий медичний 0,9 м x 10 м "Славна*", нестерильний (тип 17)
2.4	1630004	Відри марлевий медичний 0,9 м x 100 м "Славна*", нестерильний (тип 17)
2.5	1630006	Відри марлевий медичний 0,9 м x 1 м "Славна*", нестерильний (тип 17)
2.6	1630008	Відри марлевий медичний 0,9 м x 100 м "Славна*", нестерильний (тип 20)
2.7	1630009	Відри марлевий медичний 0,9 м x 200 м "Славна*", нестерильний (тип 17)
2.8	1630010	Відри марлевий медичний 0,9 м x 500 м "Славна*", нестерильний (тип 17)

Директор  
ТОВ "Фірма "Технокомплекс"



В.Г. Мазілкин

