



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
 e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 40/0324

Гірчичник – пакет
 Дитячий №10



Серія № 04/0324
 Дата виготовлення: 01. 2024
 Термін придатності: 01. 2026
 Кількість продукції в серії: 1 208 уп.
 Декларація про відповідність №03-2017 від 22.02.2017
 Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-002

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Відповідність технологічної документації	Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002	Відповідає вимогам цих ТФ і вироблено згідно технологічного регламенту	Відповідає
Габаритні та основні розміри	Довжина – 100мм ±5мм	100 мм	Відповідає
	Ширина – 110мм ± 5мм	110 мм	Відповідає
Маса	Маса гірчичник-пакета не більше 6г. Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002	3,2 г	Відповідає
	Маса вмісту чарунок одного гірчичник-пакета не менше 1,5г. Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002	2,3 г	Відповідає
Особливості типу та складу	Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002	Пакет з паперу ламінованого та пористого паперу, розділений перфорацією на чотири чарунки, рівномірно заповнених гірчичною сумішшю жовтого кольору з чорними краплями, без комків.	Відповідає
Масова частка жому гірчичного	Масова частка жому гірчичного у гірчичниках не повинна перевищувати 50%. Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002	Масова частка жому гірчичного 30%.	Відповідає
Герметичність гірчичників-пакетів	Гірчичники - пакети, які заповнені гірчичною сумішшю повинні бути герметичними. Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002, Б.4.5.5	Відсутні сліди висипання гірчичної суміші, після перевірки.	Відповідає
Герметичність пакетів після термозварювання	Після термозварювання шви повинні бути рівними, без щілин та розривів. Гірчичники у поліетиленовому пакеті після термозварювання повинні бути герметичними. Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002, Б.4.5.6	Немає виходу повітря з пакету, шви рівні без щілин та розривів.	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Згідно вимогам ТФ КМВК-ТФ-002, Б.4.5.7	Комплект гірчичників – пакетів відповідає Б.4.5.3 таблиці 3. Маркування згідно Б.4.5.7. Пакування згідно Б.4.5.7	Відповідає

Висновок: Гірчичник – пакет Дитячий, серія 04/0324, дата виготовлення: 01.2024, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-002 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від +10 до +25 °С, вологість від 40 до 75%.

Заступник директора з виробництва **Зименко О.В.**
 19.01.2024 р.

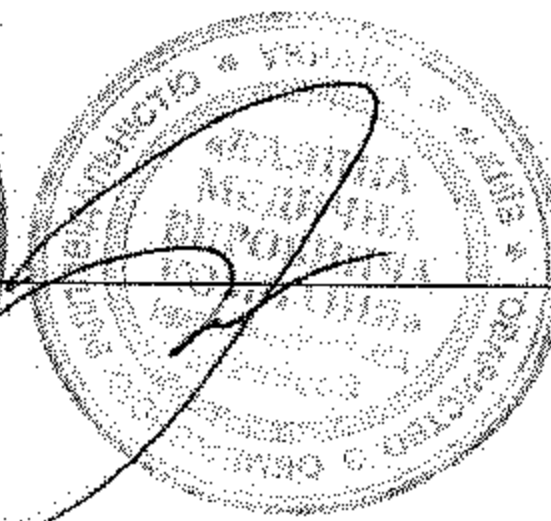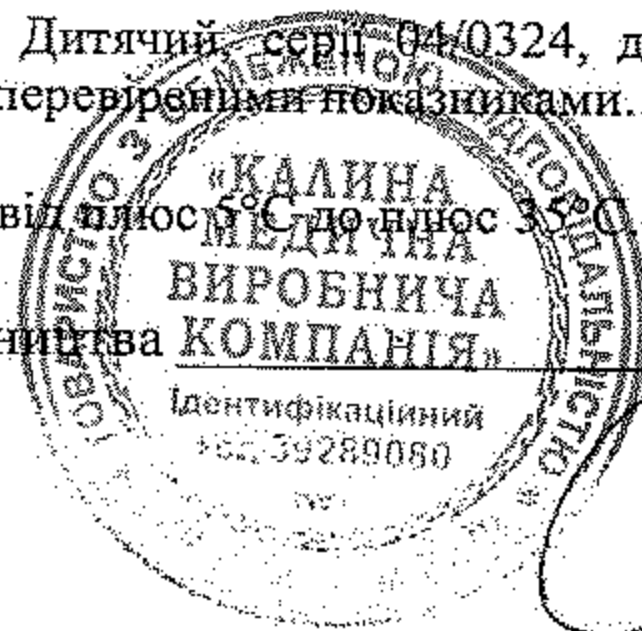

Handwritten signature and date: 24.01.2024