



ПАСПОРТ ЯКОСТІ  
№ 86



Шприці ін'єкційні Tigated, 10 ml, двокомпонентний, стерильний, з голкою 0,8 mm x 38 (21 G x 1 1/2")

ТУ У 64-00480922-25-96

003

14400

2023 02

2028 01


24164

Найменування основних показників	Вимоги ТУ У 64-00480922-25-96	Результати випробувань
1. Цілісність споживчої тари	Споживча тара з вкладеним в неї шприцом повинна бути цілісна. На поверхні не допускаються пориви та інші пошкодження, що відкривають доступ до внутрішньої поверхні споживчої тари	Відповідає
2. Комплектність	У комплект постачання шприца в споживчій тарі повинно входити: 1) шприц або шприц з голкою (для шприца з фіксованою голкою) – 1 шт. 2) голка ін'єкційна (для шприців з наконечником «Луер» або «Луер-Лок»). Шприц може не комплектуватися голкою ін'єкційною або комплектуватися 1 чи 2 голками.	Відповідає
3. Чистота внутрішньої поверхні шприців	3) етикетка – 1 шт. в транспортну тару Внутрішня поверхня шприца до поршня повинна бути чистою та не мати сторонніх частинок.	Відповідає
4. Водонепроникність з'єднання шприців	Ущільнення поршня в циліндрі та конусне з'єднання наконечника циліндра з голкою (для ін'єкційної та з'єднання шприца з голкою (для шприців з фіксованою голкою) повинне бути водонепроникним	Відповідає
5. Стерильність, пірогенність, токсичність	Шприці повинні бути стерильні, апірогенні, нетоксичні.	Відповідає

**Висновок:** Шприці ін'єкційні виготовлені на підприємстві з впровадженою системою управління якістю ISO 9001, ДСТУ EN ISO 13485. Шприці відповідають вимогам «Технічного регламенту щодо медичних виробів та ОХУ У 64-00480922-25-96» підтверджено Декларацією про відповідність № 0039/2023 (ред. 0 від 05.09.2023) за м. Київ.

Заступник директора з якості  
Дата

ТОВ «Г.О. Фабрика»  
м. Білгород-Дніпровський, Одеська область  
Код ЄДРРНО: 40088132; ІПН: 40088132; ІПН ЄДРРНО: 40088132

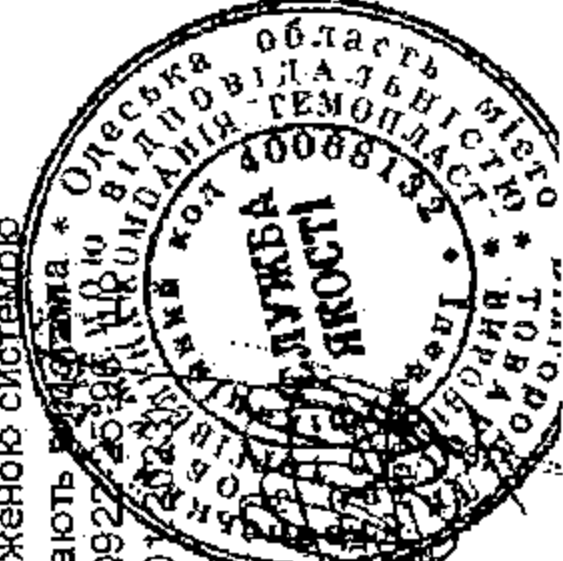

Вх м 548807 29.06.25.



ПАСПОРТ ЯКОСТІ  
№ 36

Шприці ін'єкційні Tigated, 20 ml, двокомпонентний, стерильний, з голкою 0,8 mm x 38 mm (21 G x 1 1/2")

ТУ У 64-00480922-25-96

001

13440

2023 01

2027 12


24169

Найменування основних показників	Вимоги ТУ У 64-00480922-25-96	Результати випробувань
1. Цілісність споживчої тари	Споживча тара з вкладеним в неї шприцом повинна бути цілісна. На поверхні не допускаються пориви та інші пошкодження, що відкривають доступ до внутрішньої поверхні споживчої тари	Відповідає
2. Комплектність	У комплект постачання шприца в споживчій тарі повинно входити: 1) шприц або шприц з голкою (для шприца з фіксованою голкою) – 1 шт. 2) голка ін'єкційна (для шприців з наконечником «Луер» або «Луер-Лок»). Шприц може не комплектуватися голкою ін'єкційною або комплектуватися 1 чи 2 голками.	Відповідає
3. Чистота внутрішньої поверхні шприців	3) етикетка – 1 шт. в транспортну тару Внутрішня поверхня шприца до поршня повинна бути чистою та не мати сторонніх частинок.	Відповідає
4. Водонепроникність з'єднання шприців	Ущільнення поршня в циліндрі та конусне з'єднання наконечника циліндра з голкою (для ін'єкційної та з'єднання шприца з голкою (для шприців з фіксованою голкою) повинне бути водонепроникним	Відповідає
5. Стерильність, пірогенність, токсичність	Шприці повинні бути стерильні, апірогенні, нетоксичні.	Відповідає

**Висновок:** Шприці ін'єкційні виготовлені на підприємстві з впровадженою системою управління якістю ISO 9001, ДСТУ EN ISO 13485. Шприці відповідають вимогам «Технічного регламенту щодо медичних виробів та ОХУ У 64-00480922-25-96» підтверджено Декларацією про відповідність № 0039/2023 (ред. 0 від 05.09.2023) за м. Київ.

Заступник директора з якості  
Дата

ТОВ «Г.О. Фабрика»  
м. Білгород-Дніпровський, Одеська область  
Код ЄДРРНО: 40088132; ІПН: 40088132; ІПН ЄДРРНО: 40088132

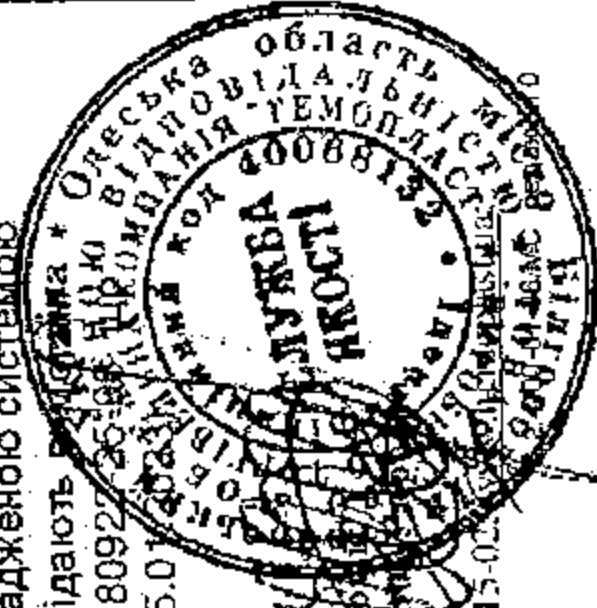

Вх м 548807 29.06.25.


**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 036**

<b>Виробник, адреса</b>	Публічне акціонерне товариство „Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів „Гемопласт” вул. Маяковського, 57, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, Україна тел.: +38 (04849) 3-15-62; факс: +38 (04849) 3-15-02 Код ЄДРПОУ 00480922
<b>Об'єкт декларації</b>	<b>Шприци ін'єкційні, стерильні, з голками та без голок торгової марки Tiramed®(згідно з додатком)</b>
<b>Клас безпеки</b>	Па – шприци з голками; I – шприци без голок
<b>Об'єкт декларації відповідає вимогам стандартів</b>	ДСТУ EN ISO 13485:2018; ДСТУ EN 556-1:2014; ДСТУ EN 1041:2015; ДСТУ EN ISO 15223-1:2018; ДСТУ EN ISO 11135-1:2015; ДСТУ EN ISO 11607-1:2015; ДСТУ EN ISO 11607-2:2015; ДСТУ EN ISO 10993-1:2015; ДСТУ EN ISO 10993-4:2015; ДСТУ EN ISO 10993-5:2015; ДСТУ EN ISO 10993-7:2015; ДСТУ ISO 10993-10:2004; ДСТУ EN ISO 10993-11:2015; ДСТУ EN ISO 11737-2:2015; ДСТУ EN ISO 14971:2015; ДСТУ EN 20594-1:2015; ТУ У 64-00480922-25-96
<b>Вимоги технічних регламентів</b>	Технічний регламент щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753) - Додаток 1: Основні вимоги до медичних виробів
<b>Процедура технічного регламенту, що застосовується</b>	Технічний регламент щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753) - Додаток 3: Забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (за винятком розділу «Перевірка проекту медичного виробу»)
<b>Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності</b>	ПАТ «Гемопласт», вул. Маяковського, 57, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, Україна
<b>Орган з оцінки відповідності</b>	Державне українське об'єднання «Політехмед» вул. І. Мазепи, 10, м. Київ, 01010, Україна Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.05.2014 р. № 579 Ідентифікаційний номер призначеного органу UA.TR.101
<b>Додаткова інформація</b>	Сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів № UA.TR.101.MD.3.0350-19.01 від 20.11.2019 р.
<b>Дата оформлення декларації про відповідність</b>	20.11.2019 р. Редакція 3
<b>Термін дії декларації</b>	до 26.11.2023 р.

Декларація про відповідність складена під цілковиту відповідальність виробника

В.о. голови правління ПАТ «Гемопласт»  
(посада)


В.О. Яковлевський  
(прізвище)

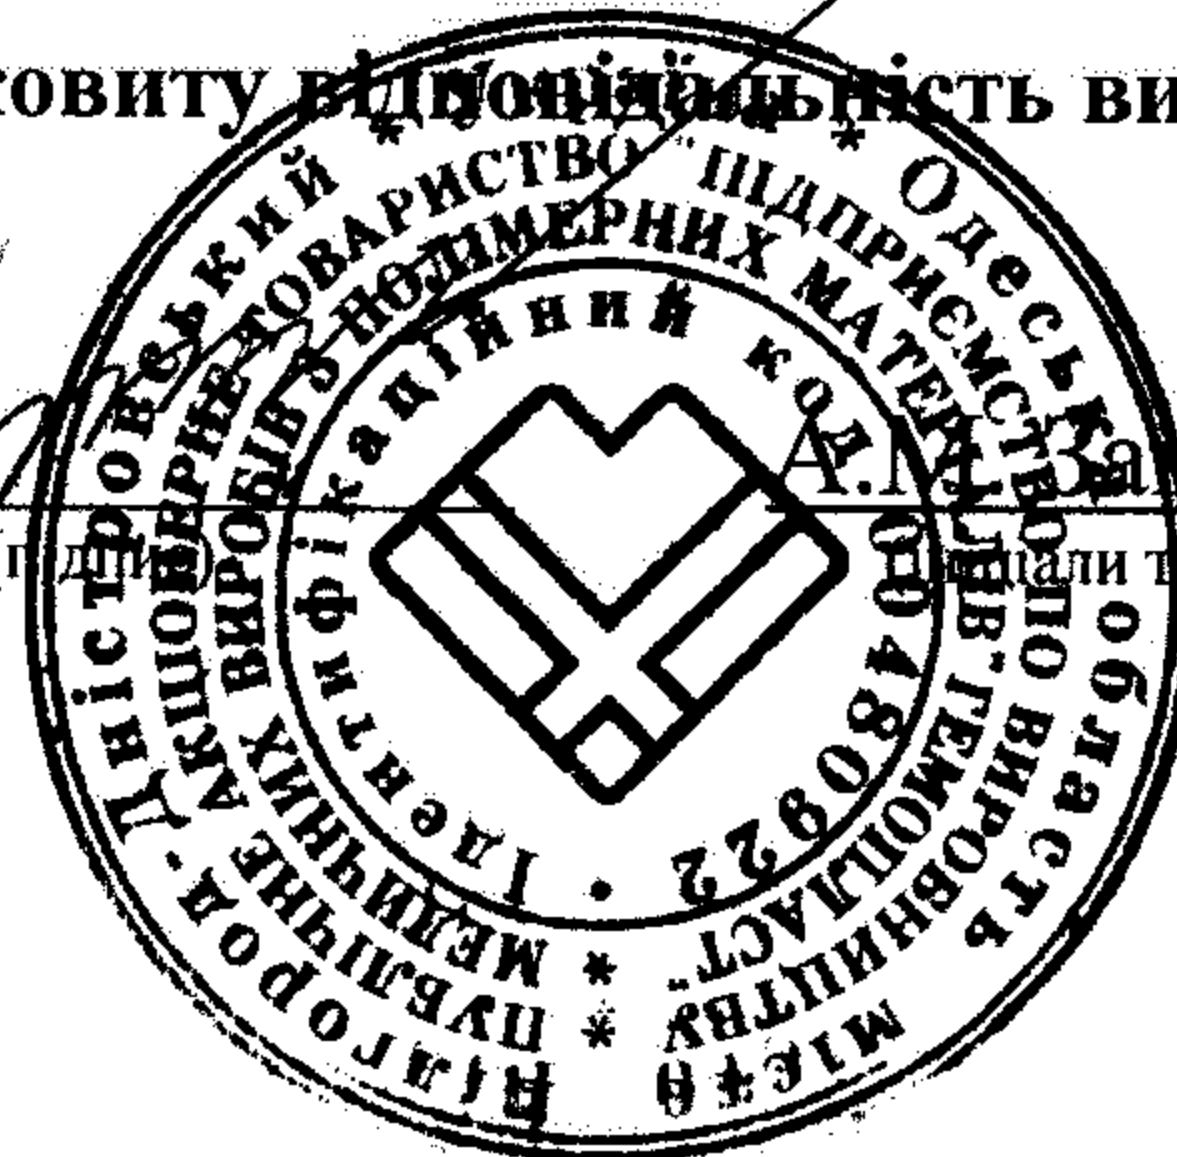


**ДОДАТОК  
ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 036**

№	Найменування модифікацій медичного виробу
1	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 0,5 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-40
2	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 0,5 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-100
3	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 1 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-40
4	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 1 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-100
5	Шприци ін'єкційні Tiramed®, 0,5 ml, трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-40, комплект
6	Шприци ін'єкційні Tiramed®, 0,5 ml, трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-100, комплект
7	Шприци ін'єкційні Tiramed®, 1 ml, трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-40, комплект
8	Шприци ін'єкційні Tiramed®, 1 ml, трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-100, комплект
9	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 2 ml, трьохкомпонентний, стерильний
10	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 2 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою
11	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 2 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками
12	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 5 ml, трьохкомпонентний, стерильний
13	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 5 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою
14	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 5 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками
15	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 10 ml, трьохкомпонентний, стерильний
16	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 10 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою
17	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 10 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками
18	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 20 ml, трьохкомпонентний, стерильний
19	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 20 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою
20	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 20 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками
21	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 50 ml, трьохкомпонентний, стерильний
22	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 50 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою
23	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 50 ml, трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками
24	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 2 ml, двокомпонентний, стерильний
25	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 2 ml, двокомпонентний, стерильний, з голкою
26	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 2 ml, двокомпонентний, стерильний, з 2 голками
27	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 5 ml, двокомпонентний, стерильний
28	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 5 ml, двокомпонентний, стерильний, з голкою
29	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 5 ml, двокомпонентний, стерильний, з 2 голками
30	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 10 ml, двокомпонентний, стерильний
31	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 10 ml, двокомпонентний, стерильний, з голкою
32	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 10 ml, двокомпонентний, стерильний, з 2 голками
33	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 20 ml, двокомпонентний, стерильний
34	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 20 ml, двокомпонентний, стерильний, з голкою
35	Шприц ін'єкційний Tiramed®, 20 ml, двокомпонентний, стерильний, з 2 голками

В.о. голови правління І  
(посада)

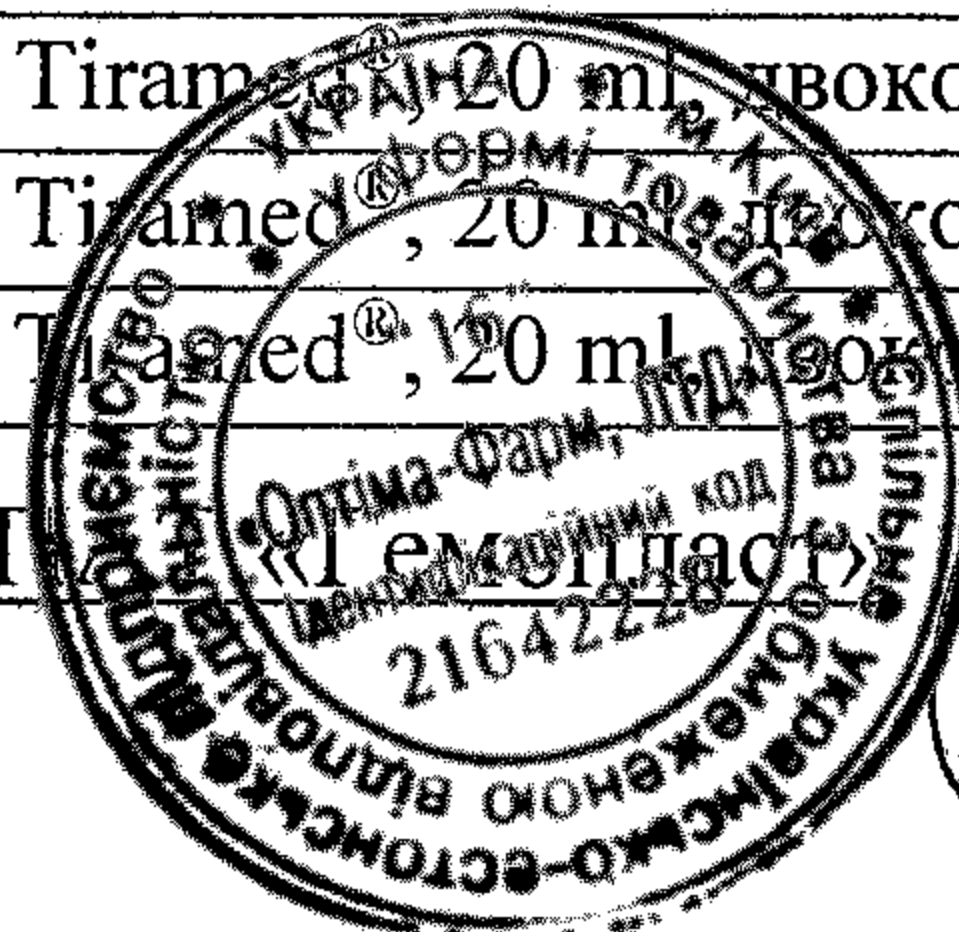


(підпис)

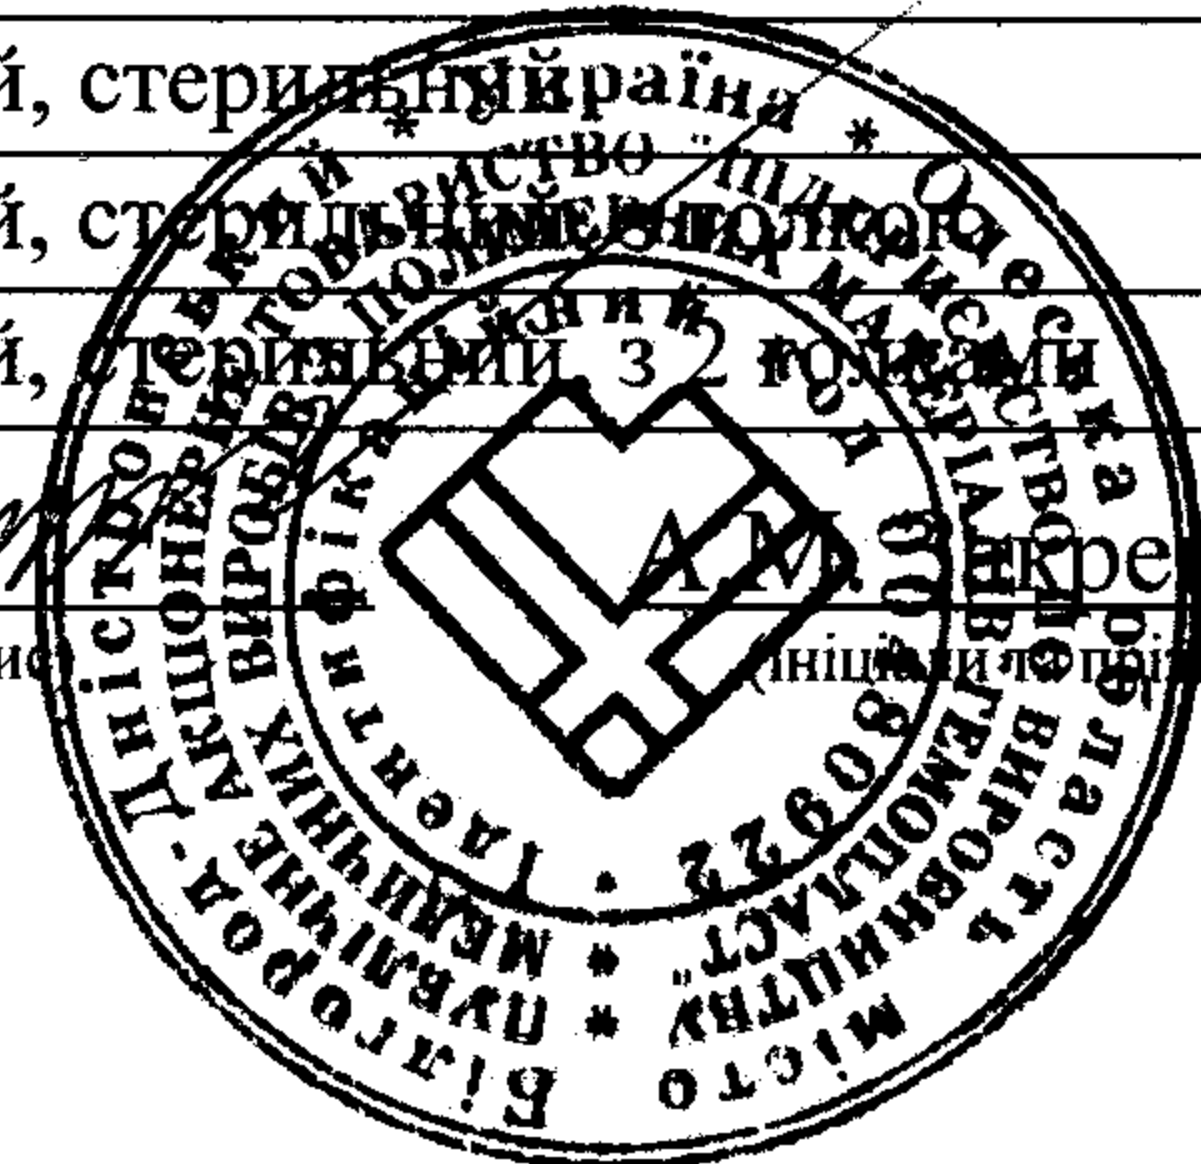

(підпис)



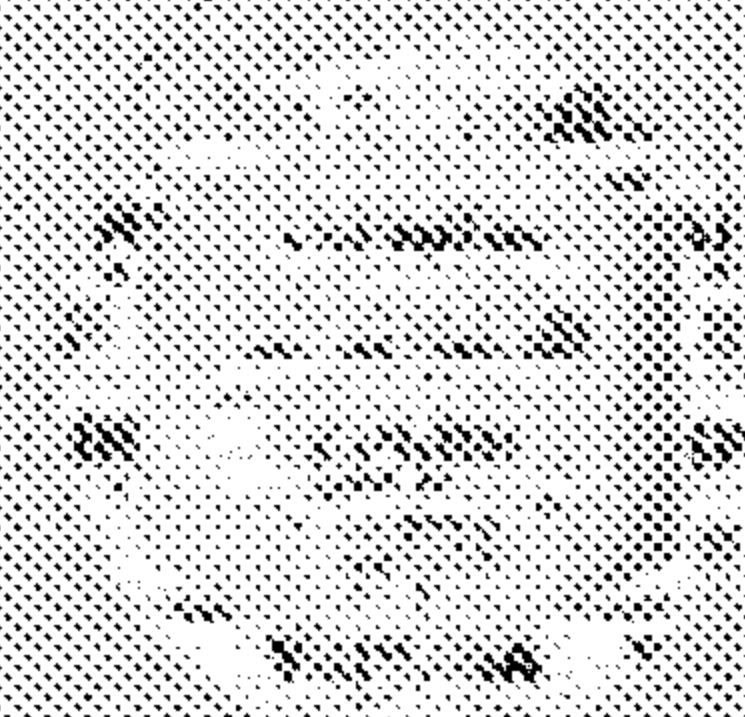

№ 000816

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
**Certificate of Conformity**

№ UA.101.MD 3.0350-19.01

Дата реєстрації 20.11.2019 р.

Термін дії до 26.11.2023 р.

**Продукція**  
*Production*

**Затискач для пуповини, інструменти зондуючі полімерні, набори гінекологічні, набір виробів для дренажу, шприц з конусом для під'єднання катетера, одяг та білизна медичні, інструменти оториноларингологічні, голки ін'єкційні, пристрій для взяття крові ВК, пристрій для вливання, пристрій для переливання, шприци ін'єкційні, з голками та без голок, подовжувач полімерний для шприцевих насосів**

Перелік продукції наведений в Додатку до сертифікату відповідності

**Відповідає вимогам**  
*Comply with the requirements*

**Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 753**

**Виробник**  
*Producer(s)*

**Публічне акціонерне товариство «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»**  
вул. Маяковського, 57, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, Україна. ЄДРПОУ 00480922

**Місце виробництва**  
*Place of production*

**Публічне акціонерне товариство «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт»**  
вул. Маяковського, 57, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700, Україна

**Сертифікат виданий**  
*Certificate is issued by*

**Органом з оцінки відповідності Державного українського об'єднання «ПОЛІТЕХМЕД» (ООВ «ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»)**

**На підставі**  
*On the grounds of*

Оцінки та схвалення функціонування комплексної системи управління якістю згідно з Додатком 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів. Рішення щодо внесення змін до сертифікату відповідності від 20.11.2019 р.

Нагляд за схваленою системою управління якістю здійснюється з періодичністю, яка регламентується програмою нагляду

**Р. Картавцев**

Підпис М.П.

**Генеральний директор**  
**ДУО «Політехмед»****Керівник Органу з оцінки відповідності**



# ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0350-19.01

Дата реєстрації 20.11.2019 р.

Термін дії до 26.11.2023 р.

Аркуш 1 з 3

№ з/п	Найменування медичних виробів	Клас безпеки
	<b>Затискач для пуповини, стерильний торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
1	Затискач для пуповини	I
	<b>Інструменти зондуючі полімерні, стерильні торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
2	Катетер ректальний	I
3	Катетер носовий дитячий кисневий	I
4	Катетер носовий дитячий секреторний	I
5	Катетер шлунковий дитячий	IIa
6	Катетер пупковий дитячий	IIa
7	Зонд шлунковий	IIa
8	Зонд дуоденальний	IIa
9	Катетер ендобронхотрахеальний	IIa
	<b>Набори гінекологічні, стерильні торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
10	Набір гінекологічний	I
11	Дзеркало гінекологічне (дзеркало типу Куско)	I
12	Шпатель цервікальний (шпатель Ейера)	I
13	Ложка цервікальна (ложка Фолькмана)	I
14	Щітка цитологічна	I
	<b>Набір виробів для дренажування, стерильний торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
15	Набір виробів для дренажування	IIa
16	Дренаж двоканальний	IIa
17	Дренаж прямий	IIa
18	Дренаж-петля	IIa
19	Сильфон	I
	<b>Шприц з конусом для під'єднання катетера, стерильний торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
20	Шприц з конусом для під'єднання катетера	I
	<b>Одяг та білизна медичні, стерильні торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
21	Одяг хірургічний стерильний, комплект	I
22	Одяг та білизна для породіллі стерильні, комплект	I
23	Одяг акушерський стерильний, комплект	I
24	Халат хірургічний стандартний, стерильний	I
25	Халат хірургічний удосконалений, стерильний	I
26	Халат медичний стерильний	I
27	Сорочка медична стерильна	I
28	Покриття медичне стерильне	I
29	Маска медична тришарова, стерильна	I
30	Бахіли медичні, стерильні	I



# ДОДАТОК


до сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0350-19.01

Дата реєстрації 20.11.2019 р.


Термін дії до 26.11.2023 р.

Аркуш 2 з 3

31	Шапочка-ковпак медична стерильна	I
32	Шапочка-берет медична стерильна	I
	<b>Інструменти оториноларингологічні, стерильні торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
33	Шпатель ларингологічний (шпатель ЛОР)	I
34	Воронка вушна	I
	<b>Голки ін'єкційні, стерильні торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
35	Голка ін'єкційна	IIa
	<b>Пристрій для взяття крові ВК, стерильний торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
36	Пристрій для взяття крові ВК	IIa
	<b>Пристрої для вливання, стерильні торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
37	Пристрій для вливання інфузійних розчинів HEMOPLAST®, стерильний, ВР	IIa
38	Пристрій для вливання інфузійних розчинів HEMOPLAST®, стерильний, ВКР	IIa
	<b>Пристрій для переливання, стерильний торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
39	Пристрій для переливання крові HEMOPLAST®, стерильний, ПК 21-02	IIa
	<b>Шприци ін'єкційні, стерильні, з голками та без голок торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
40	Шприц ін'єкційний, трьохкомпонентний, з голкою, Інсулін U-40	IIa
41	Шприц ін'єкційний, трьохкомпонентний, з голкою, Інсулін U-100	IIa
42	Шприци ін'єкційні, трьохкомпонентні, з голкою, Інсулін U-40, комплект	IIa
43	Шприци ін'єкційні, трьохкомпонентні, з голкою, Інсулін U-100, комплект	IIa
44	Шприц ін'єкційний, двокомпонентний	I
45	Шприц ін'єкційний, двокомпонентний, з голкою	IIa
46	Шприц ін'єкційний, двокомпонентний, з 2 голками	IIa
47	Шприц ін'єкційний, трьохкомпонентний	I
48	Шприц ін'єкційний, трьохкомпонентний, з голкою	IIa
49	Шприц ін'єкційний, трьохкомпонентний, з 2 голками	IIa
	<b>Подовжувач полімерний для шприцевих насосів, стерильний торгової марки HEMOPLAST®:</b>	
50	Подовжувач полімерний для шприцевих насосів	IIa
	<b>Голки ін'єкційні, стерильні торгової марки Tigamed®:</b>	
51	Голка ін'єкційна Tigamed®, стерильна	IIa
	<b>Пристрій для вливання, стерильний торгової марки Tigamed®:</b>	
52	Пристрій для вливання інфузійних розчинів Tigamed®, стерильний, ВР	IIa
	<b>Пристрій для переливання, стерильний торгової марки Tigamed®:</b>	
53	Пристрій для переливання крові Tigamed®, стерильний, ПК 21-02	IIa
	<b>Шприци ін'єкційні, стерильні, з голками та без голок торгової марки Tigamed®:</b>	
54	Шприц ін'єкційний Tigamed®, трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-40	IIa

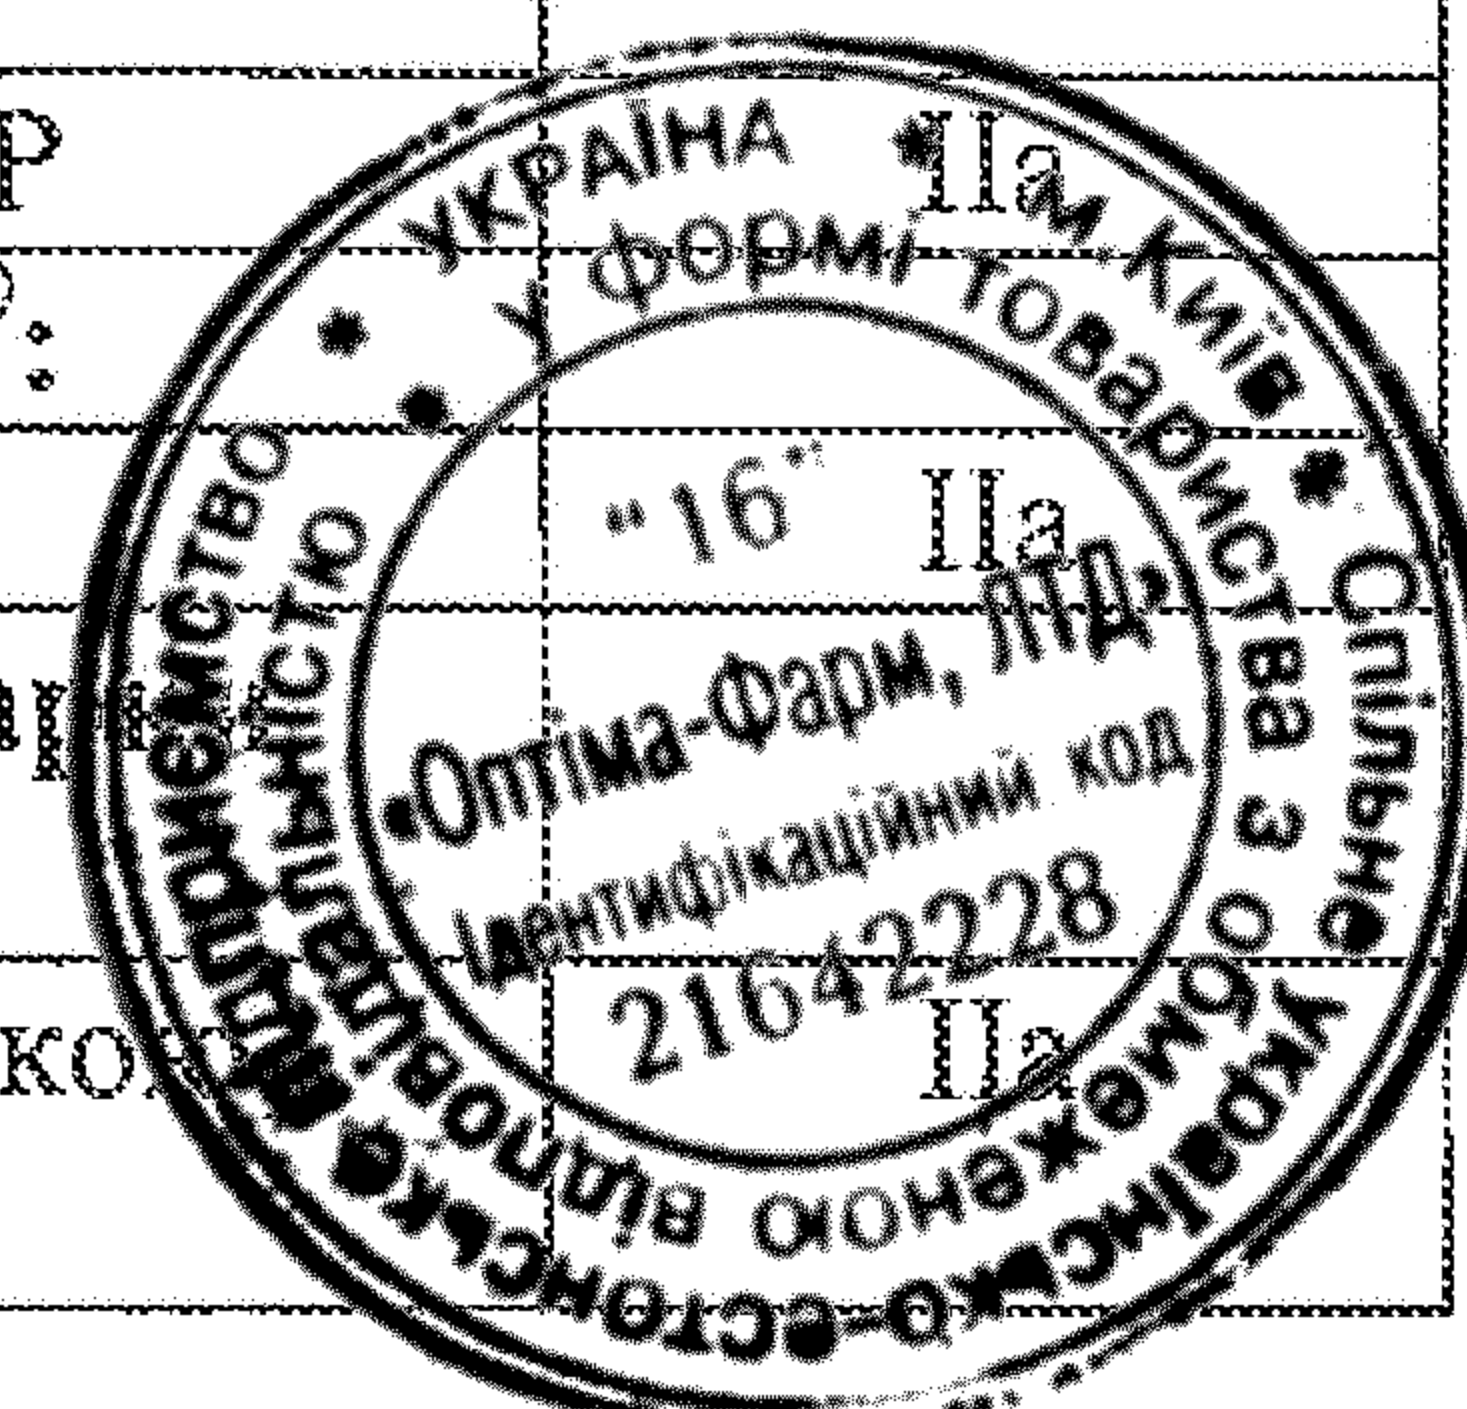



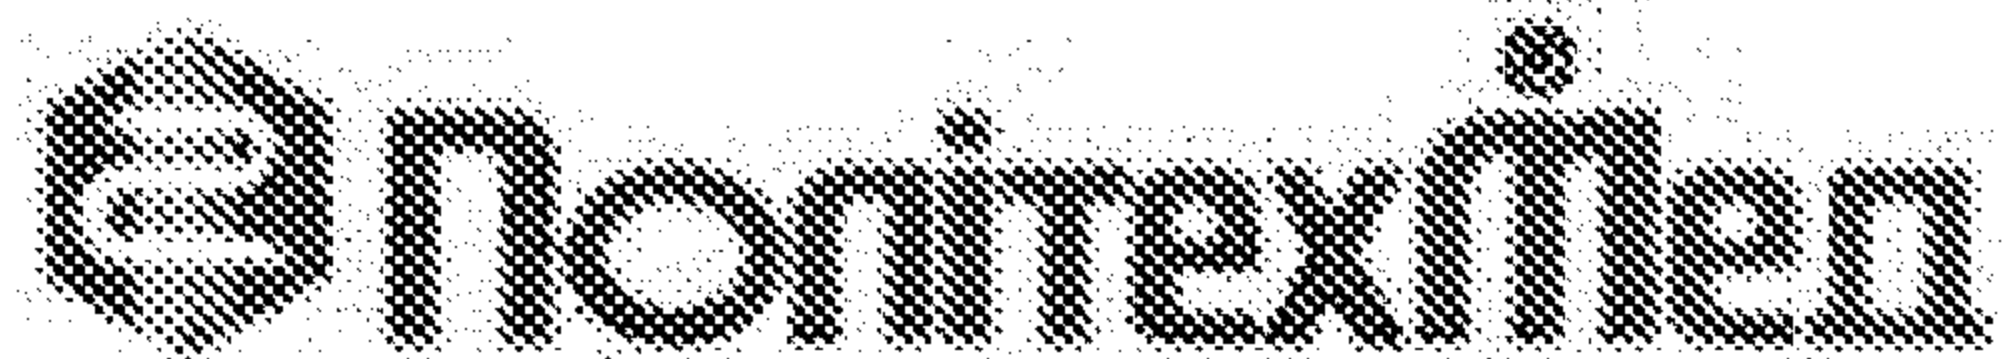

Орган з оцінки відповідності «Державне українське об'єднання «ПОЛІТЕХМЕД»

UA.TR.101

# ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № UA.101.MD.3.0350-19.01

Дата реєстрації 20.11.2019 р.

Термін дії до 26.11.2023 р.

Аркуш 3 з 3

55	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-100	IIa
56	Шприци ін'єкційні Tiramed <sup>®</sup> , трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-40, комплект	IIa
57	Шприци ін'єкційні Tiramed <sup>®</sup> , трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-100, комплект	IIa
58	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , двокомпонентний, стерильний	I
59	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , двокомпонентний, стерильний, з голкою	IIa
60	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , двокомпонентний, стерильний, з 2 голками	IIa
61	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний	I
62	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний, з голкою	IIa
63	Шприц ін'єкційний Tiramed <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками	IIa
	<b>Пристрій для вливання, стерильний торгової марки ARTERIUM<sup>®</sup>:</b>	
64	Пристрій для вливання інфузійних розчинів ARTERIUM <sup>®</sup> , стерильний, ВР	IIa
	<b>Пристрій для переливання, стерильний торгової марки ARTERIUM<sup>®</sup>:</b>	
65	Пристрій для переливання крові ARTERIUM <sup>®</sup> , стерильний, ПК 21-02	IIa
	<b>Шприци ін'єкційні, стерильні, з голками торгової марки ARTERIUM<sup>®</sup>:</b>	
66	Шприц ін'єкційний ARTERIUM <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний, з голкою, Інсулін U-100	IIa
67	Шприци ін'єкційні ARTERIUM <sup>®</sup> , трьохкомпонентні, стерильні, з голкою, Інсулін U-100, комплект	IIa
68	Шприц ін'єкційний ARTERIUM <sup>®</sup> , двокомпонентний, стерильний, з голкою	IIa
69	Шприц ін'єкційний ARTERIUM <sup>®</sup> , двокомпонентний, стерильний, з 2 голками	IIa
70	Шприц ін'єкційний ARTERIUM <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний, з голкою	IIa
71	Шприц ін'єкційний ARTERIUM <sup>®</sup> , трьохкомпонентний, стерильний, з 2 голками	IIa

Генеральний директор  
ДУО «ПОЛІТЕХМЕД»  
Керівник Органу з оцінки відповідності

М.П.



Р. Картавцев

