

# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ БМП-05/2023

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛКОМ ЛТД» (ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»  
(повна назва виробника або його уповноваженої особи або постачальника,

Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 12-Г, кв. 49, код ЄДРПОУ  
36232879

(місце знаходження, для вітчизняного виробника – код ЄДРПОУ)

в особі Директора ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД» Селіхова Сергія Володимировича  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує,

що **Банки для масажу полімерні:**

- косметичний виріб
1. БМП-20 (діаметр 20 мм)
  2. БМП-35 (діаметр 35 мм)
  3. БМП-70 (діаметр 70 мм)
  4. БМП-5 (діаметр 5 мм)
  5. БМП-30 (діаметр 30 мм)
  6. БМПН – 4 (діам.: 5 мм, 20 мм, 35 мм, 70 мм)
  7. БМПН – 5 (діам.: 5 мм – 2 шт., 20 мм – 2 шт., шпатель – 1 шт.)
  8. БМПН – 6 (діам.: 20 мм – 2 шт., 35 мм – 2 шт., 70 мм – 2 шт.)
  9. БМПН – 3 (діам.: 35 мм – 2 шт., 70 мм – 1 шт.)

(повна назва продукції, тип, марка, модель)

виробництва **Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛКОМ ЛТД»**  
Україна, 65031, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 12-Г, кв. 49 код  
ЄДРПОУ 36232879; Адреса виробництва: вул. Дальницька, 44, м. Одеса,  
Україна, 65005

(назва, адреса виробника, місце виробництва, для вітчизняного – код ЄДРПОУ)

виготовляється **згідно з технічним файлом та ТУ У 32.5-36232879-004:2012**  
серійно


(назва та позначення документації)

Відповідає: **ДСТУ EN 980:2007; ДСТУ ISO 14971:2009; ДСТУ ISO 10993-1:2004;**  
**ДСТУ ISO 10993-5:2004; ДСТУ ISO 10993-10:2004**

(позначення нормативних документів /за наявності/)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника - ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»

Директор

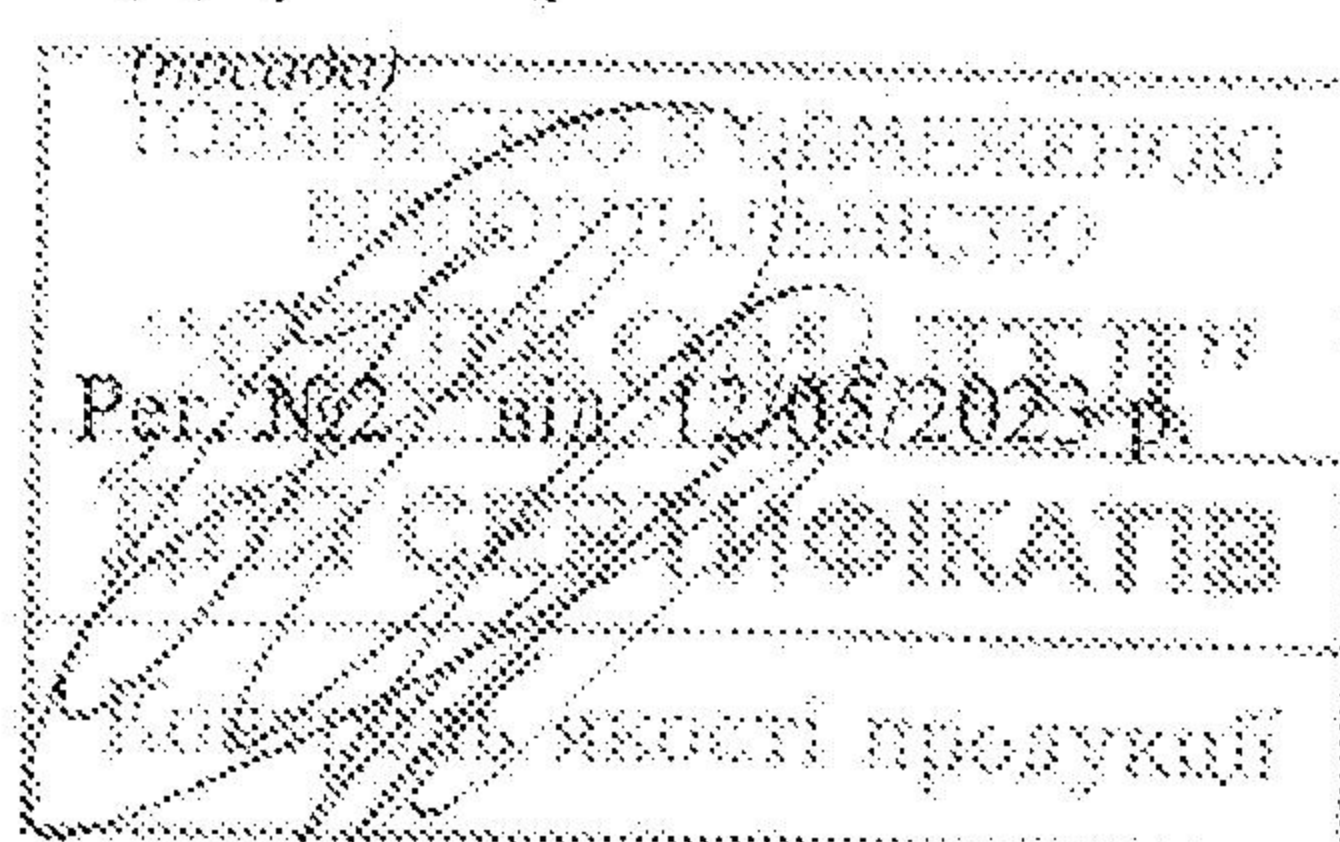

С.В.Селіхов

(ініціали та прізвище)

Термін дії декларації: 3 роки.







## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Об'єкт сертифікації: вання продукції : Банки вакуумні масажні

Виробник : ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»

Органолептичні та фізико-хімічні показники :

Назва показників :	Показники :
1.Зовнішній вигляд	Прозора,матова,кольорова.
2.Етилацетат	0,02 мг/дм <sup>3</sup>
3.Свинець	0,001 мг/дм <sup>3</sup>
4.Цинк	0,04 мг/дм <sup>3</sup>
5.Ацетон	0,03 мг/дм <sup>3</sup>
6.Стеаринова кислота	0,0024 мг/дм <sup>3</sup>
7.Мідь	0,053 мг/дм <sup>3</sup>

Дата виготовлення :2022.09

Партія:2022.09

Артикул: БМП-20

Кількість в ящику – 20 уп.



Вх ам 40058  
20.03.23

ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»

80



ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»

# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ БМП-07/2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛКОМ ЛТД» (ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»)

(повна назва виробника або його уповноваженої особи або постачальника)

Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 12-Г, кв. 49 код ЄДРПОУ 36232879

(місце знаходження, для вітчизняного виробника – код ЄДРПОУ)

в особі **Директора ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД» Селіхова Сергія Володимировича**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що

медичний виріб

**Банки для масажу полімерні:**

1. Банки для масажу полімерні: БМП-5 (діаметр 5 мм.)
2. Банки для масажу полімерні: БМП-20 (діаметр 20 мм.)
3. Банки для масажу полімерні: БМП-35 (діаметр 35 мм.)
4. Банки для масажу полімерні: БМП-70 (діаметр 70 мм.)
5. Банки для масажу полімерні: БМПН – 4 (діам.: 5 мм., 20 мм., 35 мм., 70 мм.)
6. Банки для масажу полімерні: БМПН-5 (діам. 5 мм.-2шт., діам. 20 мм.-2шт., діам. 35 мм.-1шт.)

(повна назва продукції, тип, марка, модель)

**Клас I** (згідно з Додатком 2 до Технічного регламенту щодо медичних виробів)

виробництва **Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛКОМ ЛТД» Україна, 65031, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 12-Г, кв. 49 код ЄДРПОУ 36232879; Адреса виробництва: вул. Дальницька, 44, м. Одеса, Україна, 65005 т.+380487750573**

(назва, адреса виробника, місце виробництва, для вітчизняного – код ЄДРПОУ)

виготовляється серійно **згідно з технічним файлом та ТУ У 32.5-36232879-004:2012**

(назва та позначення документації)

відповідає вимогам **Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМ України № 753 від 02.10.2013 р.**

(назва технічного регламенту на продукцію)





**EN 980:2007; ДСТУ ISO 14971:2009; ДСТУ ISO 10993-1:2004; ДСТУ ISO 10993-5:2004; ДСТУ ISO 10993-10:2004**

(позначення нормативних документів /за наявності/)

Перевірка відповідності проведена згідно з Додатком 8 до Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 р.

Декларація складено під цілковиту відповідальність виробника - ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»

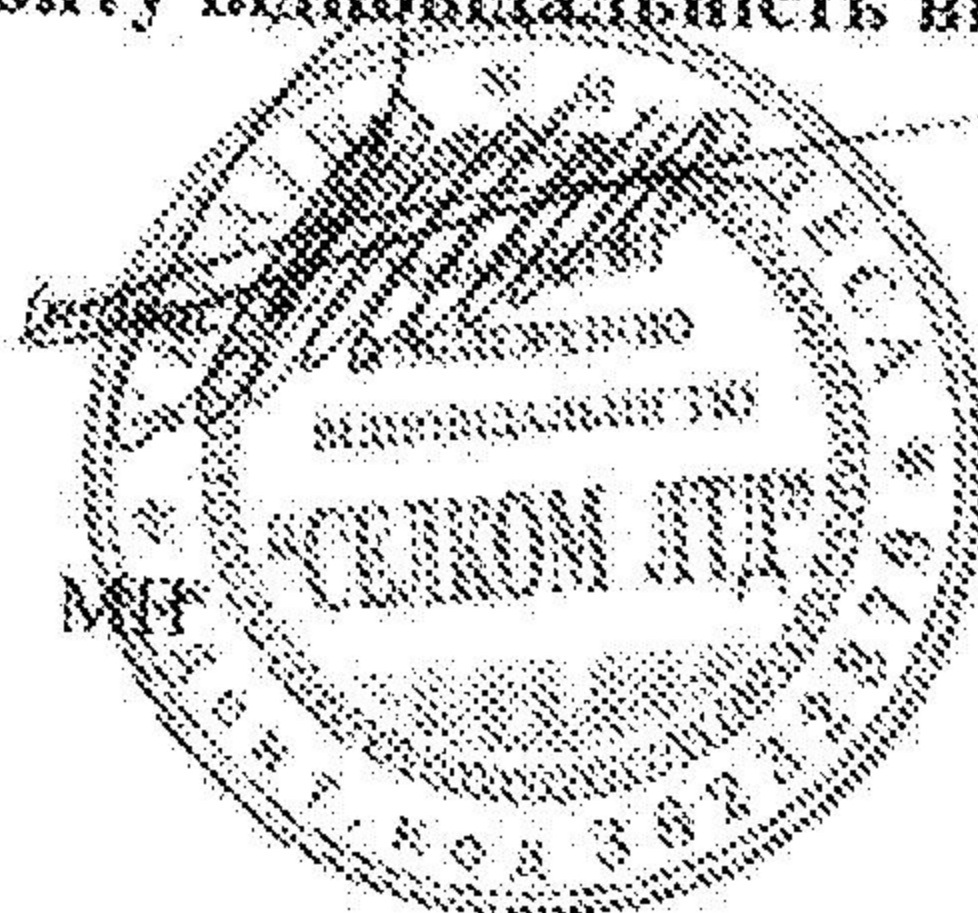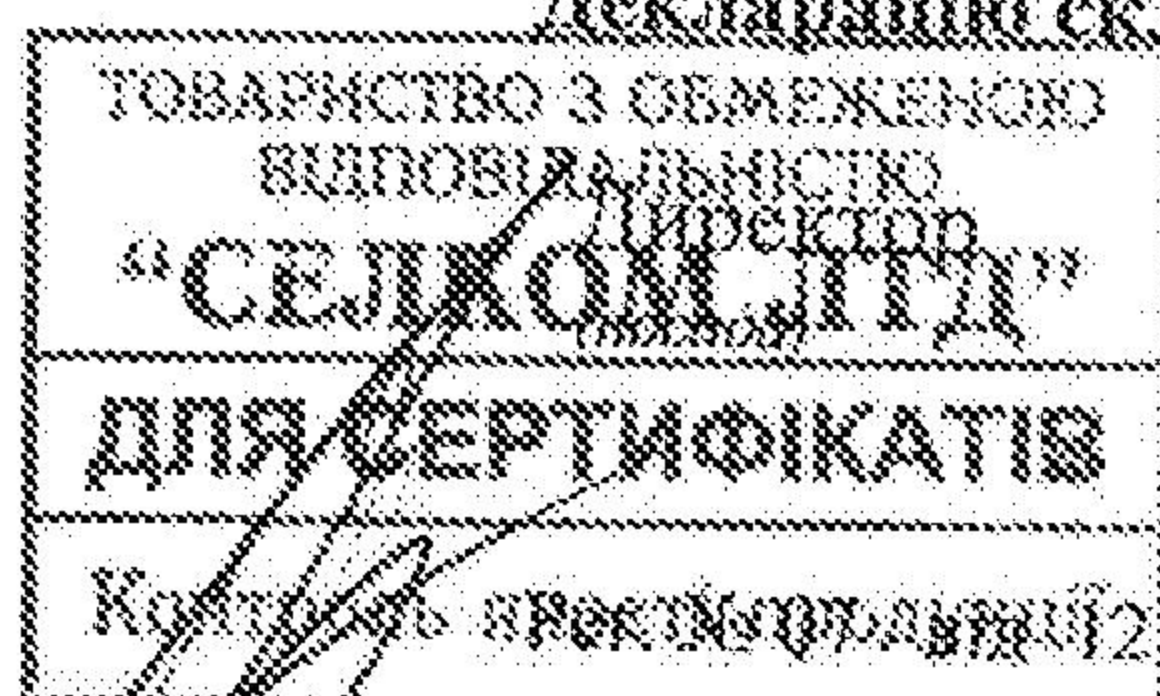

**С.В.Селіхов**  
(ініціал та прізвище)

Термін дії декларації: 3 роки.



**SELKOM LTD**

44, Dalnickaya street  
Odessa 650015  
Ukraine

chudesnik

+38 (067) 488-15-17  
+38 (067) 484-94-91  
+38 (048) 775-05-73  
e-mail: selkom@ukr.net  
www.chudesnik.com.ua

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**  
№ БМП-07/2017

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛКОМ ЛТД» (ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»)  
(повна назва виробника або його уповноваженої особи або постачальника)

Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 12-Г, кв. 49 код ЄДРПОУ 36232879  
(місце знаходження, для вітчизняного виробника – код ЄДРПОУ)

в особі Директора ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД» Селіхова Сергія Володимировича  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що  
медичний виріб

Банки для масажу полімерні:  
1.БМП-20 (діаметр 20 мм.)  
2.БМП-35 (діаметр 35 мм.)  
3.БМП-70 (діаметр 70 мм.)

(повна назва продукції, тип, марка, модель)

Клас I (згідно з Додатком 2 до Технічного регламенту щодо медичних виробів)

виробництва Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛКОМ ЛТД» Україна, 65031, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 12-Г, кв. 49 код ЄДРПОУ 36232879; Адреса виробництва: вул. Дальницька, 44, м. Одеса, Україна, 65005  
(назва, адреса виробника, місце виробництва, для вітчизняного – код ЄДРПОУ)

виготовляється серійно згідно з технічним файлом та ТУ У 32.5-36232879-004:2012  
(назва та позначення документації)

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМ України № 753 від 02.10.2013 р.  
(назва технічного регламенту на продукцію)

а також ДСТУ EN 980:2007; ДСТУ ISO 14971:2009; ДСТУ ISO 10993-1:2004; ДСТУ ISO 10993-5:2004; ДСТУ ISO 10993-10:2004  
(позначення нормативних документів /за наявності/)

а процедура оцінки відповідності проведена згідно з Додатком 8 до Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 р.

Декларацію складено від прізвища та відповідальності виробника - ТОВ «СЕЛКОМ ЛТД»

Директор  
(посада)




С.В.Селіхов  
(ініціали та прізвище)

Рег. № 1 від 01.07.2017 МП

Текст: Декларація про відповідність роки.

Company code 36232879  
Tax number 362328715525  
Account 26008170253 in  
Raiffeisen Bank Aval  
MFO 360805

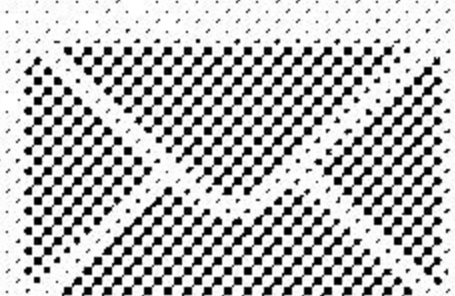

Correspondence:  
Odessa, 65091  
mail box 53

