



ТЕХНОКОМПЛЕКС
 Р/р UA693209840000026001220263141
 в АТ "Прокредит Банк" м. Києва МФО 320984
 ЄДРПОУ 19117325



ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»,
 Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65,
 тел./факс: (044) 422 52 38, (044) 422-52-03,
 e-mail: info.slavna@gmail.com

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ 19117325.005-Іс-2019 від 04.11.2019 р.

з додатками № 1-48

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»**

Головний офіс: 03062, Київ, проспект Перемоги, 65, ЄДРПОУ 19117325

Адреса виробництва: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 39

в особі директора Мазілкина Вадима Германовича

підтверджує, що медичний виріб:

«Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти», вводяться в обіг у стерильному стані та відносяться до класу I стерильний (перелік виробів приведений у додатках),

який виготовляється за ТУ У 18.2-19117325-005:2011 (ДКПП 13.92.29-90.00, ДКПП 14.19.23-93.00, ДКПП 14.19.32-00.00, ДКПП 14.19.43-00.00)

Технічна документація на медичний виріб розроблена.

відповідає Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 р.

Оцінка відповідності проведена згідно процедур, зазначених в додатку 6 «Порядок забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва медичних виробів» в поєднанні з процедурою, наведеною в додатку 8 «Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів» Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Сертифікат відповідності № UA.TR.002.1336-19 від 04.11.2019 р., виданий органом з оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія», м. Харків, вул. Миросицька, 36.

Методи стерилізації:


- газовий (оксидом етилену) згідно ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 «Стерилізація виробів медичного призначення оксидом етилену. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів»;
- радіаційний згідно ДСТУ EN ISO 11137-1:2015 (EN ISO 11137-1:2006) «Стерилізація виробів медичного призначення. Радіаційна стерилізація. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів».

Медичні вироби, які є складовими наборів, взаємно сумісні.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність


ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»

Термін дії декларації з 04.11.2019 р. до 03.11.2024 р.

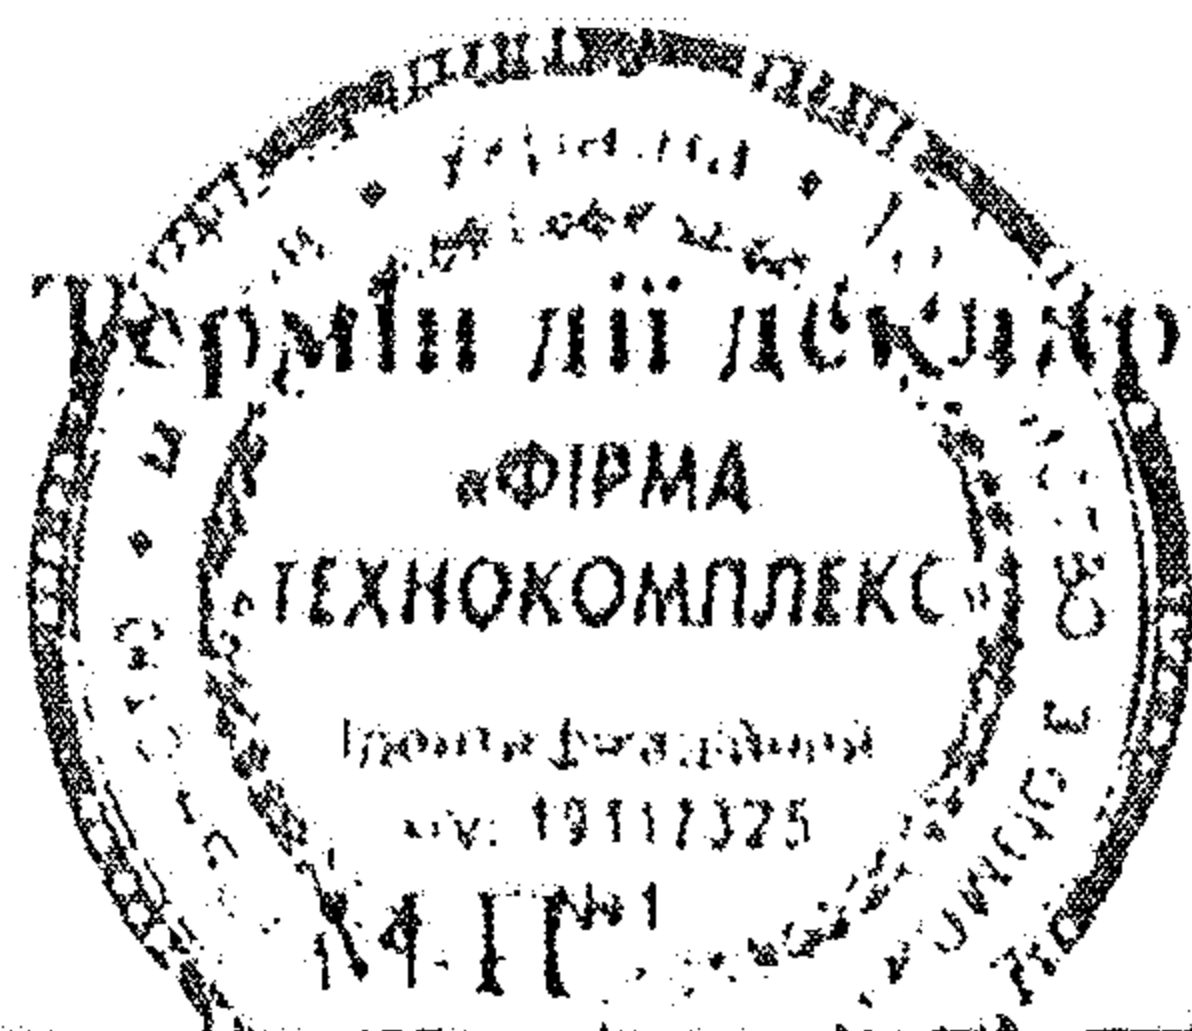

Директор


В.Г. Мазілкин

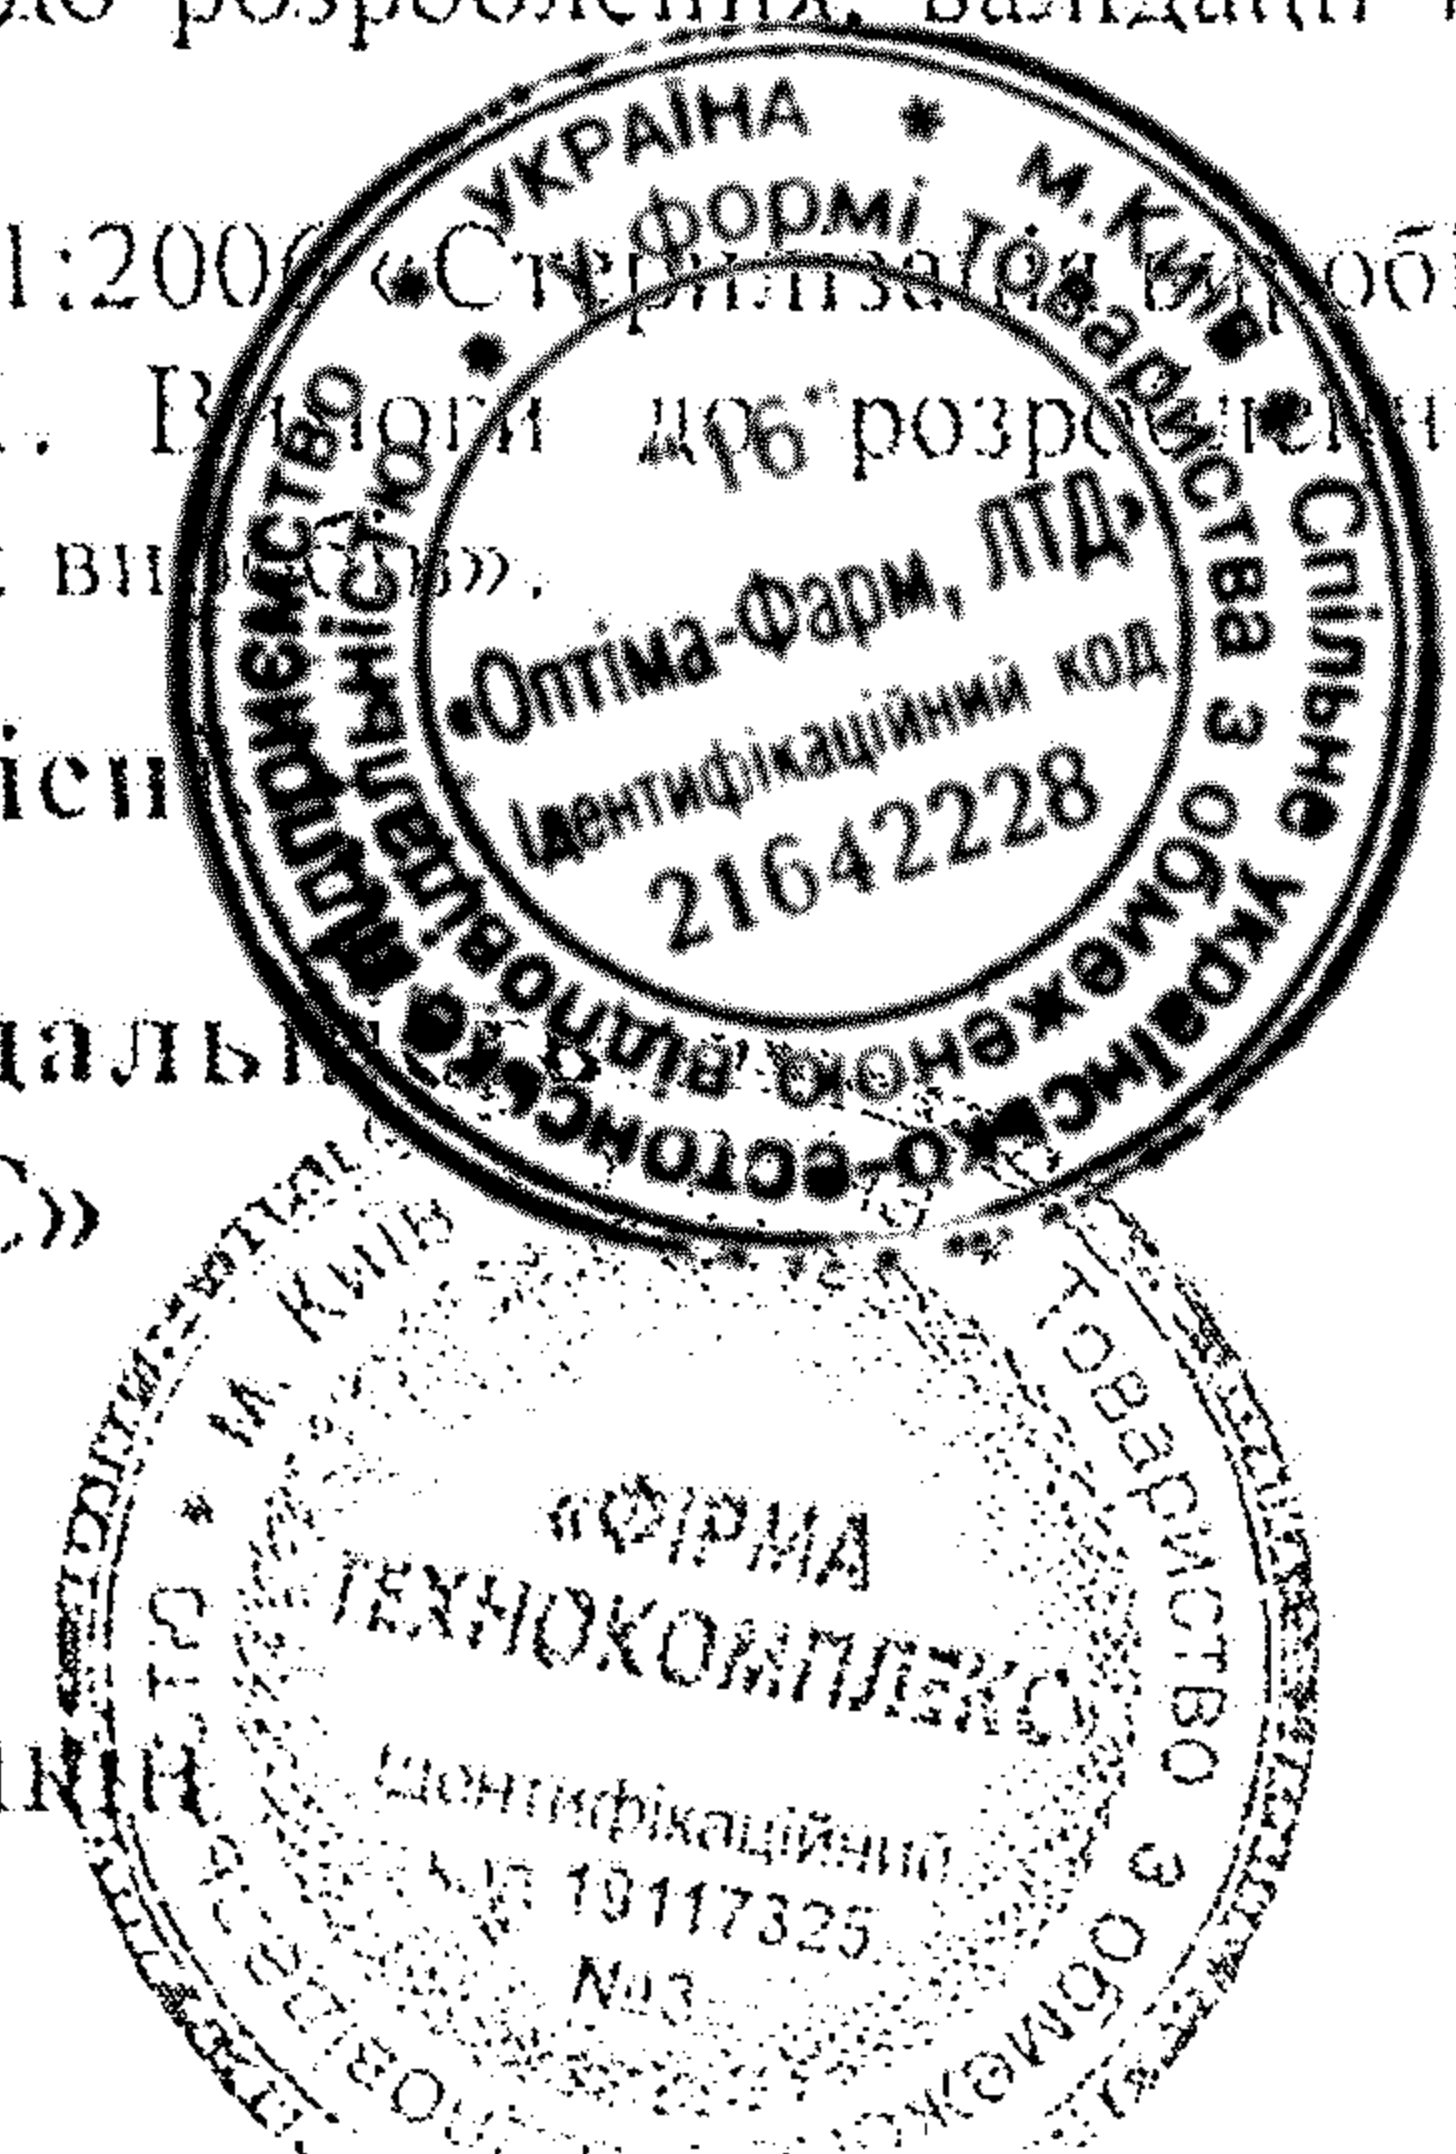

Додаток № 17 до Декларації про відповідність № 19117325.005-Іс-2018

№	Артикул	Найменування
1. Бахіли медичні		
1.1	1220901	Бахіли медичні низькі «Славна*» (поліетилен - 8 г/м ²) стерильні
1.2	1220902	Бахіли медичні середні «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні
1.3	1220903	Бахіли медичні середні (в упаковці 5 пар) «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні
1.4	1220904	Бахіли медичні середні (в упаковці 100 пар) «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні
1.5	1220905	Бахіли медичні високі на зав'язках «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні
1.6	1220906	Бахіли медичні високі на зав'язках «Славна*» (СМС - 35 г/м ²) стерильні
1.7	1220907	Бахіли медичні високі на резинках «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні
1.8	1220908	Бахіли медичні високі на резинках «Славна*» (СМС - 35 г/м ²) стерильні
1.9	1220909	Бахіли медичні високі на липучках «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні
1.10	1220910	Бахіли медичні високі на липучках «Славна*» (СМС - 35 г/м ²) стерильні
1.11	1220911	Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) «Славна*» (поліетилен - 8 г/м ²) стерильні
1.12	1220919	Бахіли медичні низькі «Славна*» (поліетилен - 30 г/м ²) стерильні
2. Брюки медичні		
2.1	1220401	Брюки медичні (розмір 46 - 48 (М)) «Славна*» (СМС - 35 г/м ²) стерильні
2.2	1220402	Брюки медичні (розмір 46 - 48 (М)) «Славна*» (спанлейс - 50 г/м ²) стерильні
2.3	1220403	Брюки медичні (розмір 50 - 52 (L)) «Славна*» (СМС - 35 г/м ²) стерильні
2.4	1220404	Брюки медичні (розмір 50 - 52 (L)) «Славна*» (спанлейс - 50 г/м ²) стерильні
2.5	1220405	Брюки медичні для пресотерапії (розмір 54 - 56 (XL)) «Славна*» (спанбонд - 30 г/м ²) стерильні

Директор
ТОВ "Фірма "Технокомплекс"

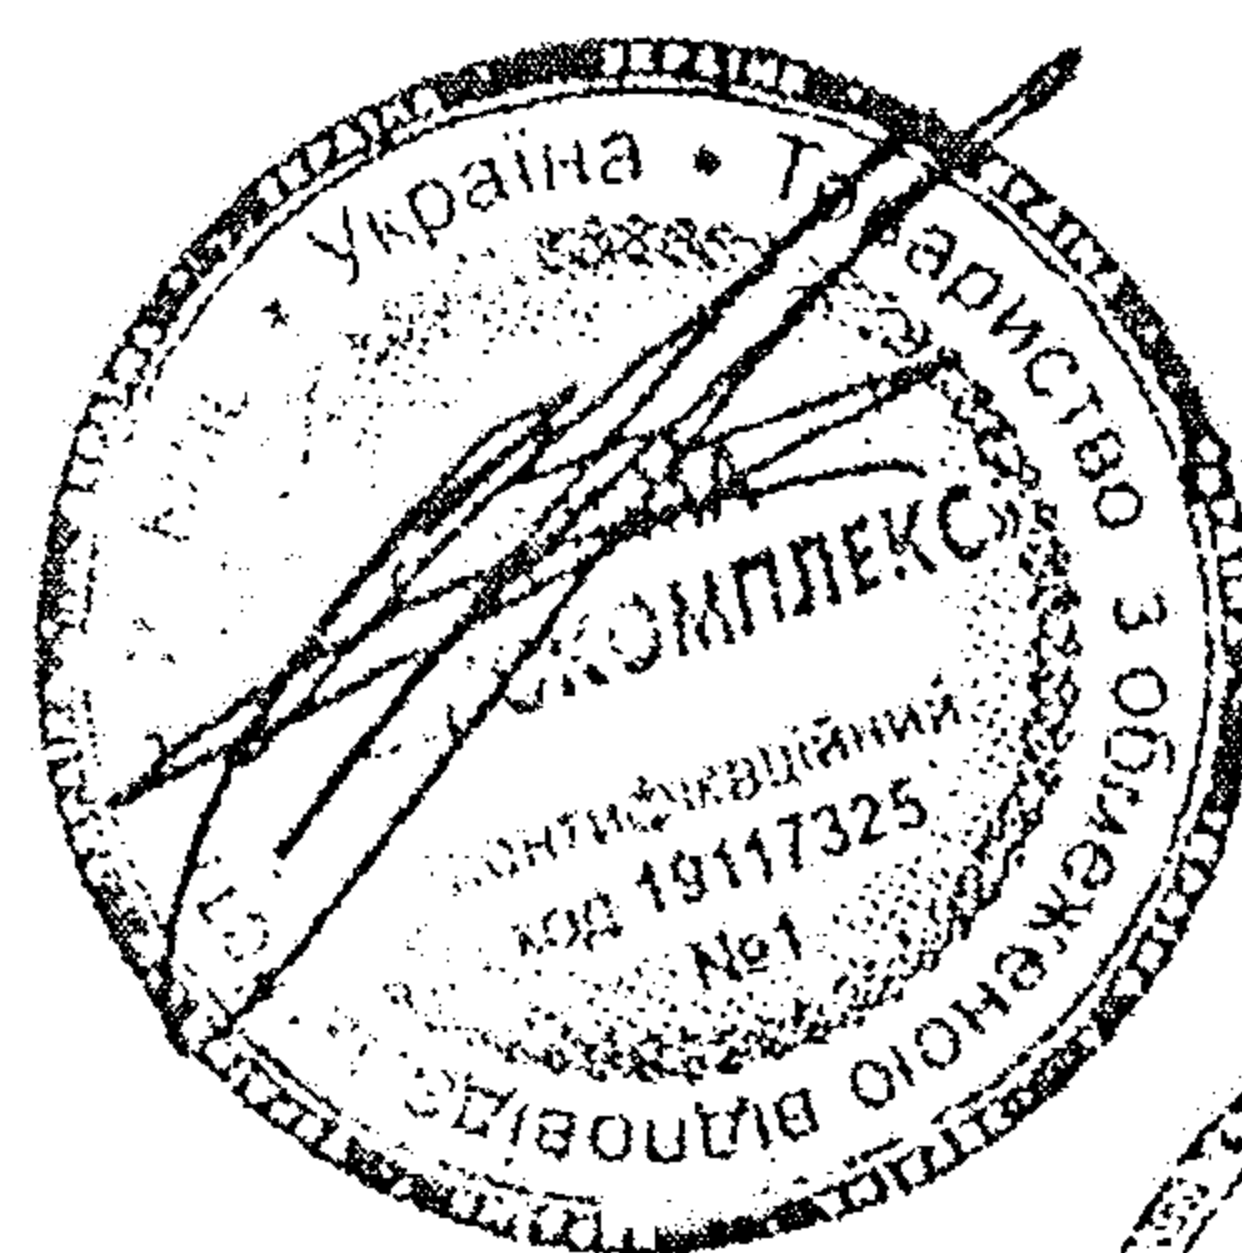

Г. Мазілкин



Додаток № 5 до Декларації про відповідність № 19117325.005-Іс-2019

№	Артикул	Найменування
1. Комплекти одягу та покриттів операційних для Кесаревого розтину		
11	1130401	Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №1 «Славна» (шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м ²); сорочка - комбі для породіллі - 1 шт. (СМС+спанлейс - 35+50 г/м ²); бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м ²); покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см x 25см та мішком для збирання рідини 80см x 70см (з відповідною трубою довжиною 130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 80см x 70см - 1 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); пелюшка поглинаюча 60см x 60см з адгезивним краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент) стерильний
12	1130402	Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №7 «Славна» (шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м ²); сорочка - комбі для породіллі - 1 шт. (СМС+спанлейс - 35+50 г/м ²); бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м ²); покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см x 25см - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 80см x 70см - 5 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); пелюшка поглинаюча 60см x 60см з адгезивним краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент) стерильний
13	1130404	комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №14 «Славна» (комплект одягу для породіллі: шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м ²), сорочка медична процедурна (розмір 50 - 52 (L)) - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²), бахіли медичні високі на зав'язках - 1 пара (СМС - 35 г/м ²); комплект покриттів: покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 30см x 30см та мішком для збирання рідини 80см x 70см (з двома відповідними трубами довжиною 130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 80см x 70см - 2 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); покриття операційне 35см x 70см - 4 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); чохол 150см x 60см для інструментального столу «Майо» - 1 шт. (СМС+ламінований спанбонд - 35+45 г/м ²); пелюшка поглинаюча 60см x 60см з адгезивним краєм - 2 шт. (целюлоза+абсорбент); стрічка адгезивна 50см x 5см - 1 шт. (нетканний матеріал + скотч технічний); кишеня бічна 40см x 30см з липкою фіксацією - 2 шт. (поліетилен - 55 г/м ²); комплект одягу для лікарів: шапочка - берет медична - 6 шт. (спанбонд - 13 г/м ²); маска медична тришарова на резинках - 6 шт. (спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун); халат медичний (хірургічний) на зав'язках довжиною 110 см (розмір 50 - 52 (L)) - 6 шт. (СМС - 35 г/м ²); бахіли медичні середні - 6 пар (спанбонд - 30 г/м ²); бірка для немовлят - 3 шт. (папір синтетичний) стерильний
14	1130405	комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №15 «Славна» (халат медичний (хірургічний) на зав'язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 3 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см x 25см - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 140см x 100см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 80см x 70см - 4 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 60см x 40см - 4 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); пелюшка поглинаюча 60см x 60см - 1 шт. (целюлоза+абсорбент) стерильний
15	1130408	комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №18 «Славна» (шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м ²); халат медичний (захисний) комбінований на зав'язках (тип Б) довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 5 шт. (СМС+ламінований спанбонд - 35+45 г/м ²); бахіли медичні високі на зав'язках - 5 пар (спанбонд - 30 г/м ²); бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м ²); покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см x 25см та мішком для збирання рідини 80см x 70см (з відповідною трубою довжиною 130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 2 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 80см x 70см - 2 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); покриття операційне 35см x 20см - 4 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); пелюшка поглинаюча 60см x 60см з адгезивним краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент); стрічка адгезивна 50см x 5см - 1 шт. (нетканний матеріал + скотч технічний) стерильний
16	1130409	Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №19 «Славна» (комплект одягу для породіллі: шапочка - берет медична - 1 шт. (спанбонд - 13 г/м ²); сорочка - комбі для породіллі - 1 шт. (СМС+спанлейс - 35+50 г/м ²); бахіли медичні середні - 1 пара (спанбонд - 30 г/м ²); комплект покриттів: покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см x 25см - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 200см x 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м ²); покриття операційне 140см x 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 80см x 70см - 5 шт. (спанлейс - 50 г/м ²); пелюшка поглинаюча 60см x 60см з адгезивним краєм - 1 шт. (целюлоза+абсорбент); комплект одягу для лікарів: шапочка - берет медична - 3 шт. (спанбонд - 13 г/м ²); маска медична тришарова на резинках - 3 шт. (спанбонд+фільтруючий шар - мелтблаун); халат медичний (хірургічний) на зав'язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 3 шт. (СМС - 35 г/м ²); бахіли медичні середні - 3 пари (спанбонд - 30 г/м ²) стерильний
17	1130411	Комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину №21 «Славна» (халат медичний (захисний) комбінований на зав'язках (тип Б) довжиною 140 см (розмір 50 - 52 (L)) - 2 шт. (СМС+ламінований спанбонд - 35+45 г/м ²); покриття операційне 300см x 160см - на дугу, з адгезивним операційним полем 25см x 25см (з антимікробною операційною плівкою) та мішком для збирання рідини 80см x 70см (з двома відповідними трубами довжиною 130 см) - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²); покриття операційне 140см x 80см - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м ²) стерильний

Директор
ТОВ "Фірма "Технокомплекс"



В.Г. Мазілін



№001763

Серія СВ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (ДП "Харківстандартметрологія")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва

(Технічний регламент щодо медичних виробів, додаток 6)

№ UA-TR.002.1336-19

Виробник: ТОВ «Фірма «ТЕХНОКОМПЛЕКС», код ЄДРПОУ 19117325
Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65

Виробництво: Україна, 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 39;
20704, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 22

Продукція: Дзеркала вигнальні одноразового застосування, набори гінекологічні оглядові одноразового застосування, одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти, піточки інтековані перікардальні, інструменти маніпуляційні і допоміжні виробів медичних та їх набори одноразового застосування, засоби операційно-перезаживальні медичні та їх набори, палічки індивідуальні операційні "Кдемі" та операційні антимікробні та антибактеріальні "Кдемі" стерильні, клас І (стерильний) згідно з Додатком 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Орган з оцінки відповідності ДП "Харківстандартметрологія" зарпече, що зазначений виробник виробляє систему управління якістю на стадіях виробничого процесу, що пов'язані із забезпеченням та збереженням статусу стерильності, відповідно до додатку 6 Технічного регламенту щодо медичних виробів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2015 р. № 753.


Система управління якістю виробника відповідає вимогам положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів та підлягає періодичному нагляду.

Звіт: 07/617-618 TR від 04.11.2019 р.

Висновок: 617 від 04.11.2019 р.

Дата видачі: 04 листопада 2019 р.

Дійсний до: 04 листопада 2024 р.

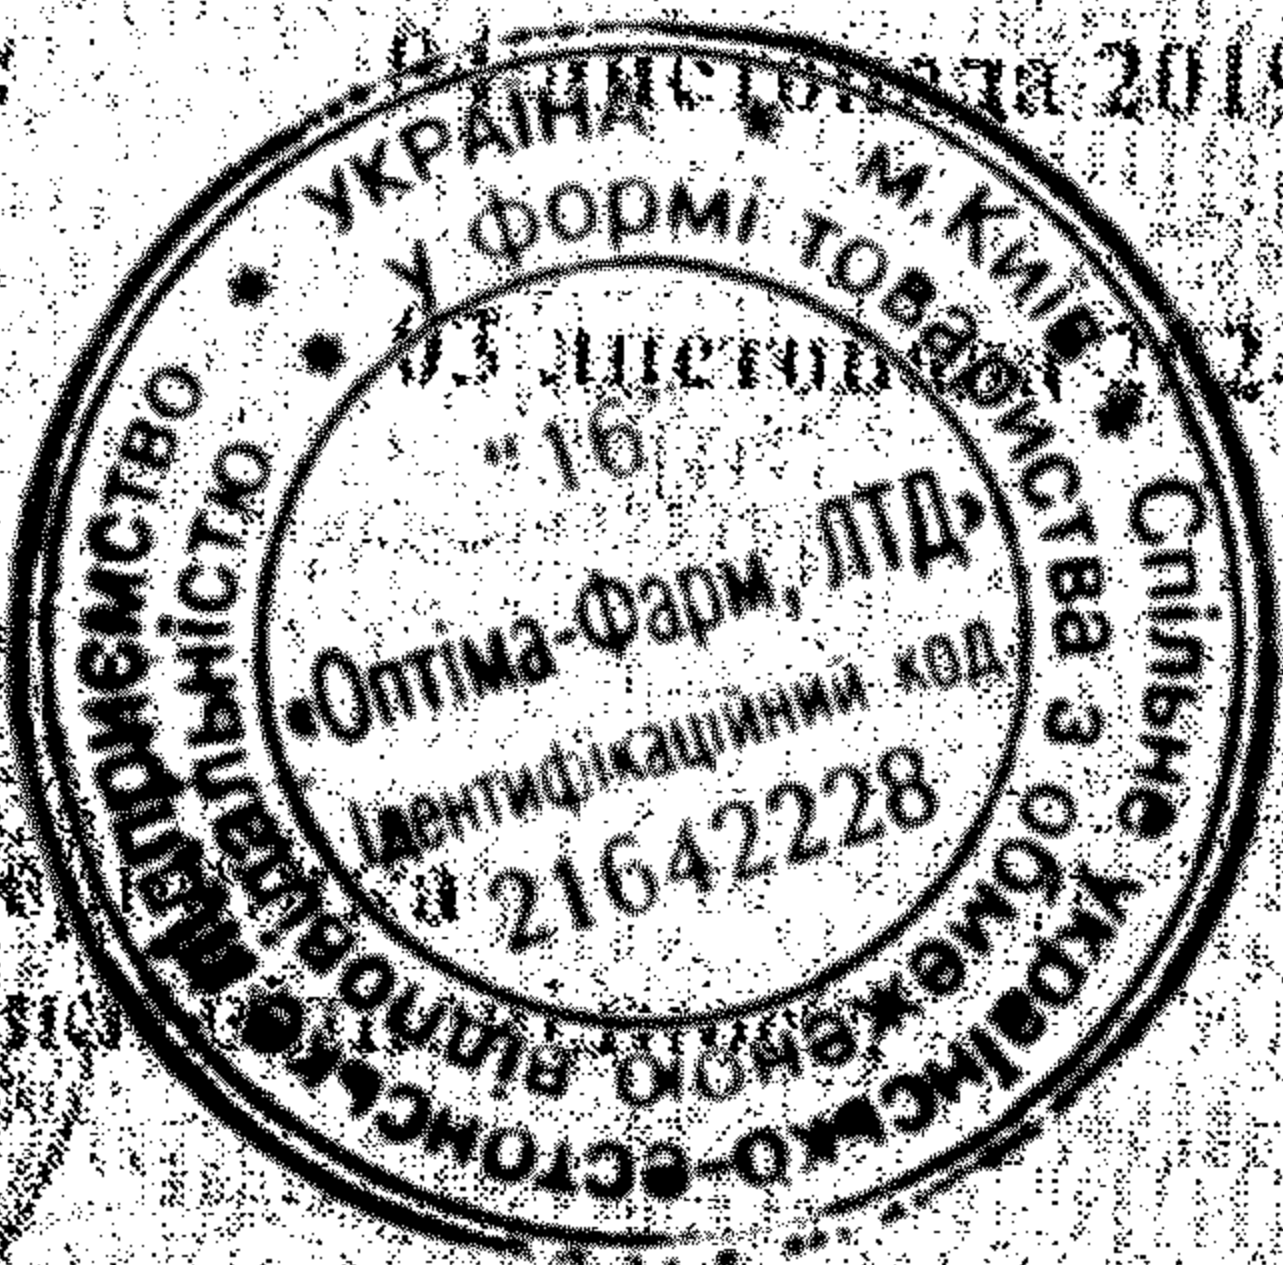

Численні сертифікати відповідності в даній системі згідно з вимогами технічного регламенту. (Кількість сторінок)

Сфера застосування: ДП "Харківстандартметрологія", код ЄДРПОУ: 01602 м. Київ, вул. Перемоги, 65, тел: (057) 700 47 40

Президент ДП "Харківстандартметрологія": Сергій Іванович Сидоренко, код ЄДРПОУ: 01602 м. Київ, вул. Перемоги, 65, тел: (057) 700 47 40

Генеральний директор ДП "Харківстандартметрологія": Сергій Іванович Сидоренко, код ЄДРПОУ: 01602 м. Київ, вул. Перемоги, 65, тел: (057) 700 47 40



ТЕХНОКОМПЛЕКС

Розрахунковий рахунок 26001220263141
в АТ «Прокредитбанк», МФО 320984,
ЄДРПОУ 19117325

ТОВ «Фірма «ТЕХНОКОМПЛЕКС»
Україна, 03062, м. Київ, пр.-т. Перемоги, 65,
Тел./факс: (044) 239-21-84, (044) 422-52-03,
e-mail: info@tcomplex.kiev.ua

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ 19117325.005-Іс-2017 від 12.06.2017р.

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фірма «Технокомплекс»,
Головний офіс: 03062, Київ, проспект Перемоги 65, ЄДРПОУ 19117325
Адреса виробництва: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 39

в особі директора Мазілкина Вадима Германовича

підтверджує, що медичний виріб:

«Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти «Славна[®]», вводяться
в обіг у стерильному стані та відносяться до класу І стерильний (перелік
виробів приведений у додатку),

який виготовляється за ТУ У 18.2-19117325-005:2011

(ДКПП 13.92.29-90.00, ДКПП 14.19.23-93.00,
ДКПП 14.19.32-00.00, ДКПП 14.19.43-00.00)

Технічна документація на медичний виріб розроблена.

відповідає Технічному регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013р.

Оцінка відповідності проведена згідно процедур, зазначених в додатку 6
«Порядок забезпечення функціонування системи управління якістю під час
виробництва медичних виробів» в поєднанні з процедурою, наведеною в
додатку 8 «Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва
медичних виробів» Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Сертифікат відповідності № UA.TR.002.CB.0268-17, виданий органом з
оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія», м. Харків, вул.
Мироносицька, 36.


Декларацію складено під цілковиту відповідальність ТОВ «Фірма «Технокомплекс»

Термін дії декларації з 12.06.2017р. до 09.04.2018р.



Директор

В.Г. Мазілкин

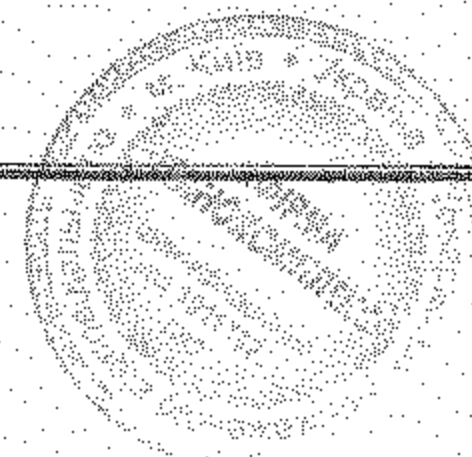


Додаток № 17 до Декларації про відповідність № 19117325.005-Іс-2017

№	Артикул	Найменування
1. Бахіли медичні		
1.1	1220901	Бахіли медичні низькі «Славна®» (поліетилен - 2 г) стерильні
1.2	1220902	Бахіли медичні середні «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильні.
1.3	1220903	Бахіли медичні середні в упаковці по 5 пар «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильні
1.4	1220904	Бахіли медичні середні в упаковці по 100 пар «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильні
1.5	1220905	Бахіли медичні високі на зав'язках «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильні
1.6	1220906	Бахіли медичні високі на зав'язках «Славна®» (СМС - 35 г/м2) стерильні.
1.7	1220907	Бахіли медичні високі на резинках «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильні
1.8	1220908	Бахіли медичні високі на резинках «Славна®» (СМС - 35 г/м2) стерильні
1.9	1220909	Бахіли медичні високі на липучках «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2) стерильні
1.10	1220910	Бахіли медичні високі на липучках «Славна®» (СМС - 35 г/м2) стерильні
1.11	1220911	Бахіли медичні низькі в упаковці по 50 пар «Славна®» (поліетилен - 2 г) стерильні
2. Брюки медичні		
2.1	1220401	Брюки медичні (розмір 46-48 (М)) «Славна®» (СМС - 35 г/м2) стерильні.
2.2	1220402	Брюки медичні (розмір 46-48 (М)) «Славна®» (спанлейс - 50 г/м2) стерильні.
2.3	1220403	Брюки медичні (розмір 50-52 (L)) «Славна®» (СМС - 35 г/м2) стерильні
2.4	1220404	Брюки медичні (розмір 50-52 (L)) «Славна®» (спанлейс - 50 г/м2) стерильні.
2.5	1220405	Брюки медичні для пресотерапії (розмір 54-56 (XL)) «Славна®» (спанбонд)-30 г/м2) стерильні

Директор
ТОВ "Фірма "Технокомплекс"



В.Г. Мазілкин

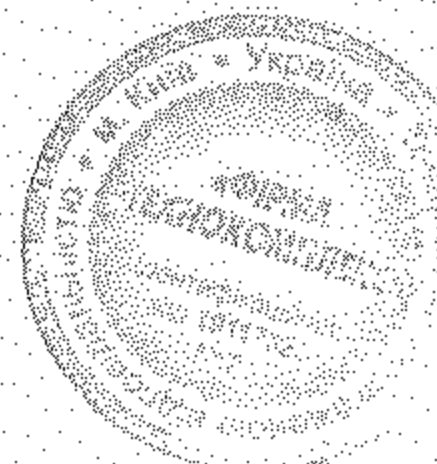

№ 000636



Серія СВ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОПІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "Харківстандартметрологія")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.002.CB.0268-17

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності под №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 12.06.2017р. до 09.04.2018р.

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано **ТОВ «Фірма «ТЕХНОКОМПЛЕКС»**, 03062, м.Київ, пр.Перемоги, 65,
Сертифікат выдан
certificate is issued on код ЄДРПОУ 19117325

Продукція **Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти виготовляються згідно**
Продукция **ТУ У 18.2-19117325-005:2011 "Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти**
production **«Славія»», вводяться в обіг у стерильному стані та відносяться до класу I стерильний,**
коди: ДКПП 13.92.29-90.00, 14.19.23-93.00, 14.19.32-00.00, 14.19.43-00.00
(Повна назва, тип, вид, марка, торгова марка, (товарний знак)) (код (n)УКТЗЕД, ДК 016-2010)
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка(товарный знак)) (код (y) ТИВЭД), ДК 016-2010)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)) (UKTZED code (s), ДК 016-2010)

Відповідає вимогам **Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою**
Соответствует требованиям **Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р.**
Complies the requirements

(Назва та позначення нормативних документів)
(Название и обозначения нормативных документов)
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и) **ТОВ «Фірма «ТЕХНОКОМПЛЕКС»**
Производитель (и)
Producer (s)

Місце (я) виробництва **20700, Черкаська обл., м.Сміла, вул.Перемоги,39**
Место (я) производства
Place (s) of production

Додаткова інформація **Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти серійно виготовляються**
Дополнительная информация **з 12.06.2017р. до 09.04.2018р. Оцінка відповідності проводилась згідно процедур,**
Additional information **зазначених в додатку 6«Порядок забезпечення функціонування системи**
управління якістю під час виробництва медичних виробів» в поєднанні з
процедурою, наведеною в додатку 8 «Порядок здійснення внутрішнього контролю
виробництва медичних виробів» Технічного регламенту щодо медичних виробів

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ДП «Харківстандартметрологія», м. Харків,**
Сертифікат выдан органом оценки соответствия **вул. Митрофановська, 36, № UA.TR.002.**
Certificate is issued by the conformity assessment body **тел./факс (057) 700-37-02; 756-37-58; 756-37-85**

На підставі **Сертифікат на систему управління якістю № UA2.003.19117325.4 -2016 від 10.05.2016;**
На основании **звіт з наглядового аудиту за сертифікованою системою управління якістю від**
on the grounds of **02.06.2017; звіт з перевірки дотримання вимог Технічного регламенту в рамках**
нагляду від 09.06.2017

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия
director of the conformity assessment body
Підпис, ініціали, прізвище
(Подпись, инициалы, фамилия) /signature, initials, family name
M.P.M.P./ Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з оцінки відповідності, що розміщена на
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных
органа оценки соответствия, размещенной на
Validity of the certificate of conformity can be checked on the base of data
of the conformity assessment body, which is loaded at
www.hgcsms.kharkov
(Назва веб-сайту)
(Название веб-сайта)
(website name)

